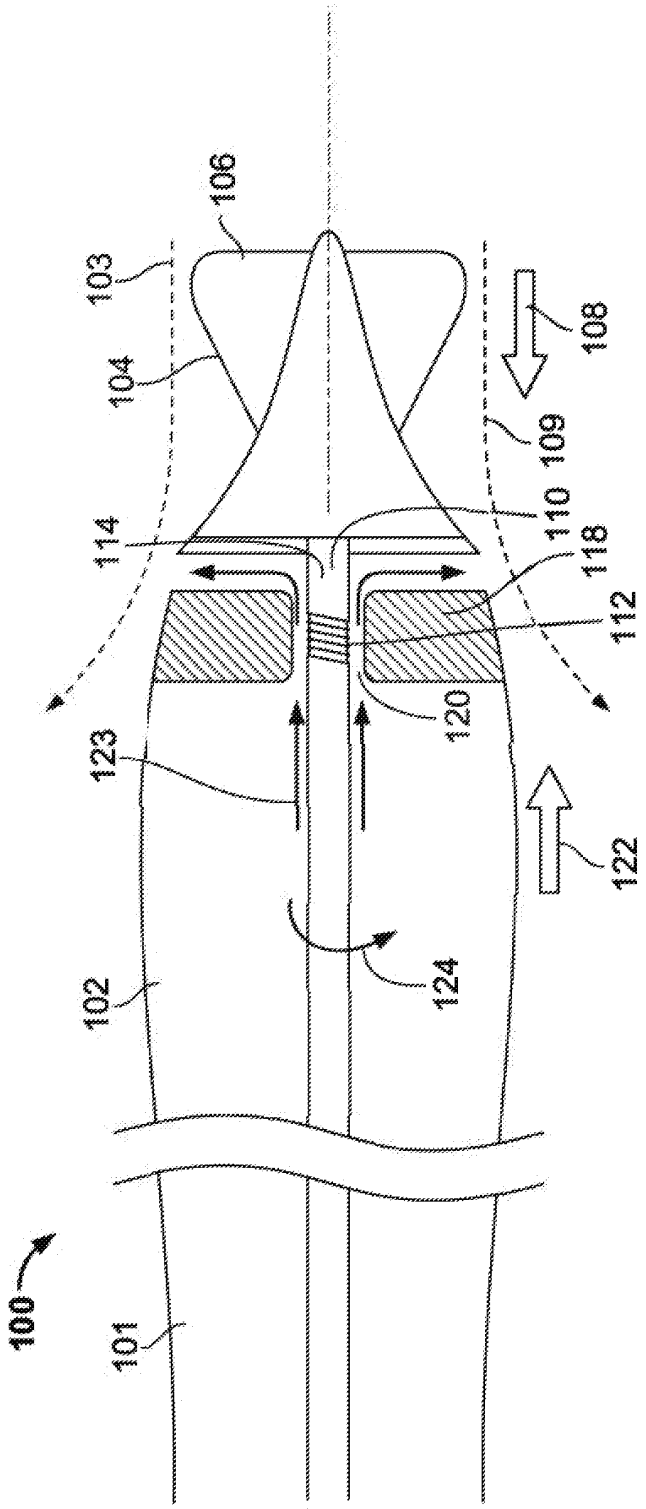

FIG. 1

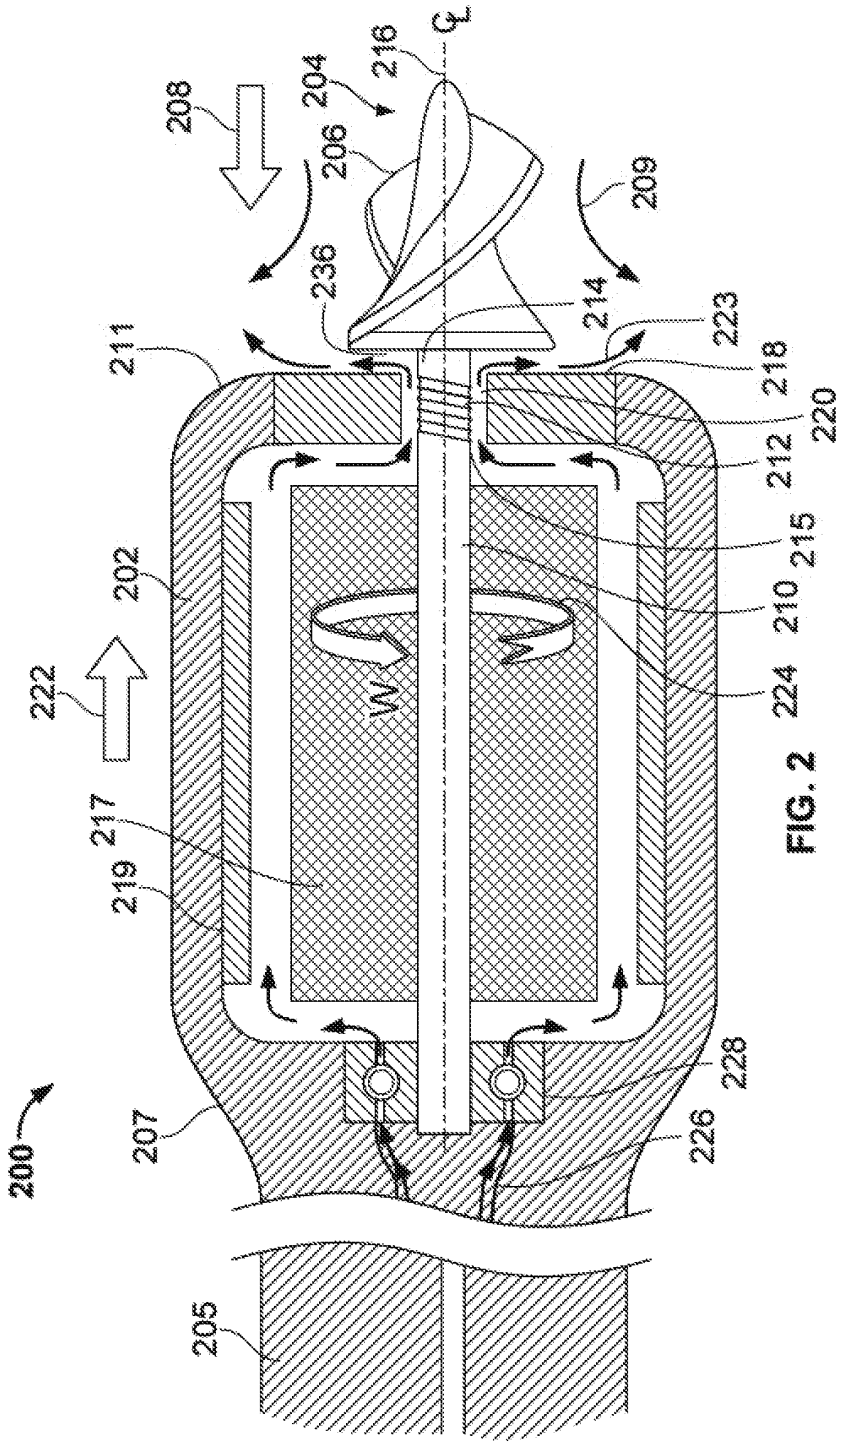
200
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
214
215
216
217
218
219
220
222
223
224
226
228
236
W
CL

FIG. 2

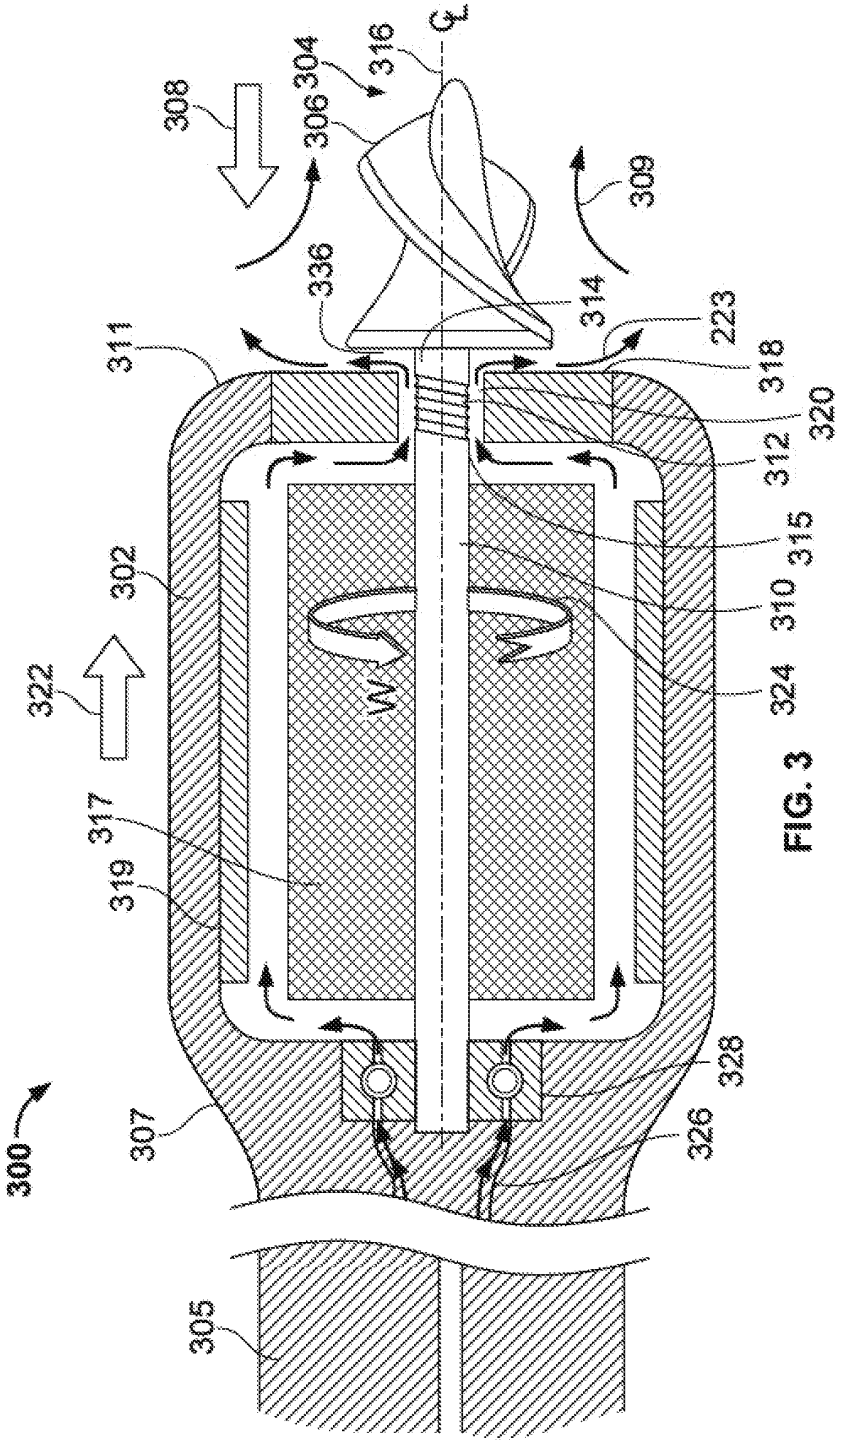
CL
316
304
308
306
309
336
314
223
311
318
320
312
315
302
310
322
324
317
319
328
307
326
300
305

FIG. 3

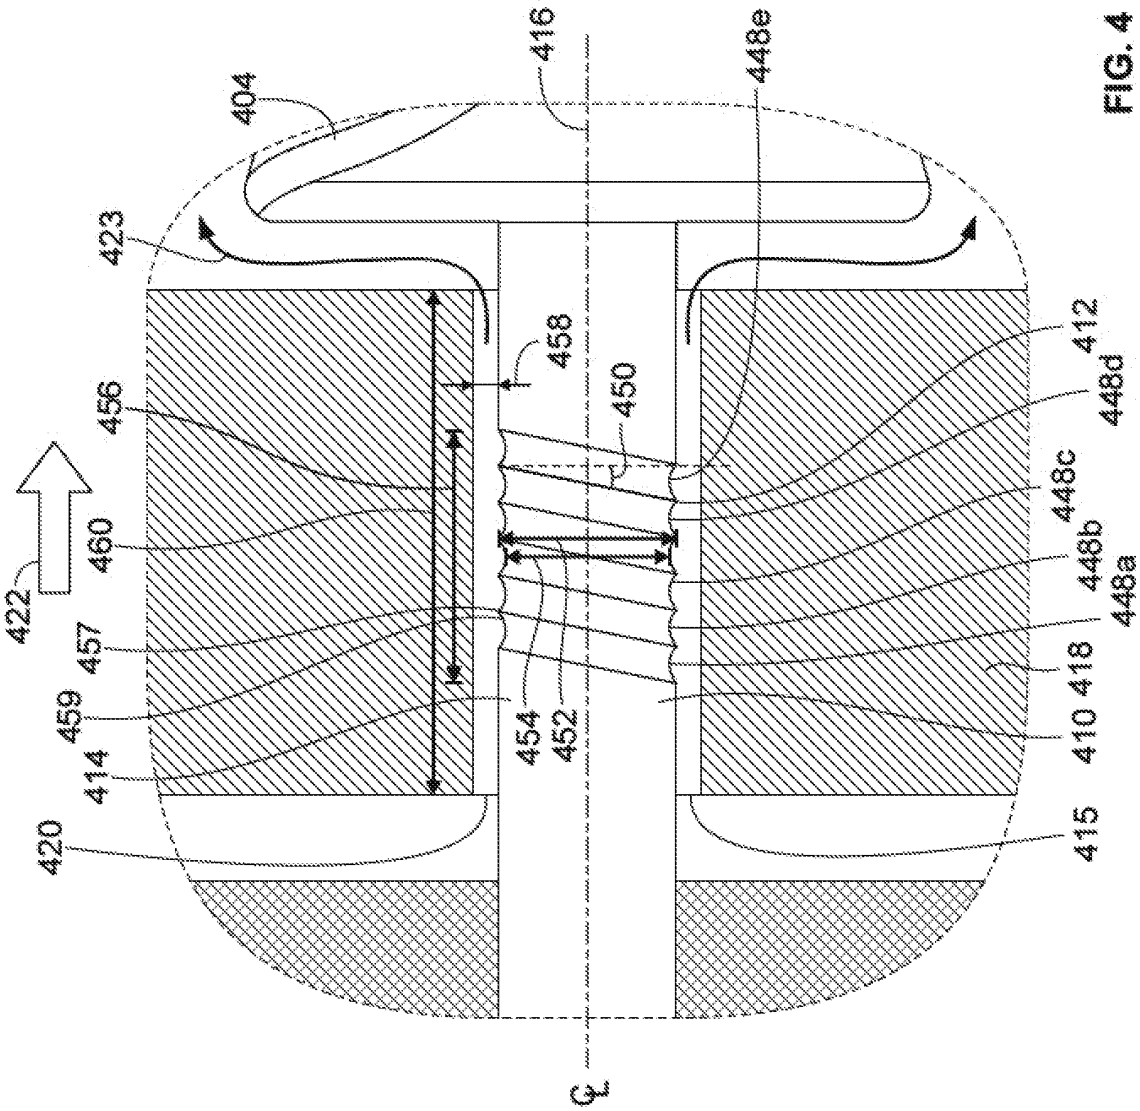
416
448e
404
423
458
450
412
448d
456
448c
460
448b
448a
422
457
418
459
454
452
410
414
420
415
CL

FIG. 4

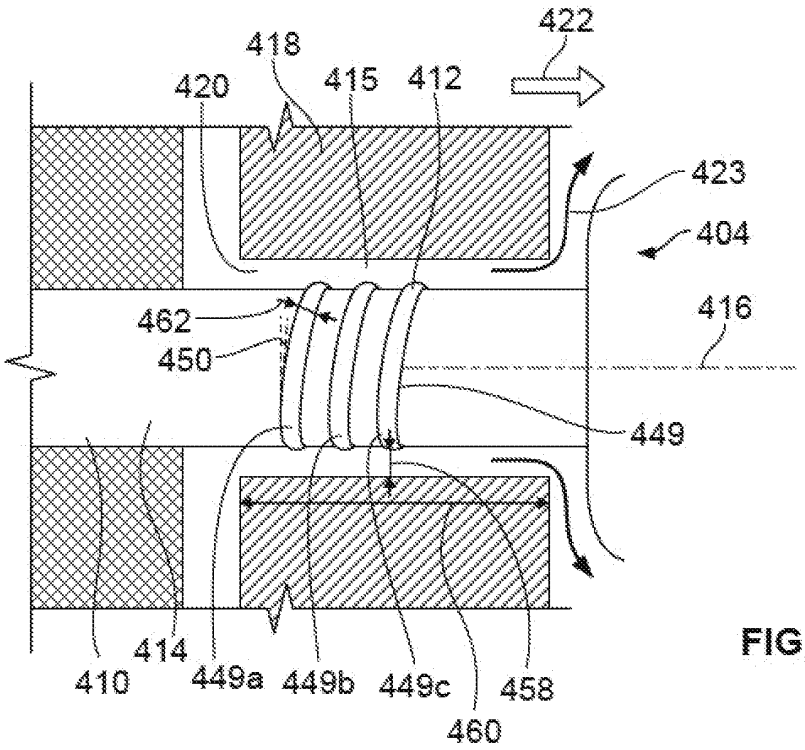
422
418
420
415
412
423
404
462
416
450
449
414
410
449a
449b
449c
458
460

FIG. 5

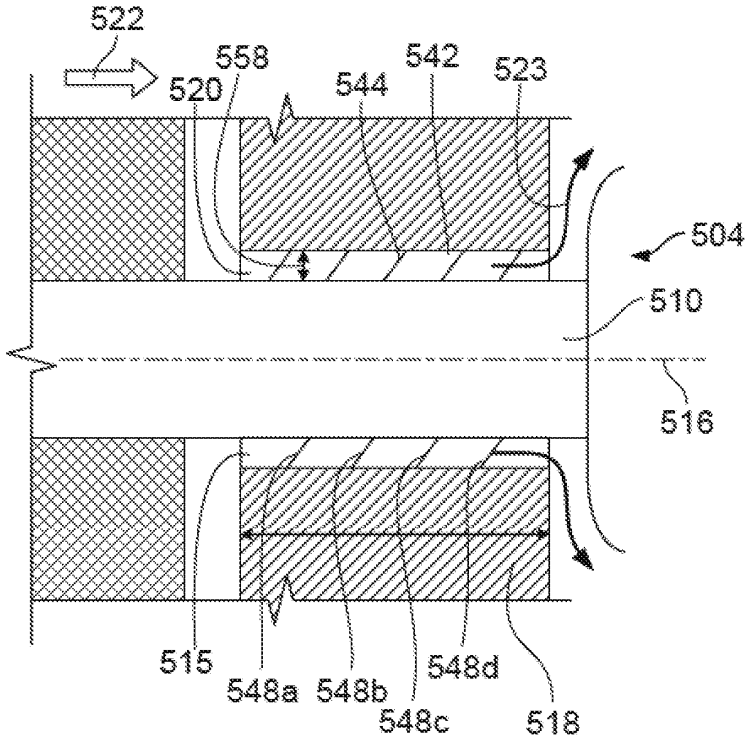
522
558
542
520
544
523
504
510
516
515
548a
548b
548c
548d
518

FIG. 6

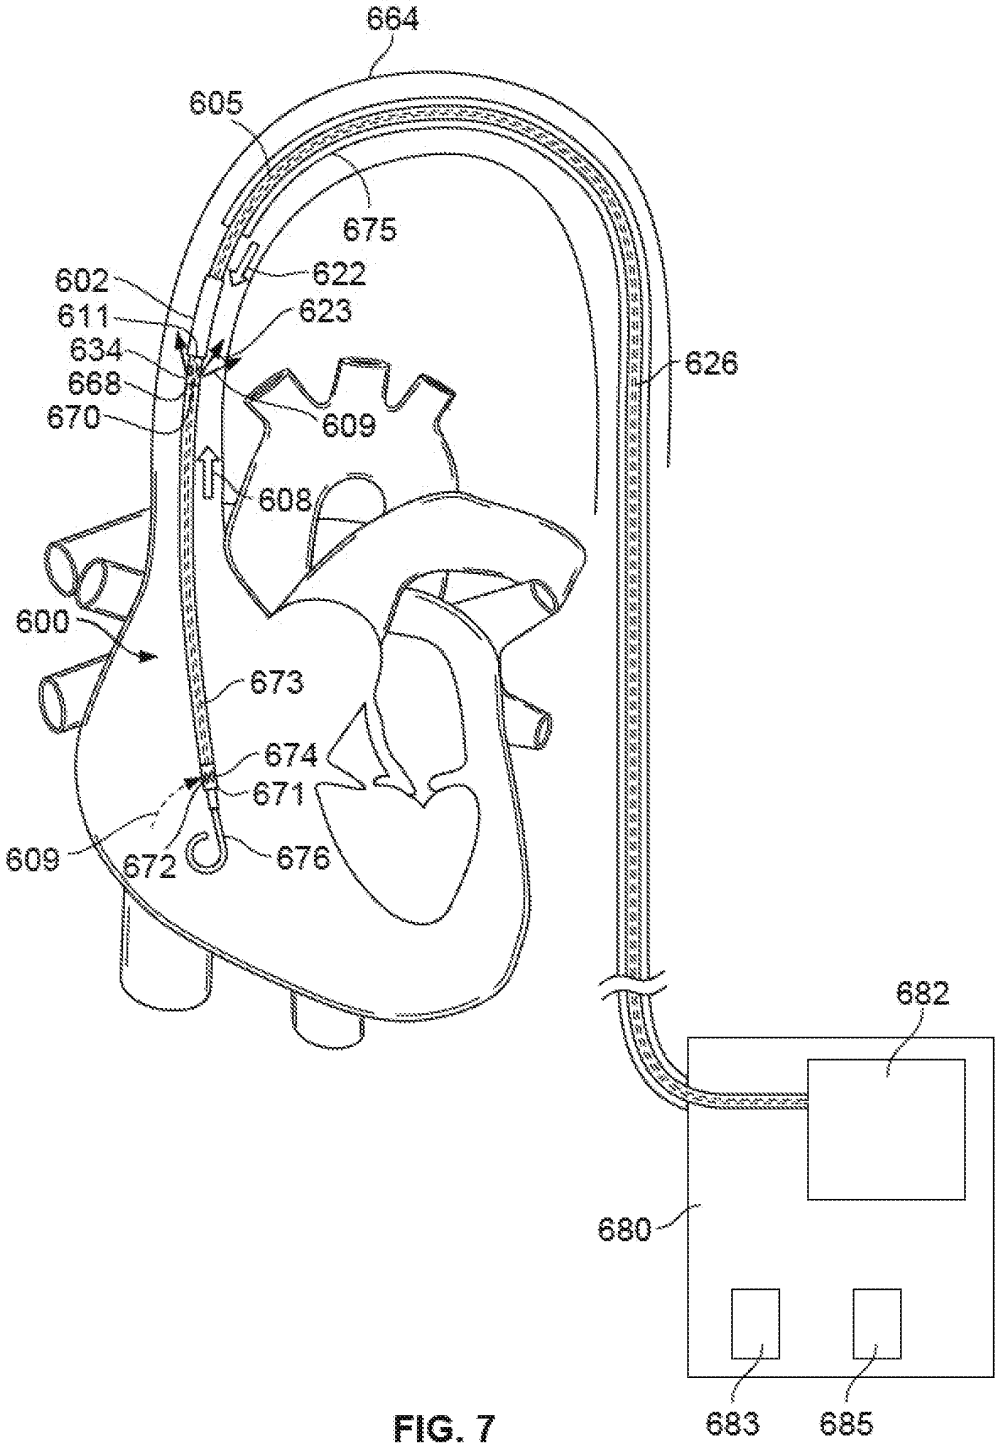
664
605
675
622
602
623
611
634
668
670
609
626
608
600
673
674
671
609
672
676
682
680
683
685

FIG. 7

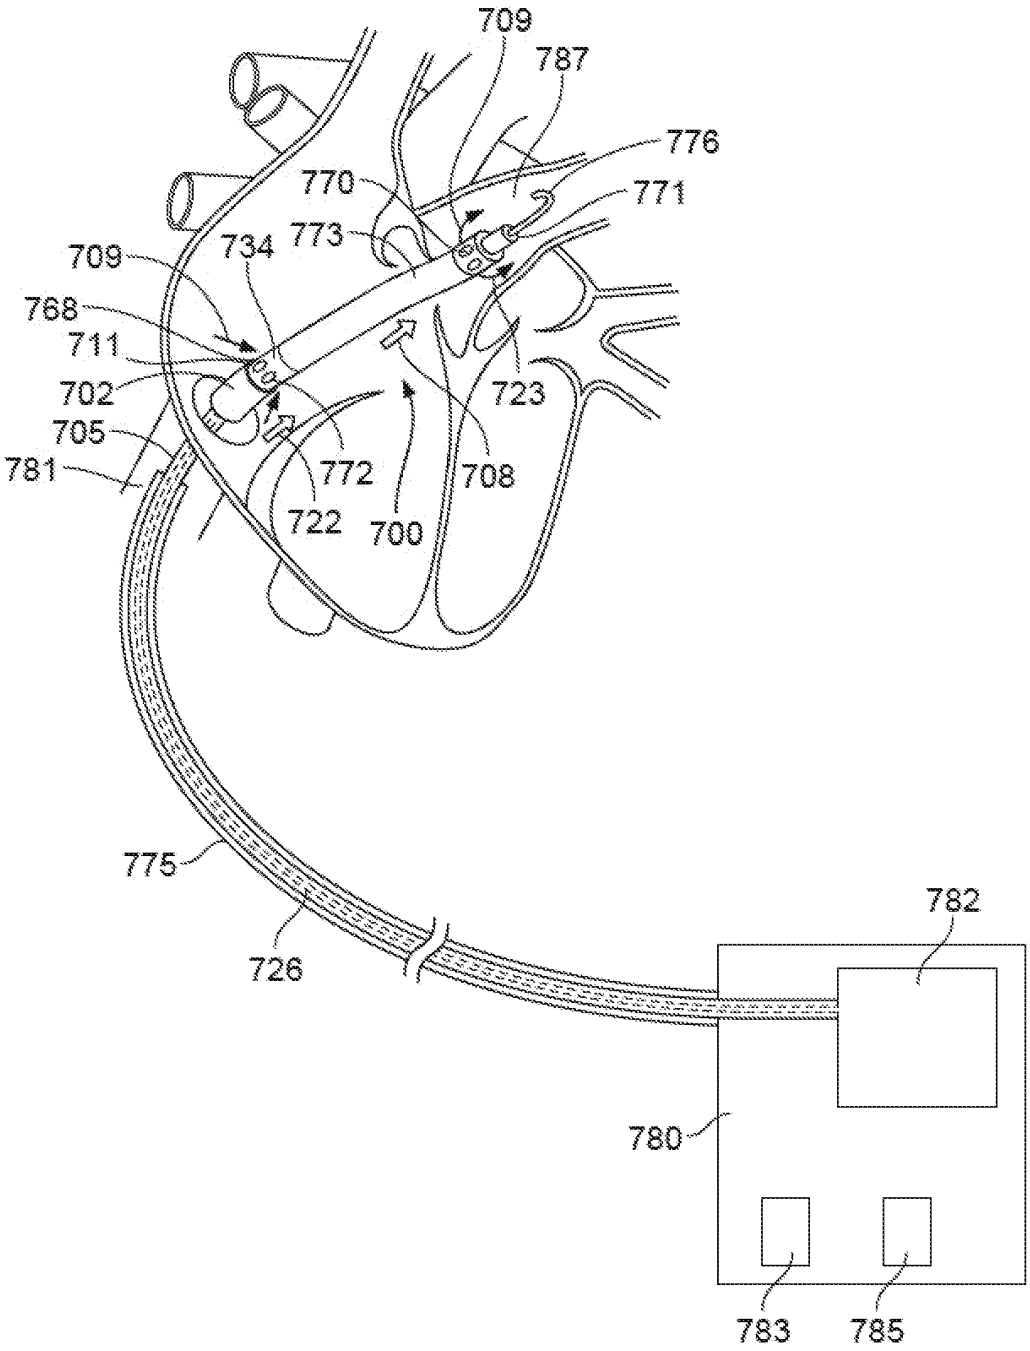
709
787
776
770
771
773
734
709
768
711
702
705
781
723
772
708
722
700
775
726
782
780
783
785

FIG. 8

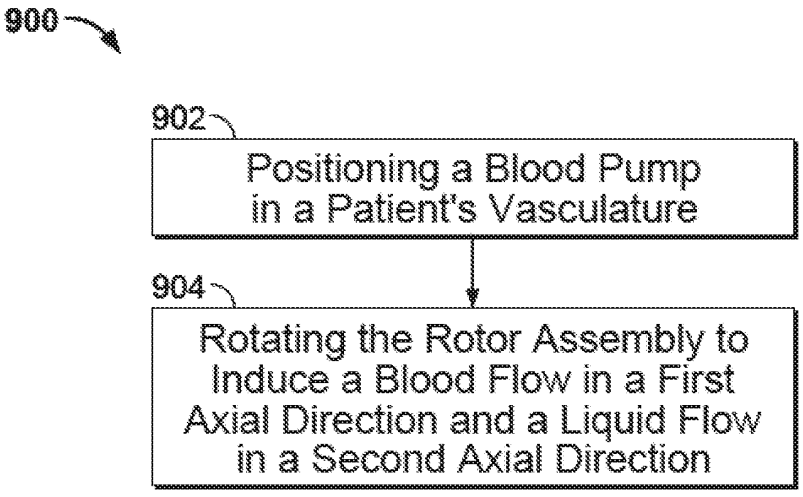
900
902
Positioning a Blood Pump in a Patient's Vasculature
904
Rotating the Rotor Assembly to Induce a Blood Flow in a First Axial Direction and a Liquid Flow in a Second Axial Direction

FIG. 9