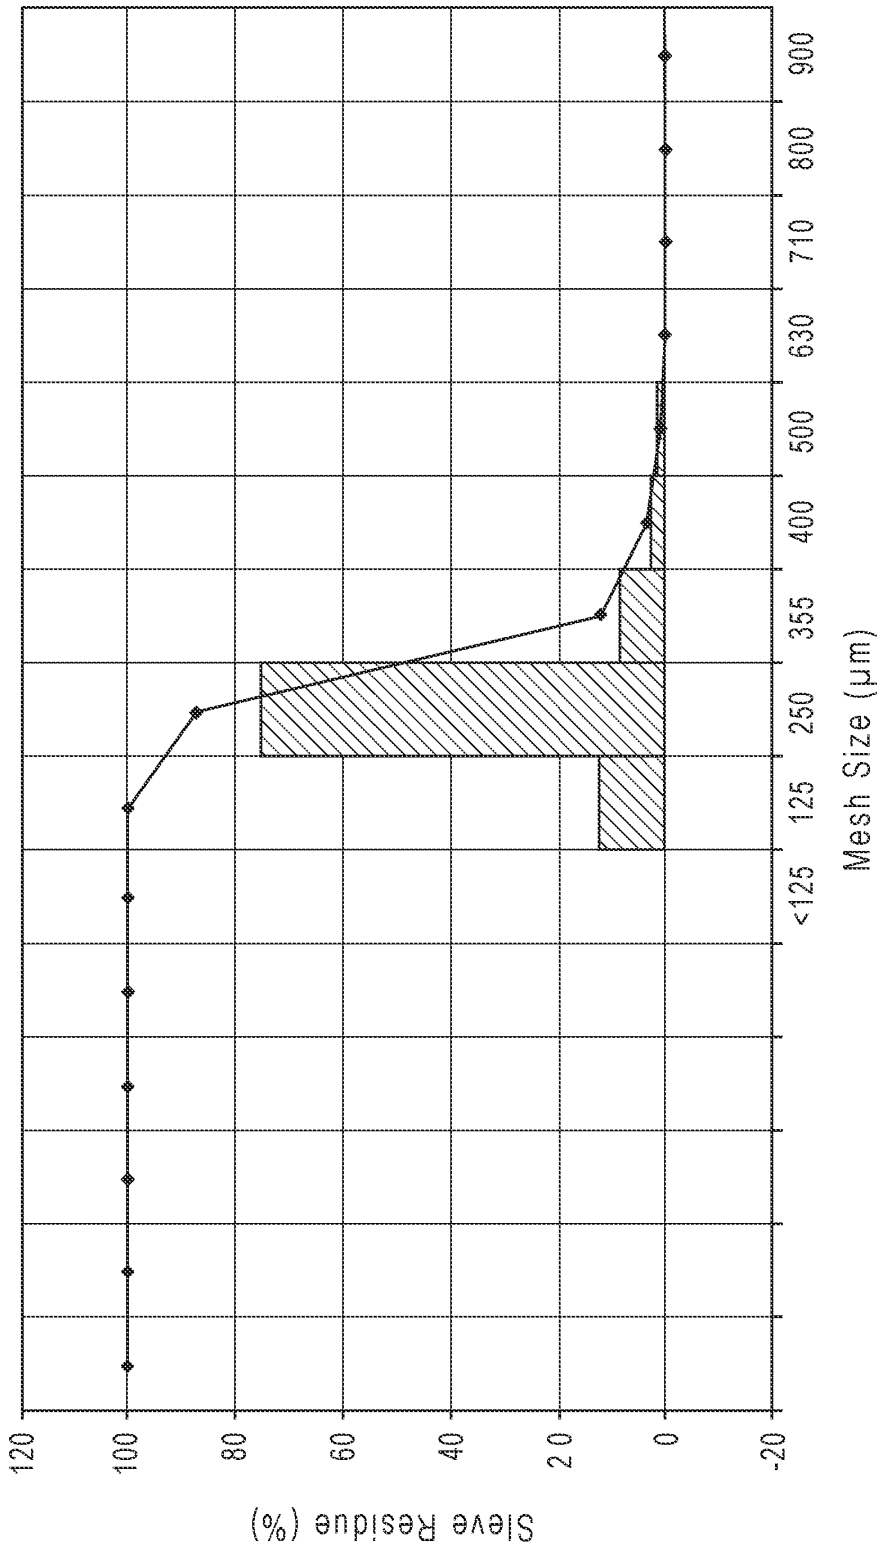

Sieve Residue (%)
120
100
80
60
40
20
0
-20
Mesh Size (µm)
<125
125
250
355
400
500
630
710
800
900

FIG. 1

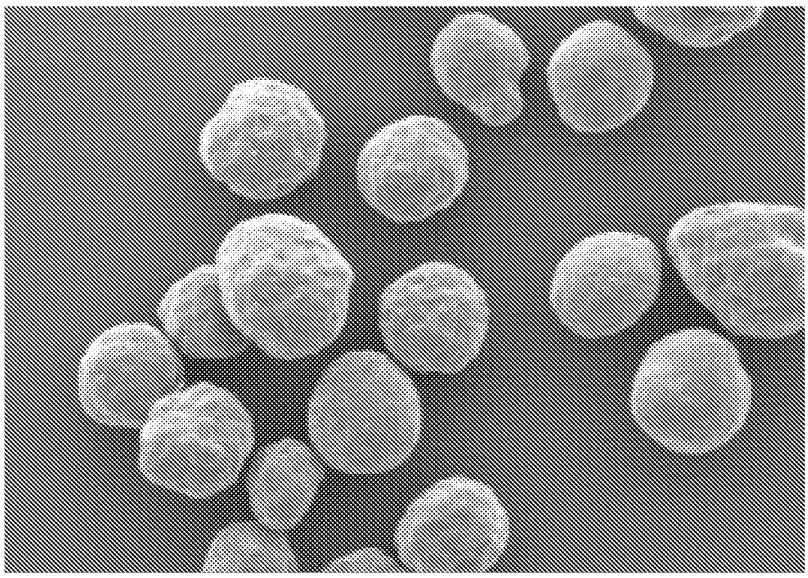


FIG. 2A

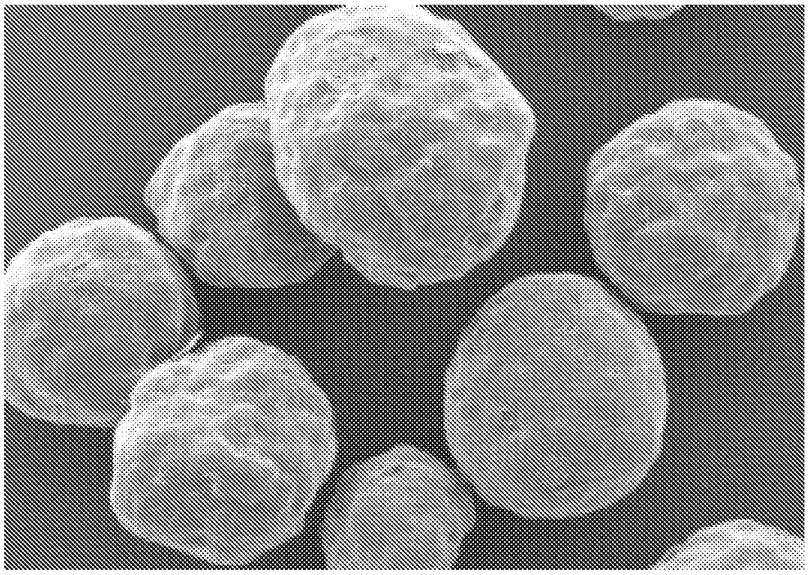


FIG. 2B

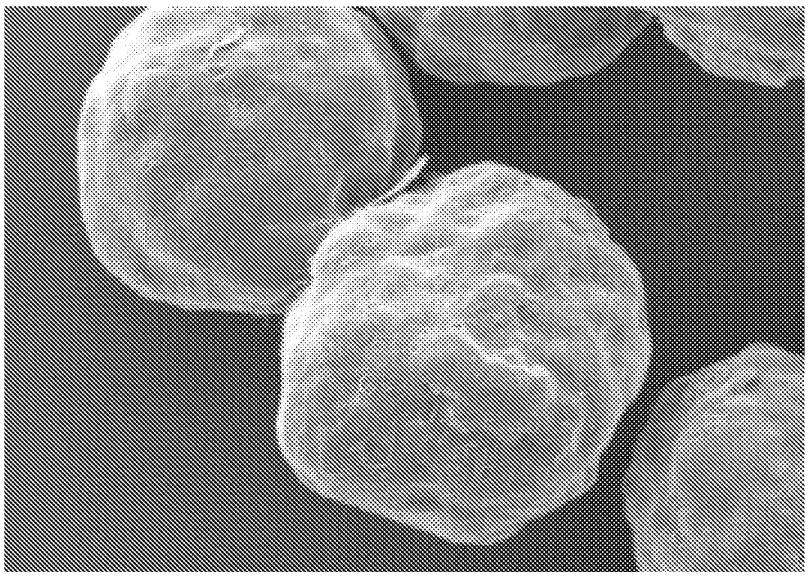


FIG. 2C

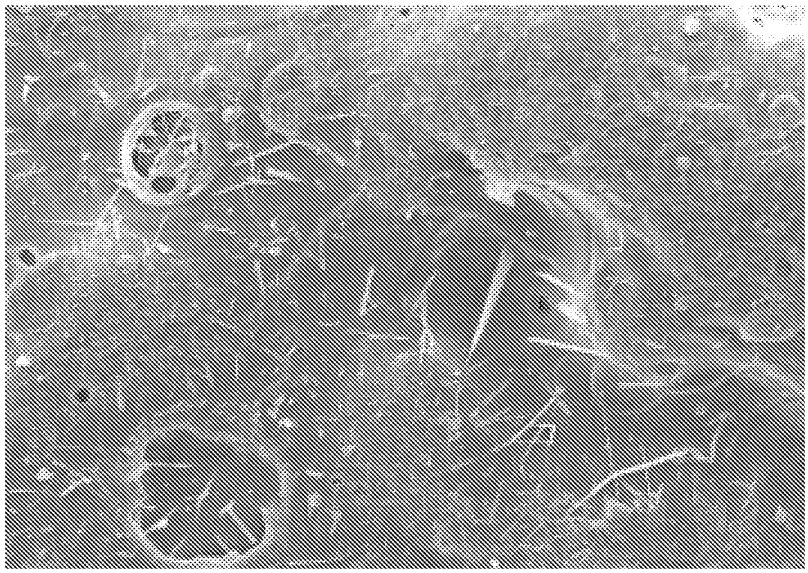


FIG. 2D

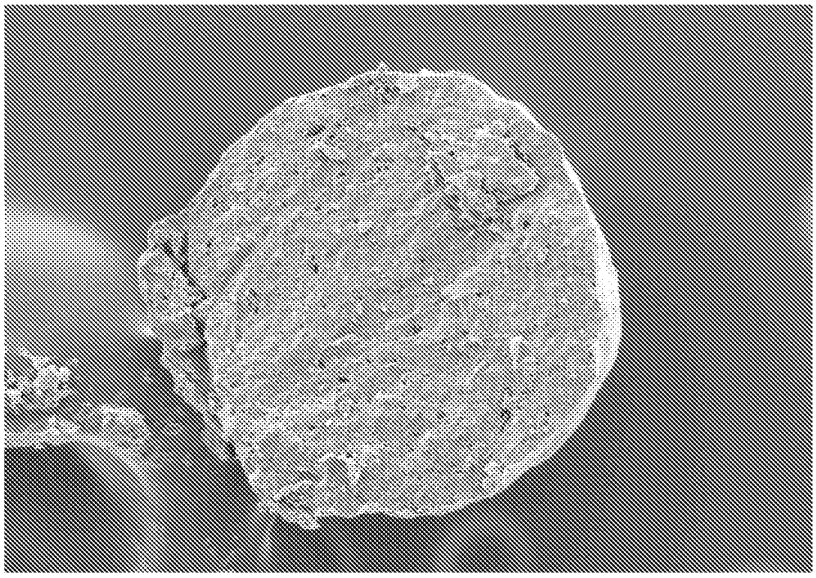


FIG. 2E

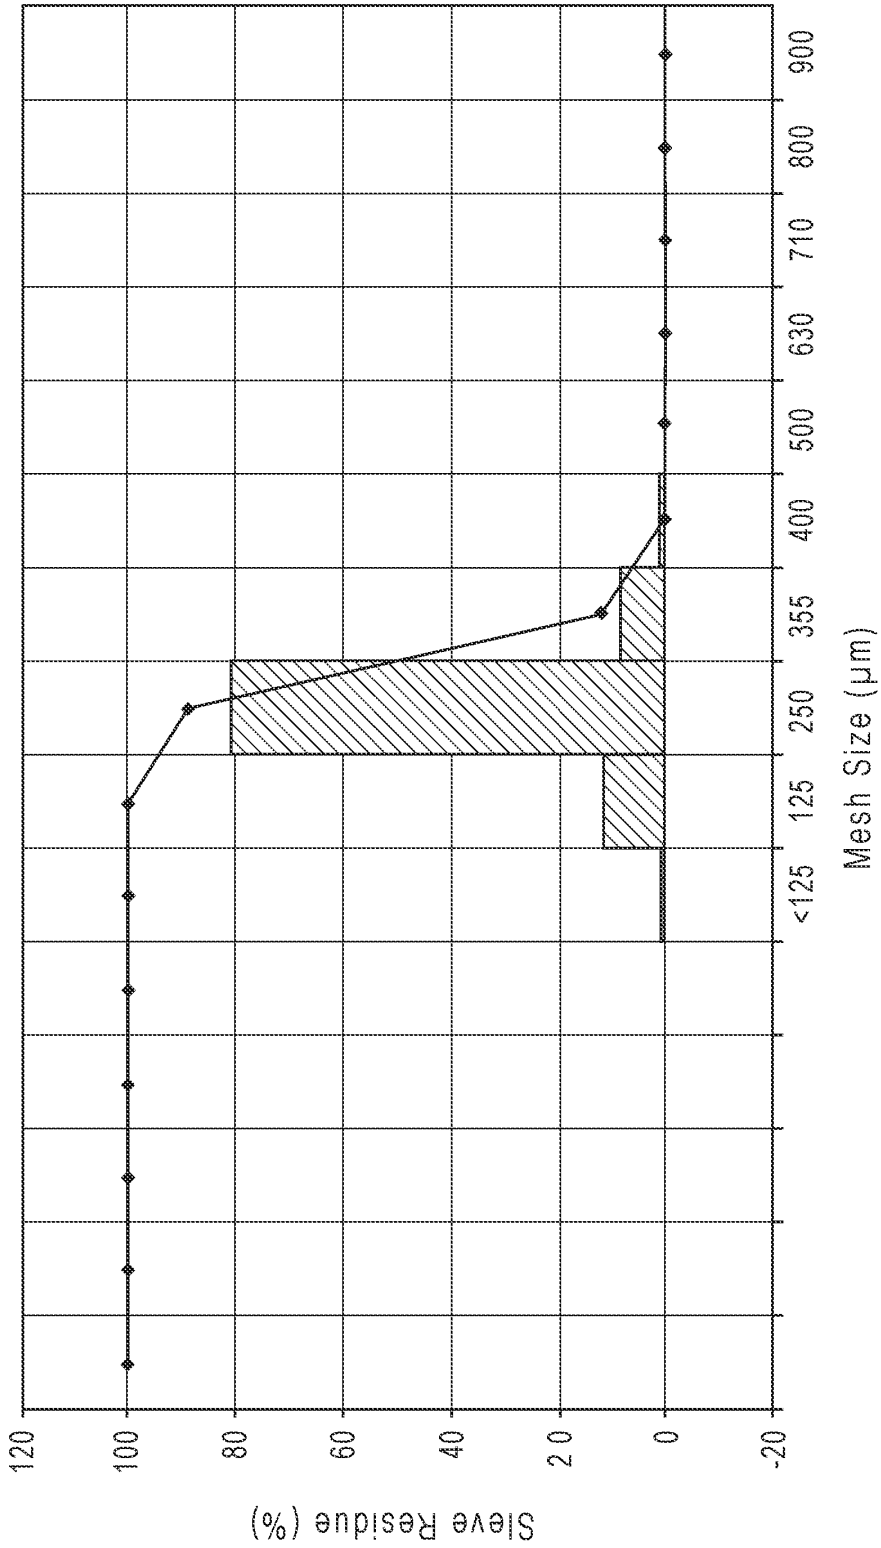

Sieve Residue (%)
120
100
80
60
40
20
0
-20
Mesh Size (µm)
<125
125
250
355
400
500
630
710
800
900

FIG. 3

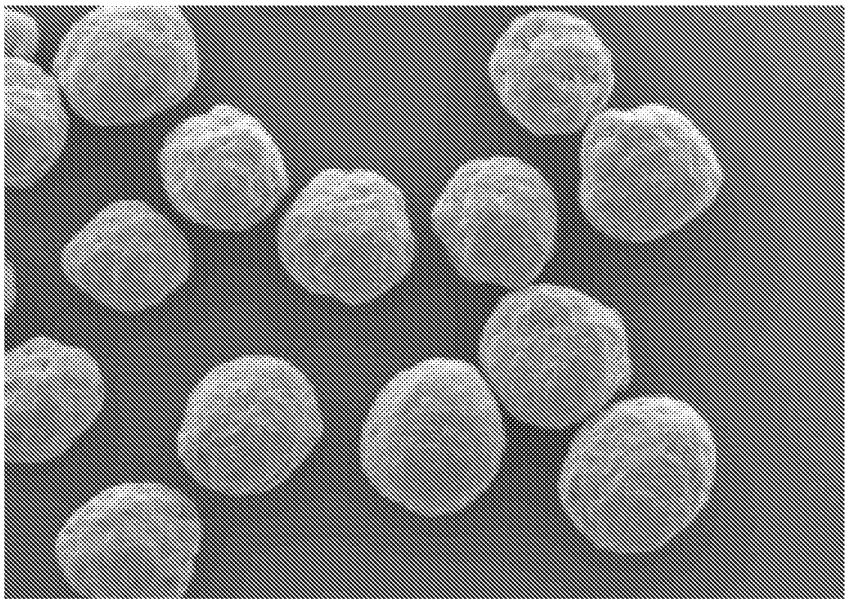


FIG. 4A

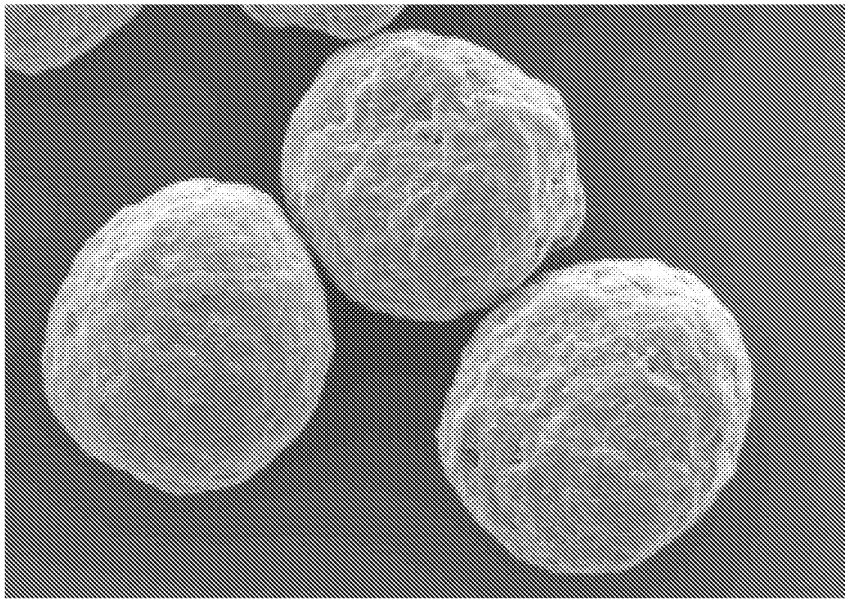


FIG. 4B

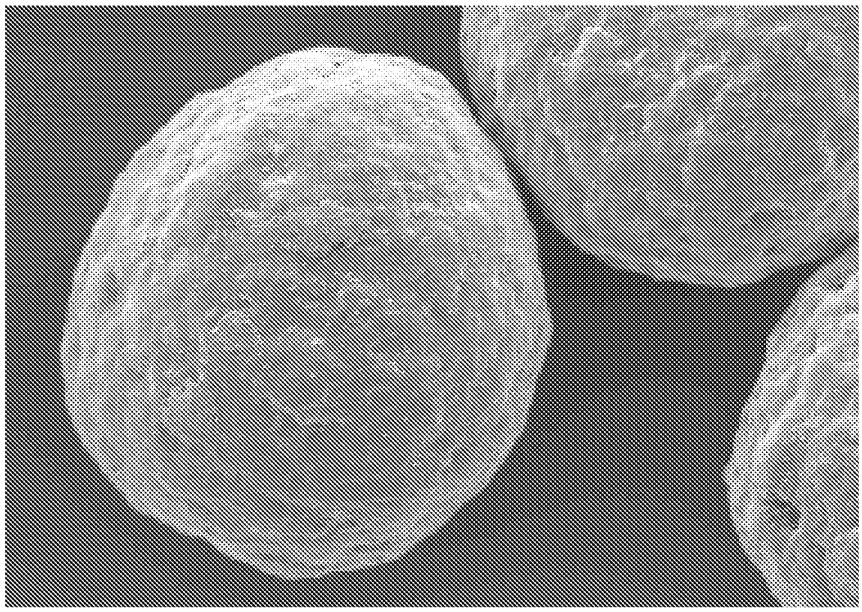


FIG. 4C

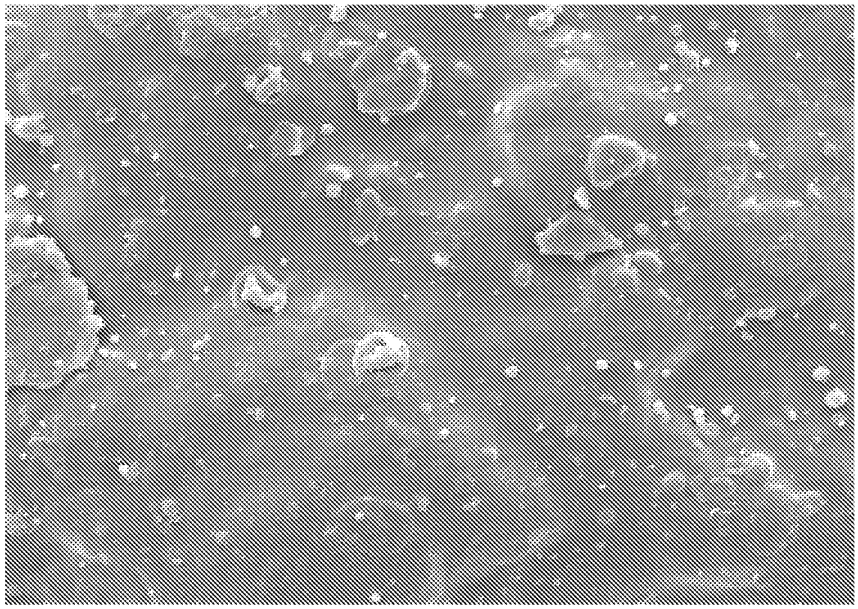


FIG. 4D

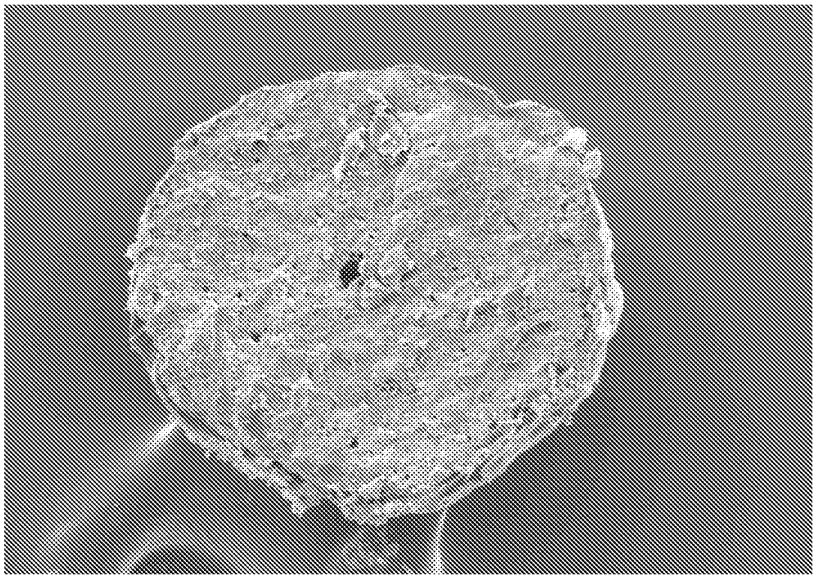


FIG. 4E

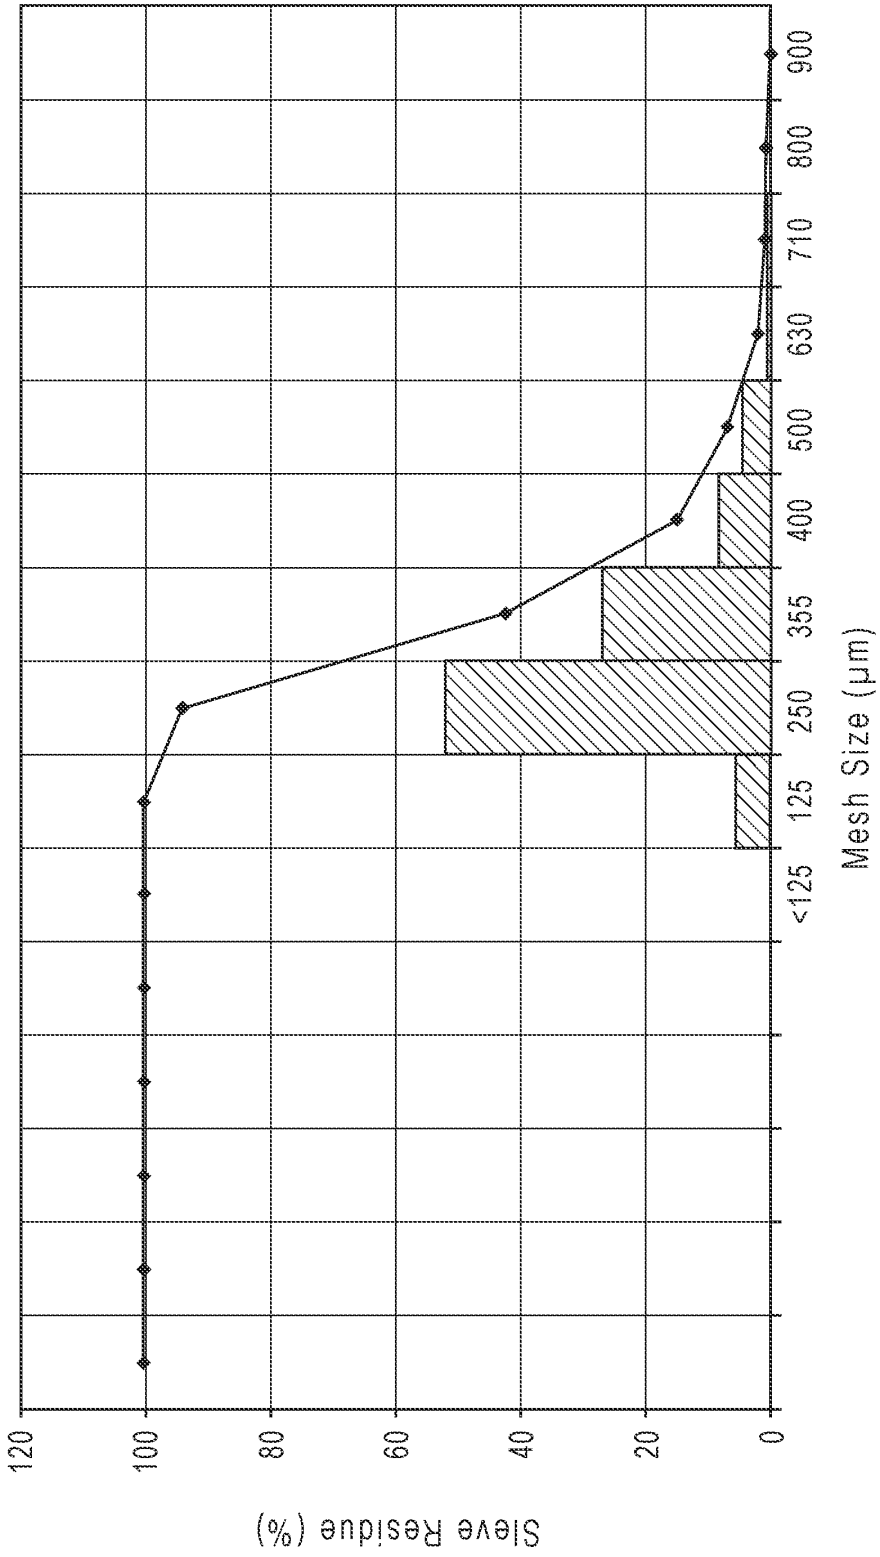

Sieve Residue (%)
120
100
80
60
40
20
0
Mesh Size (μm)
<125
125
250
355
400
500
630
710
800
900

FIG. 5

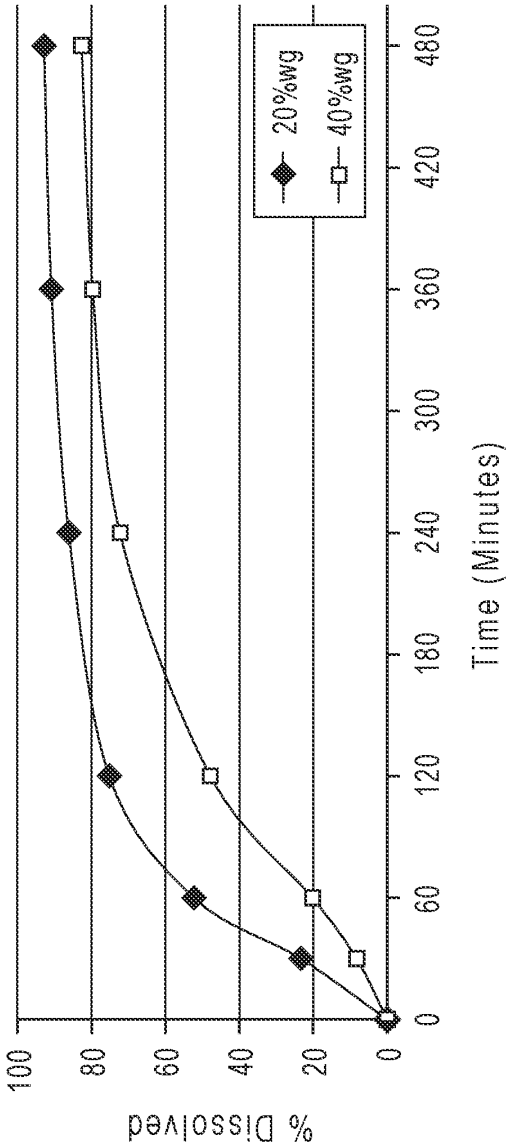

% Dissolved
100
80
60
40
20
0
0
60
120
180
240
300
360
420
480
Time (Minutes)
20%wg
40%wg

FIG. 6

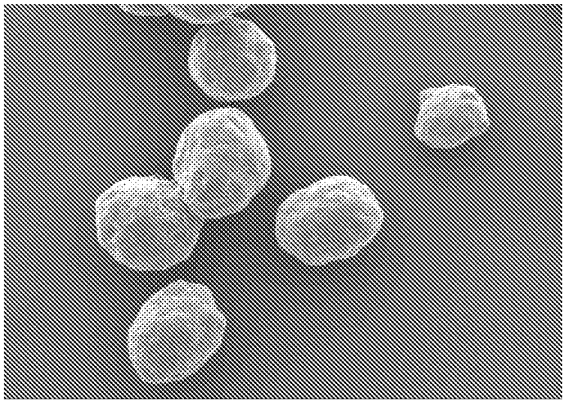


FIG. 7A

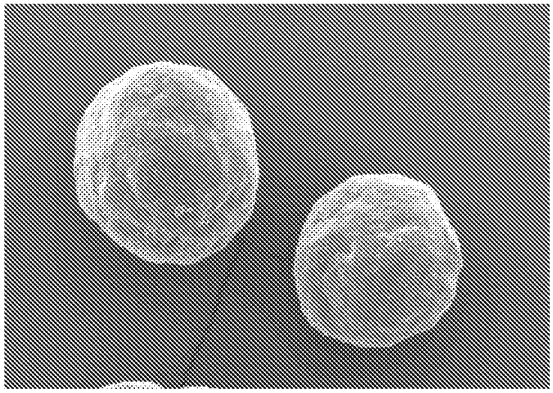


FIG. 7B

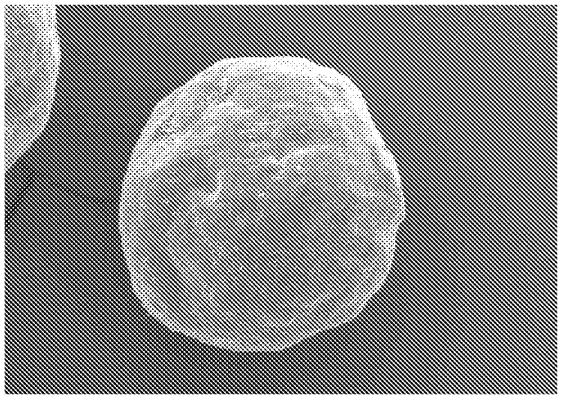


FIG. 7C

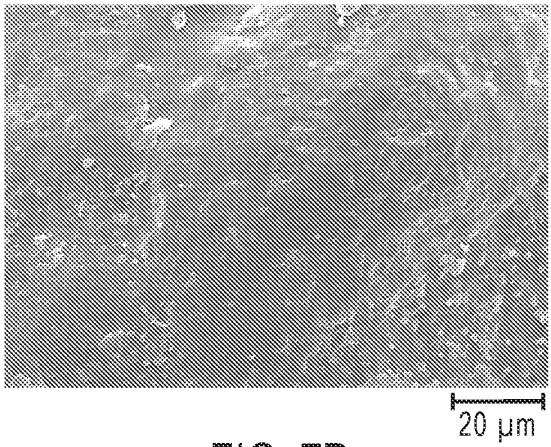


FIG. 7D

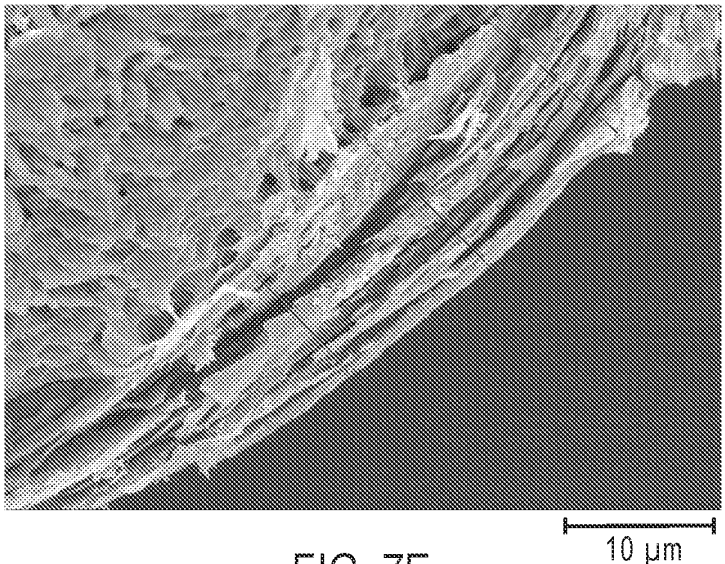


FIG. 7E

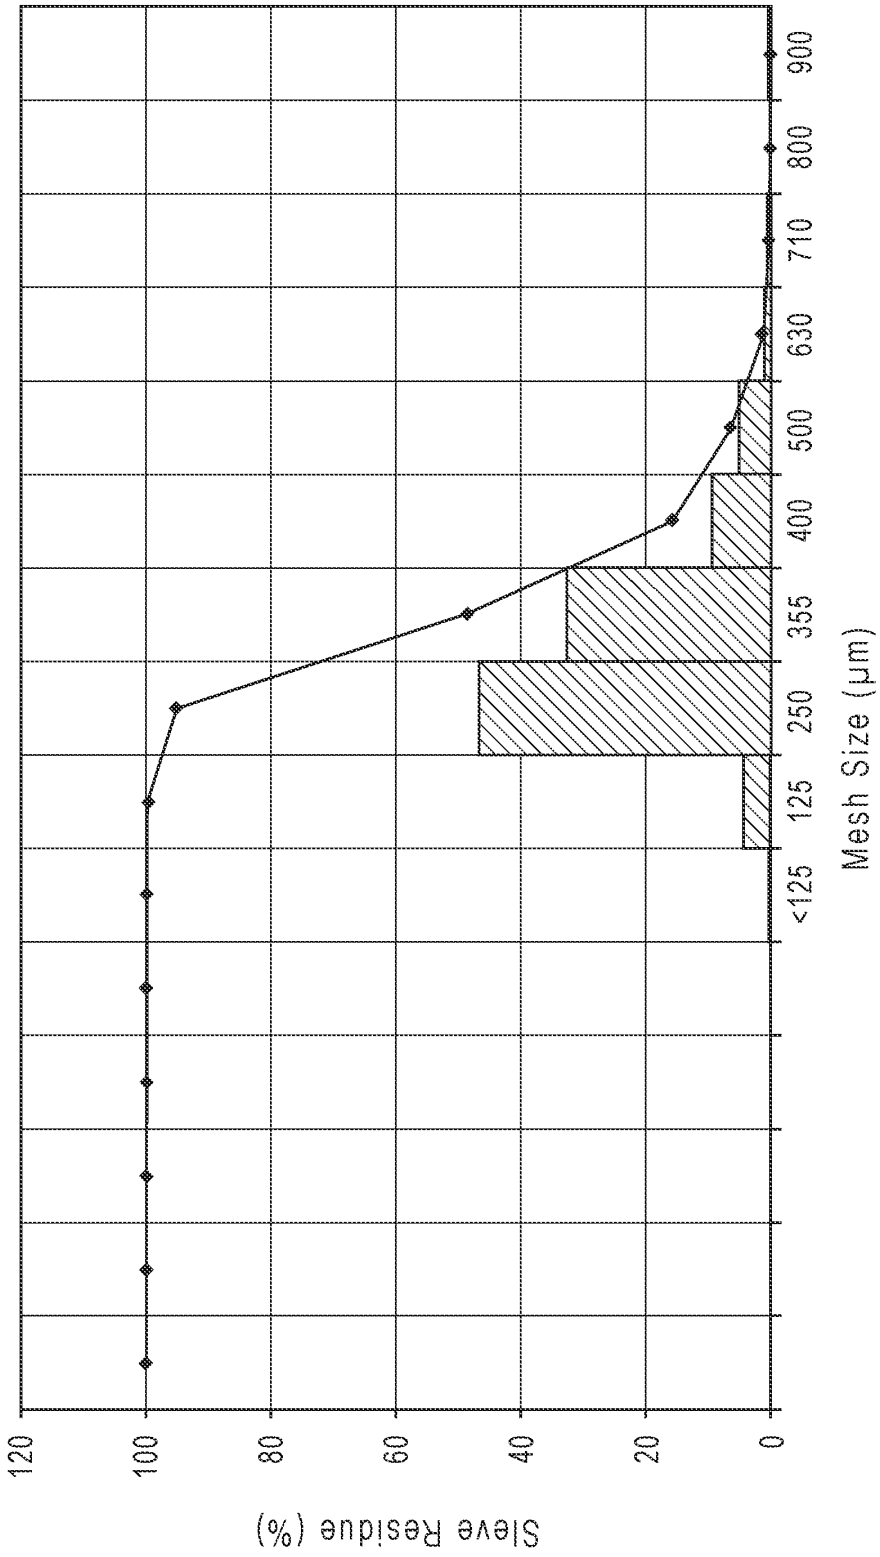

Sieve Residue (%)
120
100
80
60
40
20
0
Mesh Size (µm)
<125
125
250
355
400
500
630
710
800
900

FIG. 8

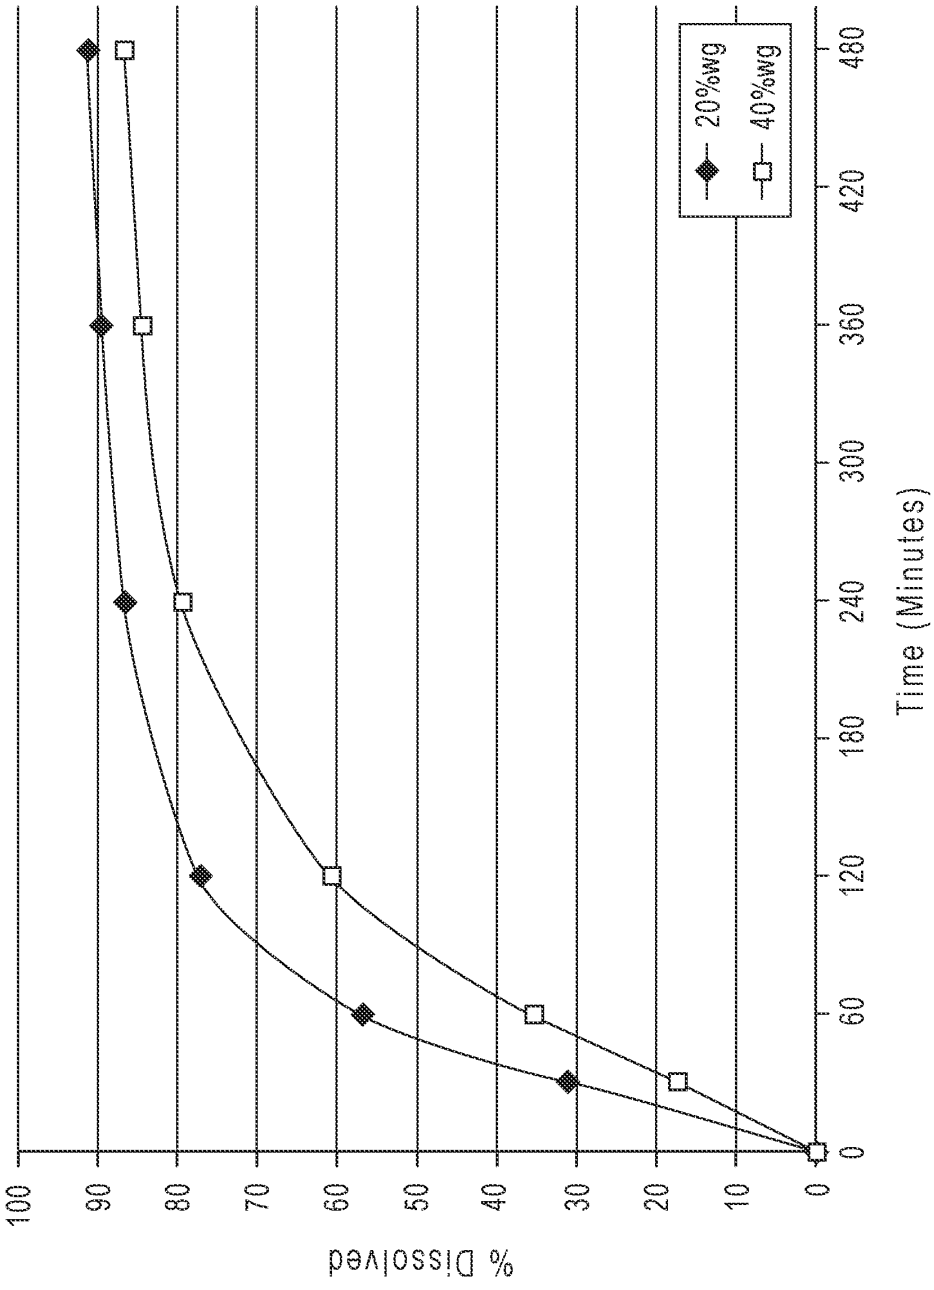

% Dissolved
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
60
120
180
240
300
360
420
480
Time (Minutes)
20%wg
40%wg

FIG. 9

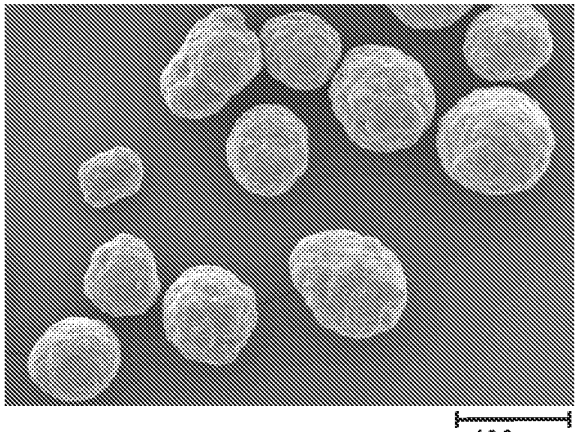


FIG. 10A

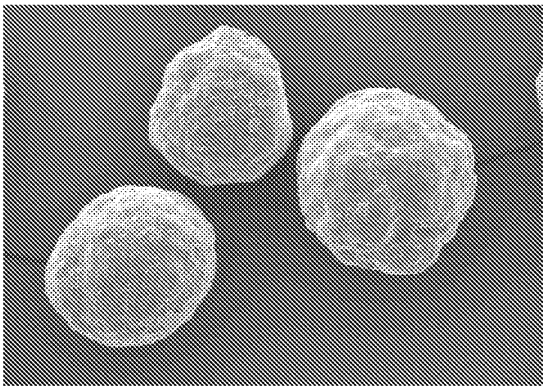


FIG. 10B

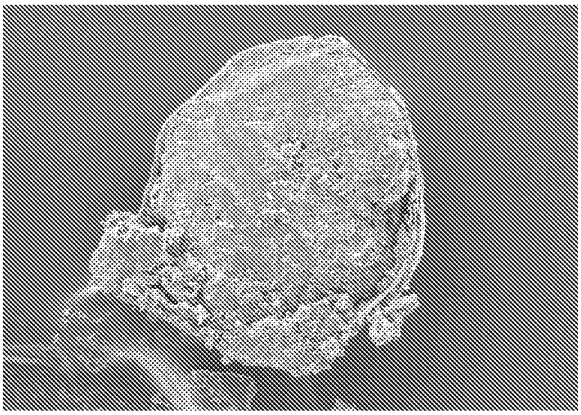


FIG. 10C

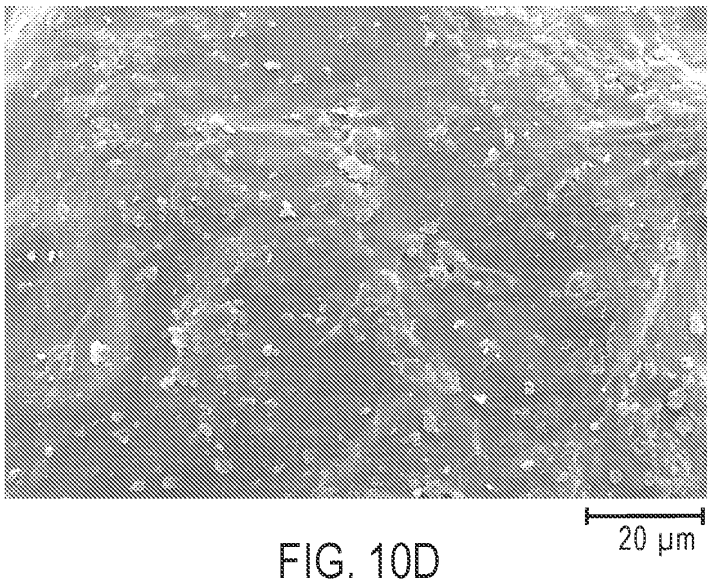


FIG. 10D

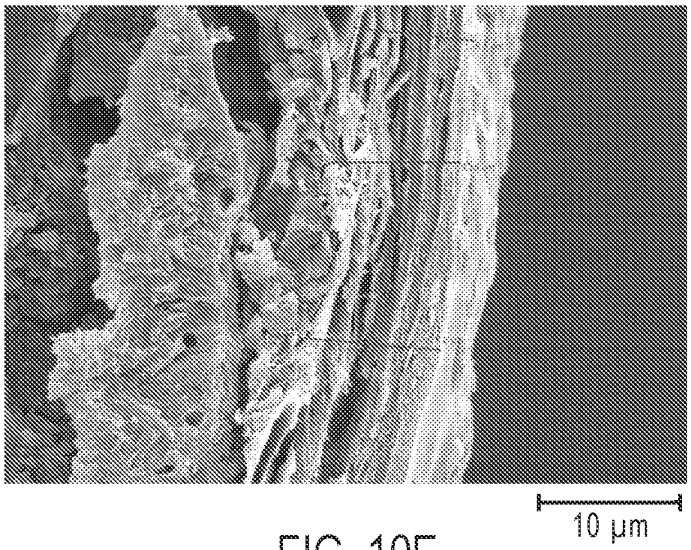


FIG. 10E

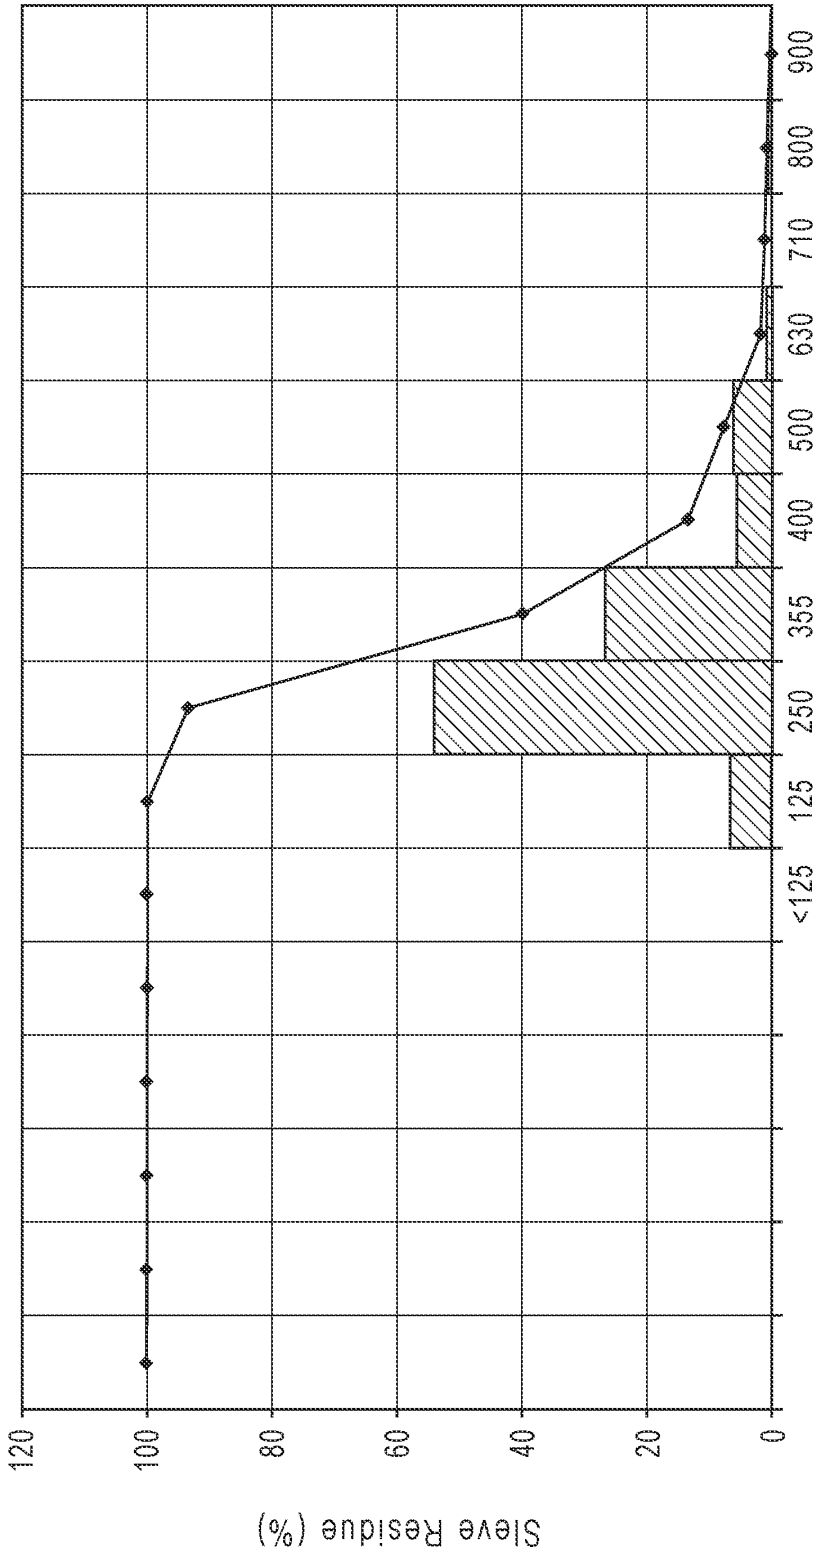

Sieve Residue (%)
120
100
80
60
40
20
0
Mesh Size (µm)
<125
125
250
355
400
500
630
710
800
900

FIG. 11

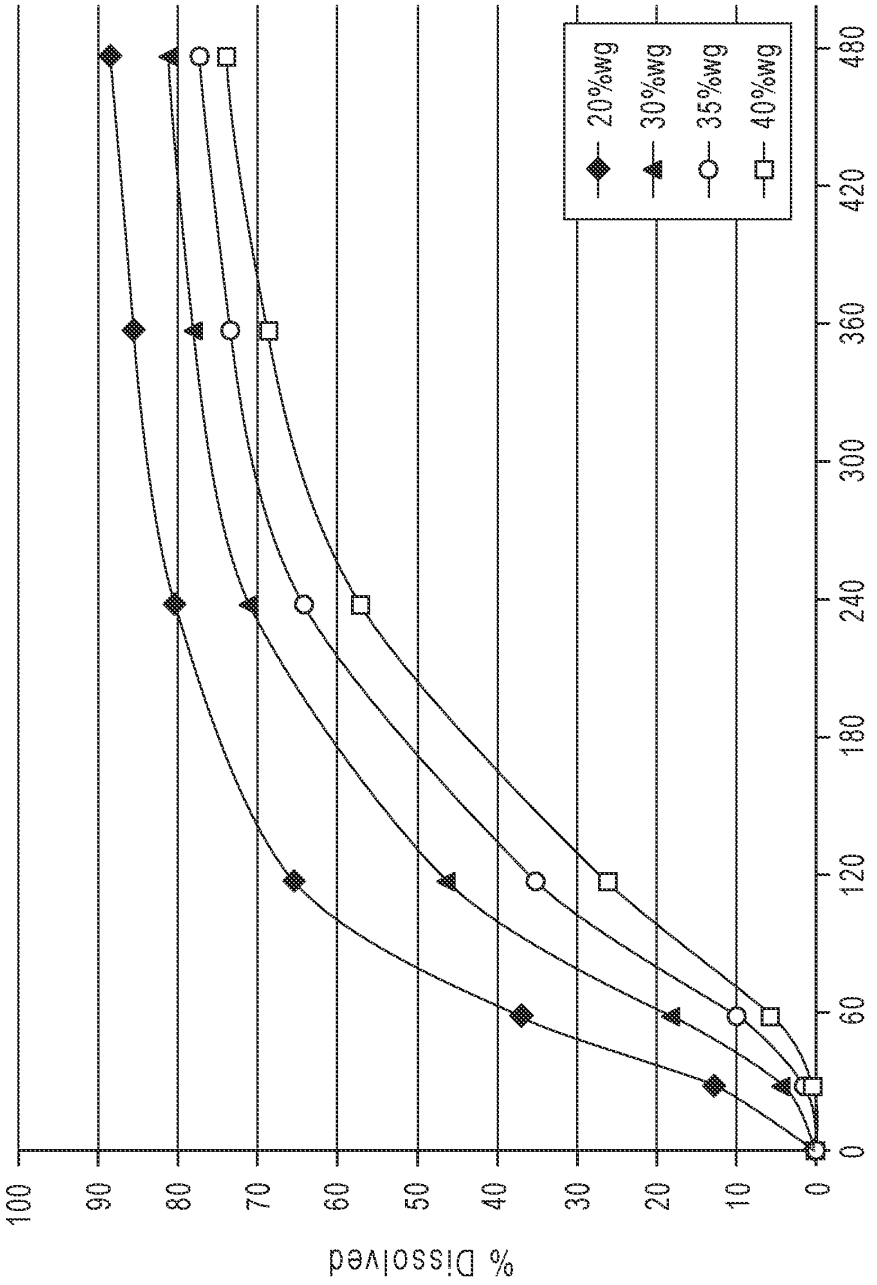

% Dissolved
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Time (Minutes)
0
60
120
180
240
300
360
420
480
20%wg
30%wg
35%wg
40%wg

FIG. 12

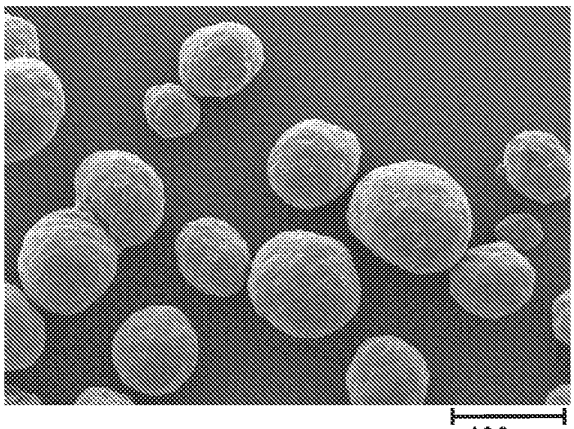


FIG. 13A

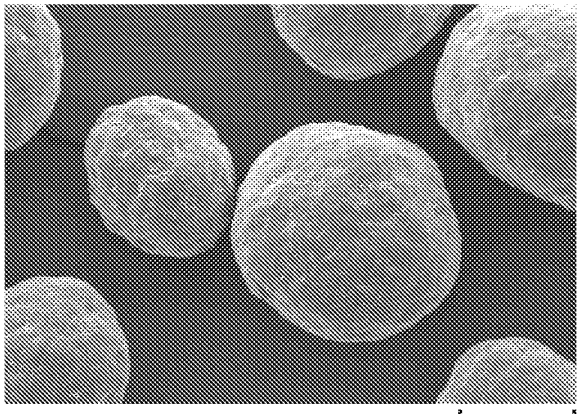


FIG. 13B

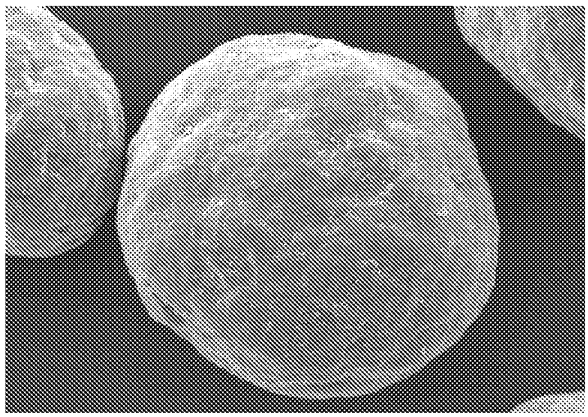


FIG. 13C

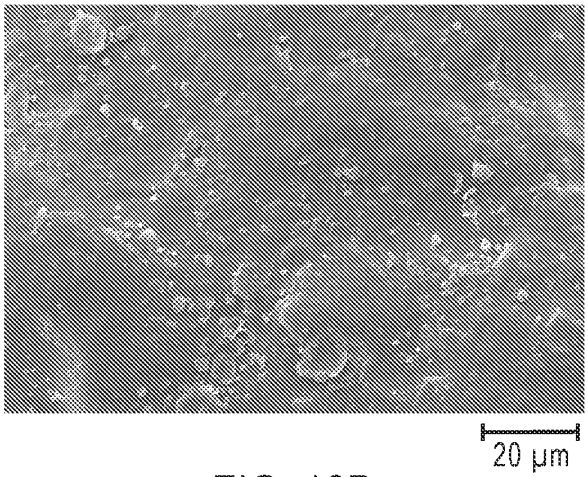


FIG. 13D

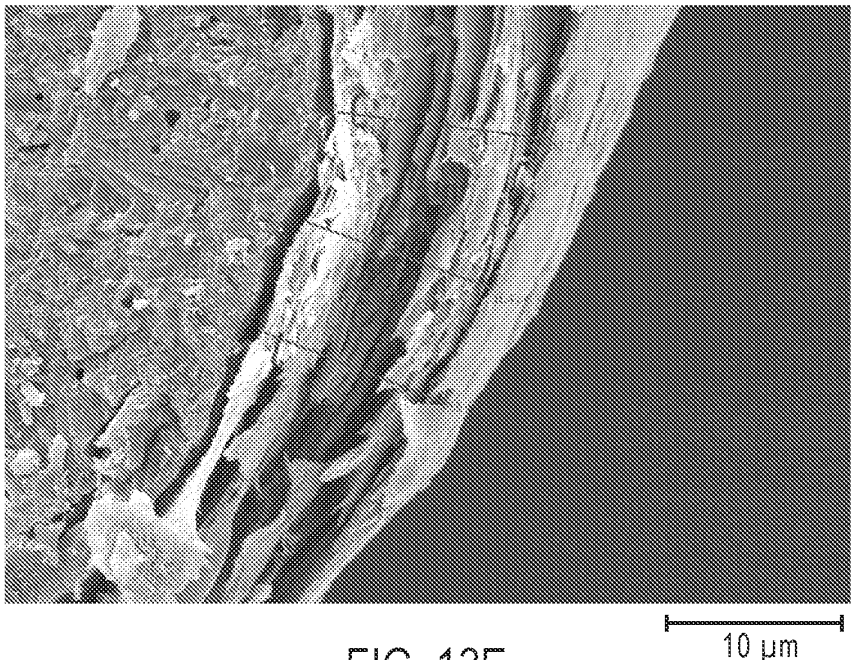


FIG. 13E

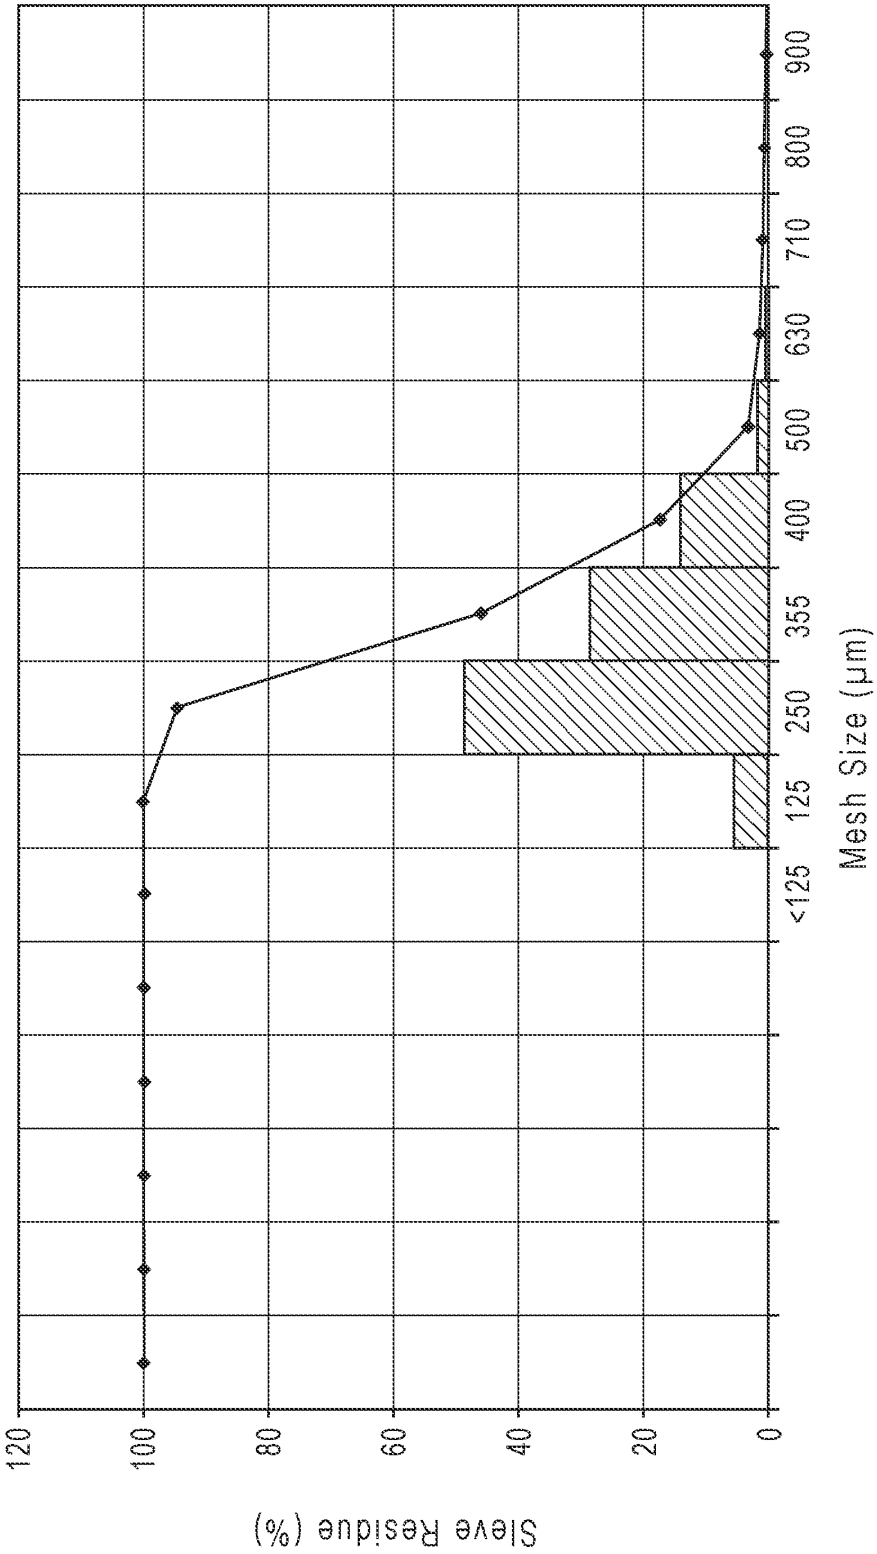

Sieve Residue (%)
120
100
80
60
40
20
0
Mesh Size (µm)
<125
125
250
355
400
500
630
710
800
900

FIG. 14

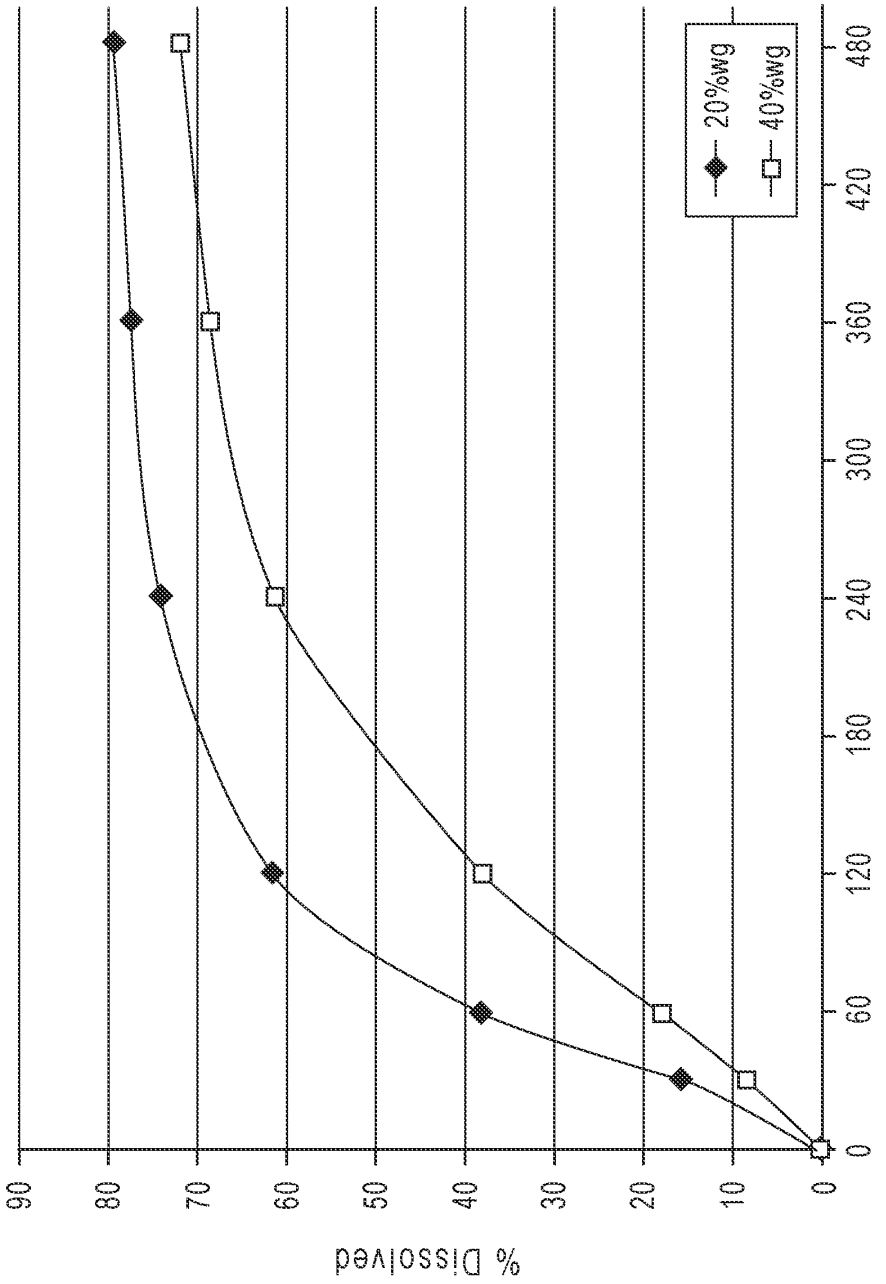

% Dissolved
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Time (Minutes)
0
60
120
180
240
300
360
420
480
20%wg
40%wg

FIG. 15

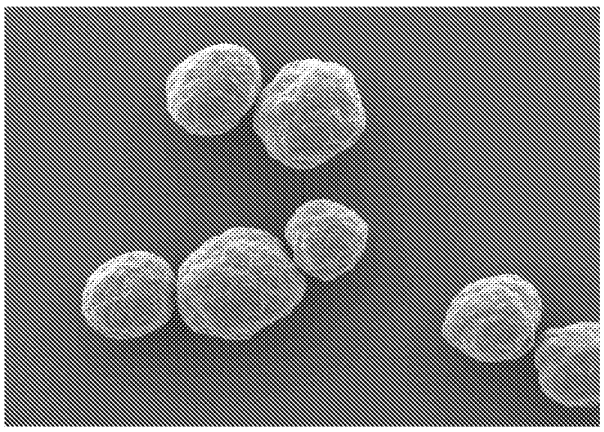


FIG. 16A

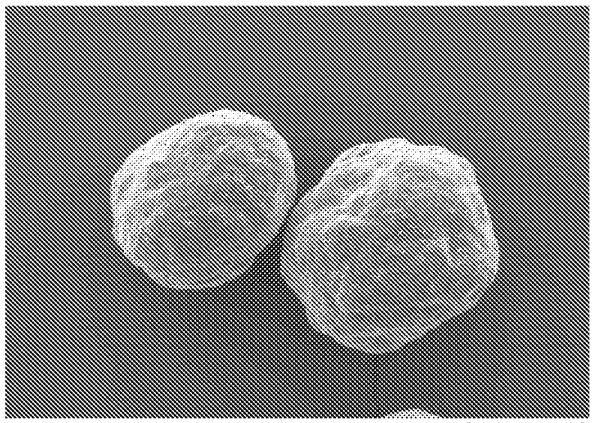


FIG. 16B

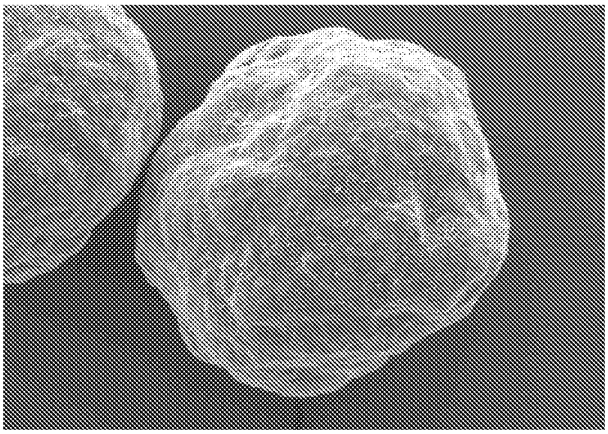


FIG. 16C

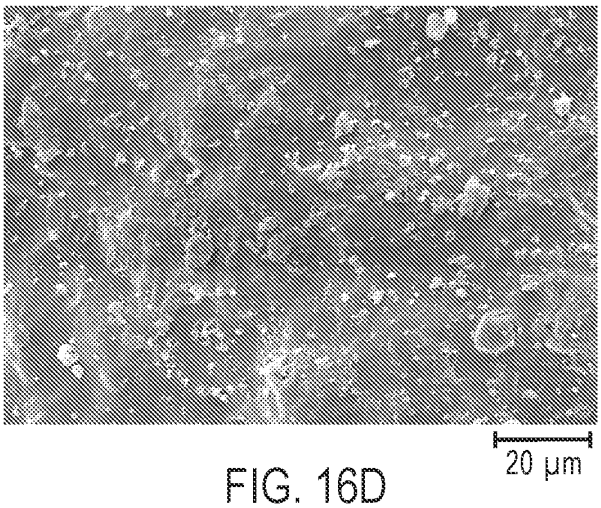


FIG. 16D

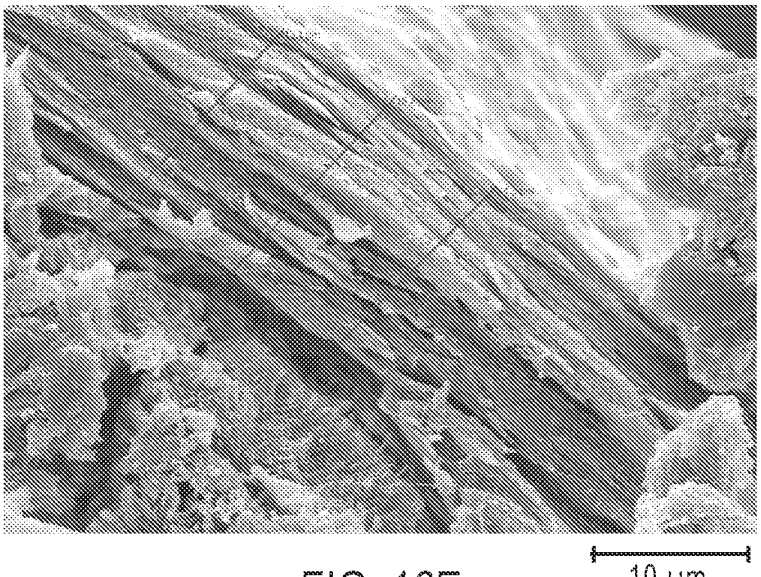


FIG. 16E

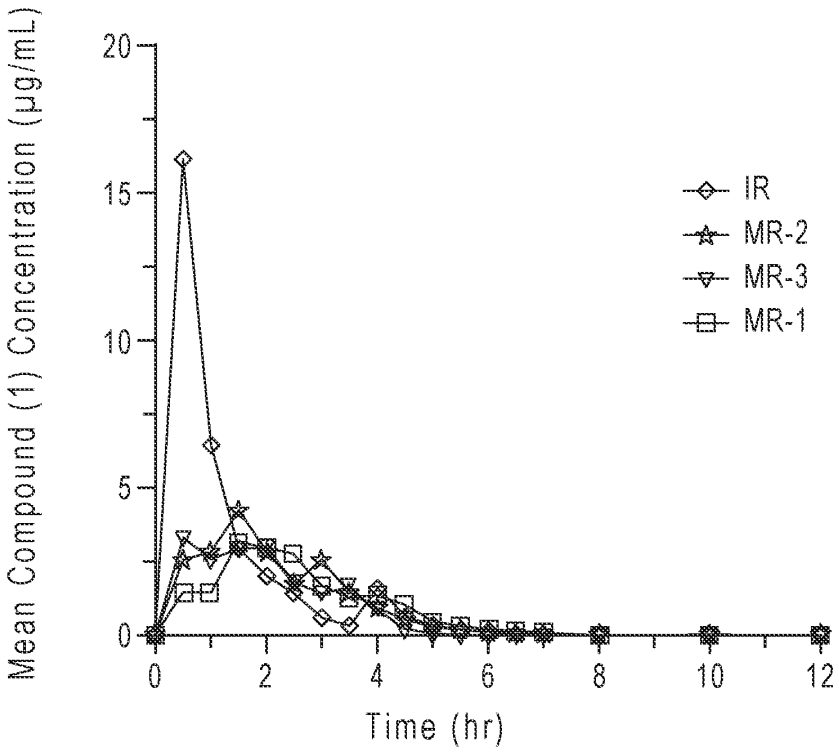

Mean Compound (1) Concentration (µg/mL)
20
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
12
Time (hr)
IR
MR-2
MR-3
MR-1

FIG. 17

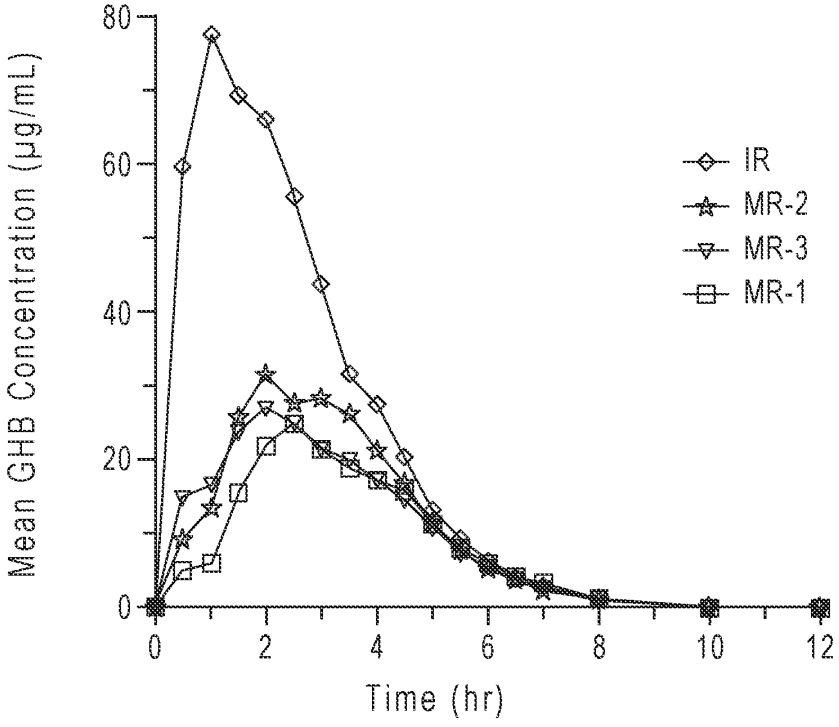

Mean GHB Concentration (µg/mL)
80
60
40
20
0
0
2
4
6
8
10
12
Time (hr)
IR
MR-2
MR-3
MR-1

FIG. 18

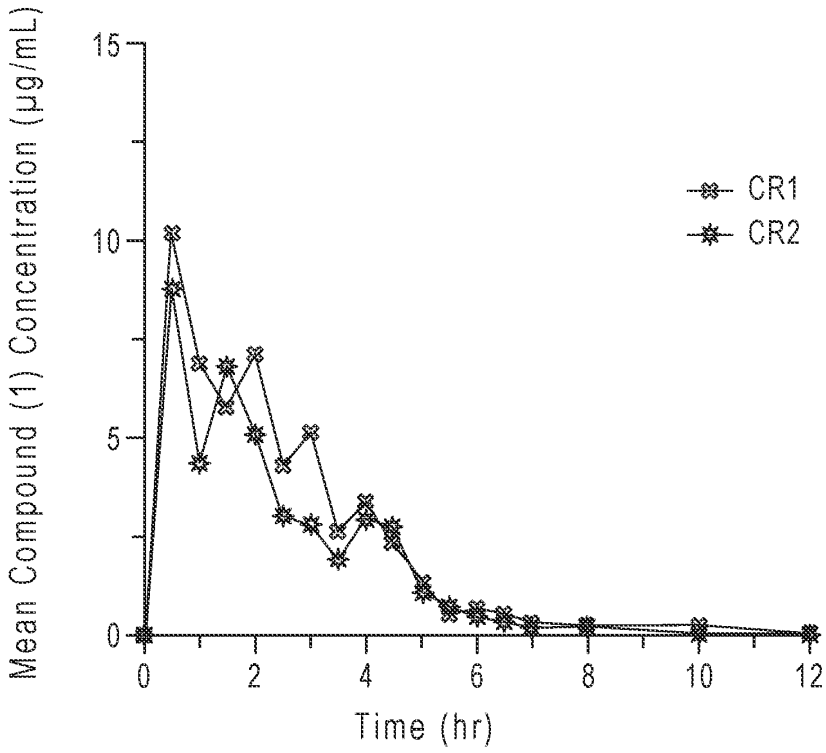

Mean Compound (1) Concentration (µg/mL)
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
12
Time (hr)
CR1
CR2

FIG. 19

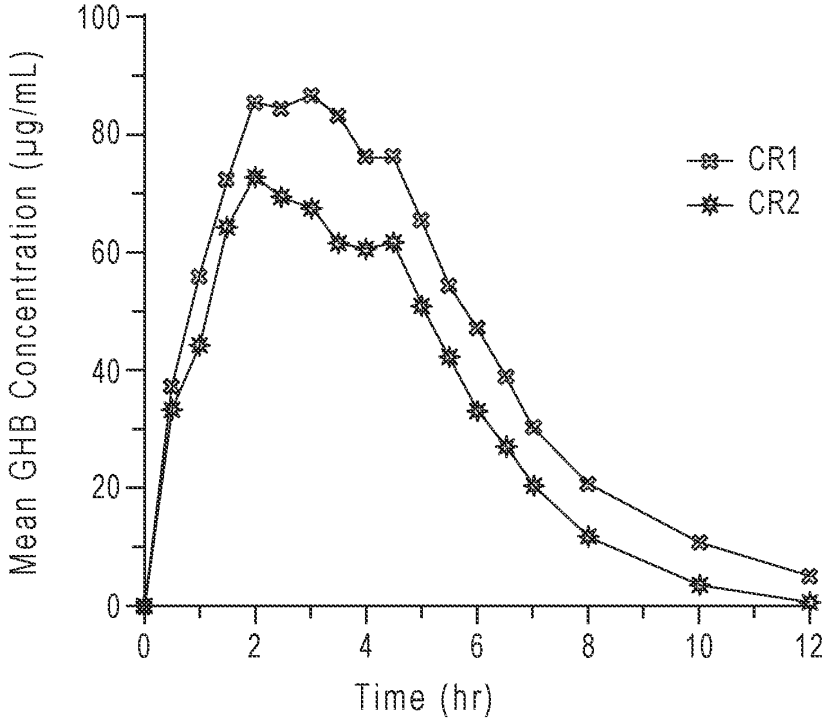

Mean GHB Concentration (µg/mL)
100
80
60
40
20
0
0
2
4
6
8
10
12
Time (hr)
CR1
CR2

FIG. 20