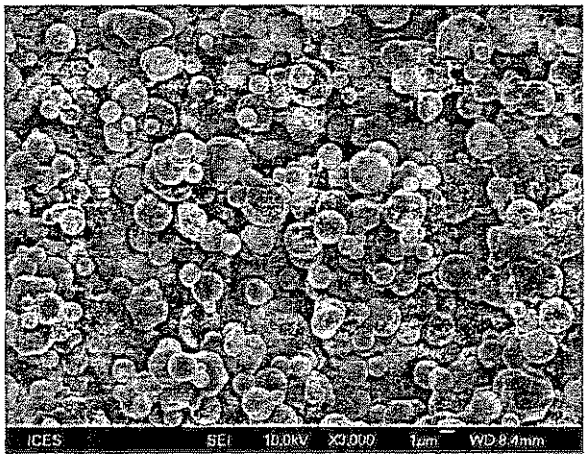

ICES
SEI 10.0kV X3,000 1μm WD 8.4mm

Fig. 1

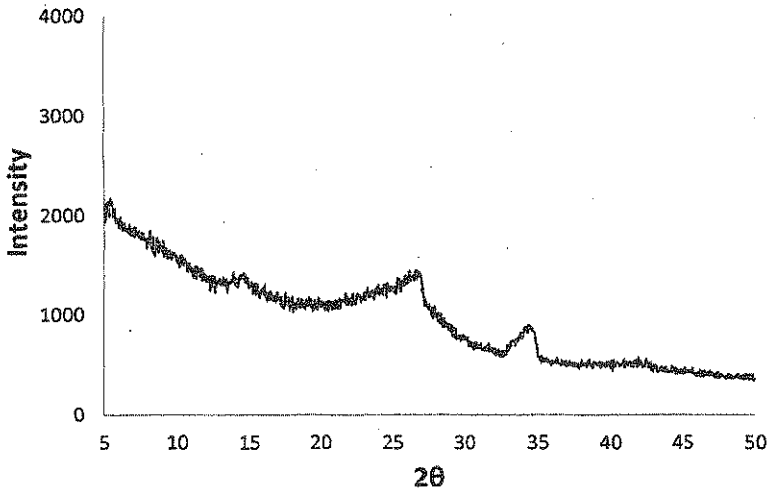

4000
3000
2000
1000
0
Intensity
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2θ

Fig. 2

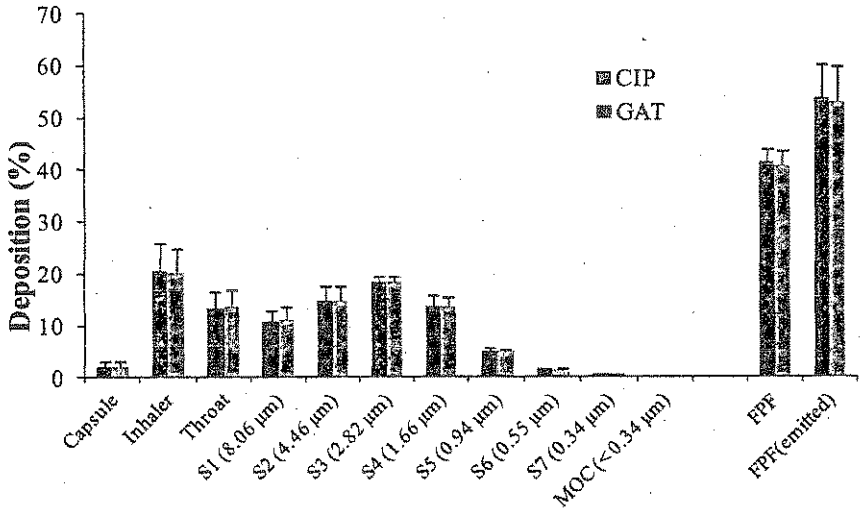

70
60
50
40
30
20
10
0
Deposition (%)
CIP
GAT
Capsule
Inhaler
Throat
S1 (8.06 µm)
S2 (4.46 µm)
S3 (2.82 µm)
S4 (1.66 µm)
S5 (0.94 µm)
S6 (0.55 µm)
S7 (0.34 µm)
MOC(<0.34 µm)
FPF
FPF(emitted)

Fig. 3