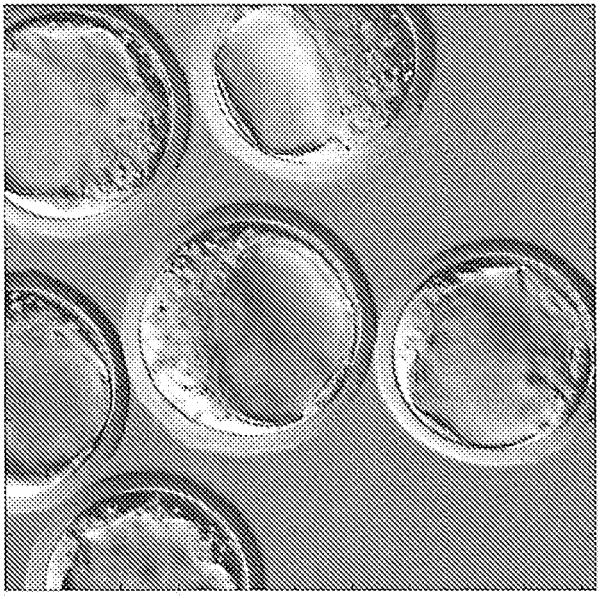
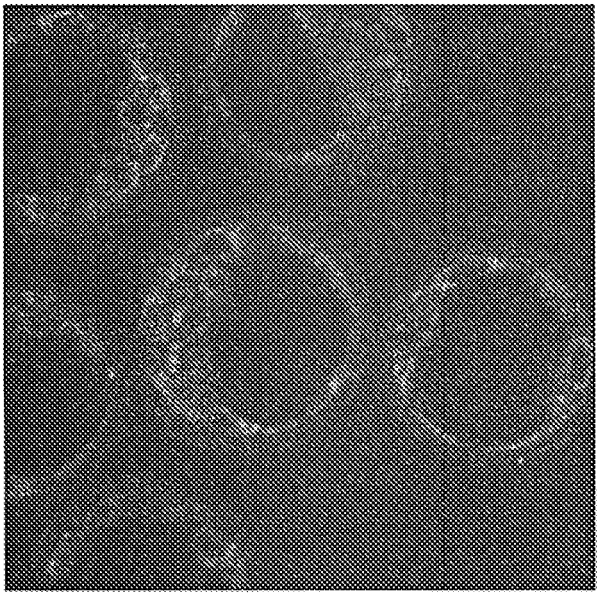


FIG. 1



Panel B



Panel A

FIG. 2

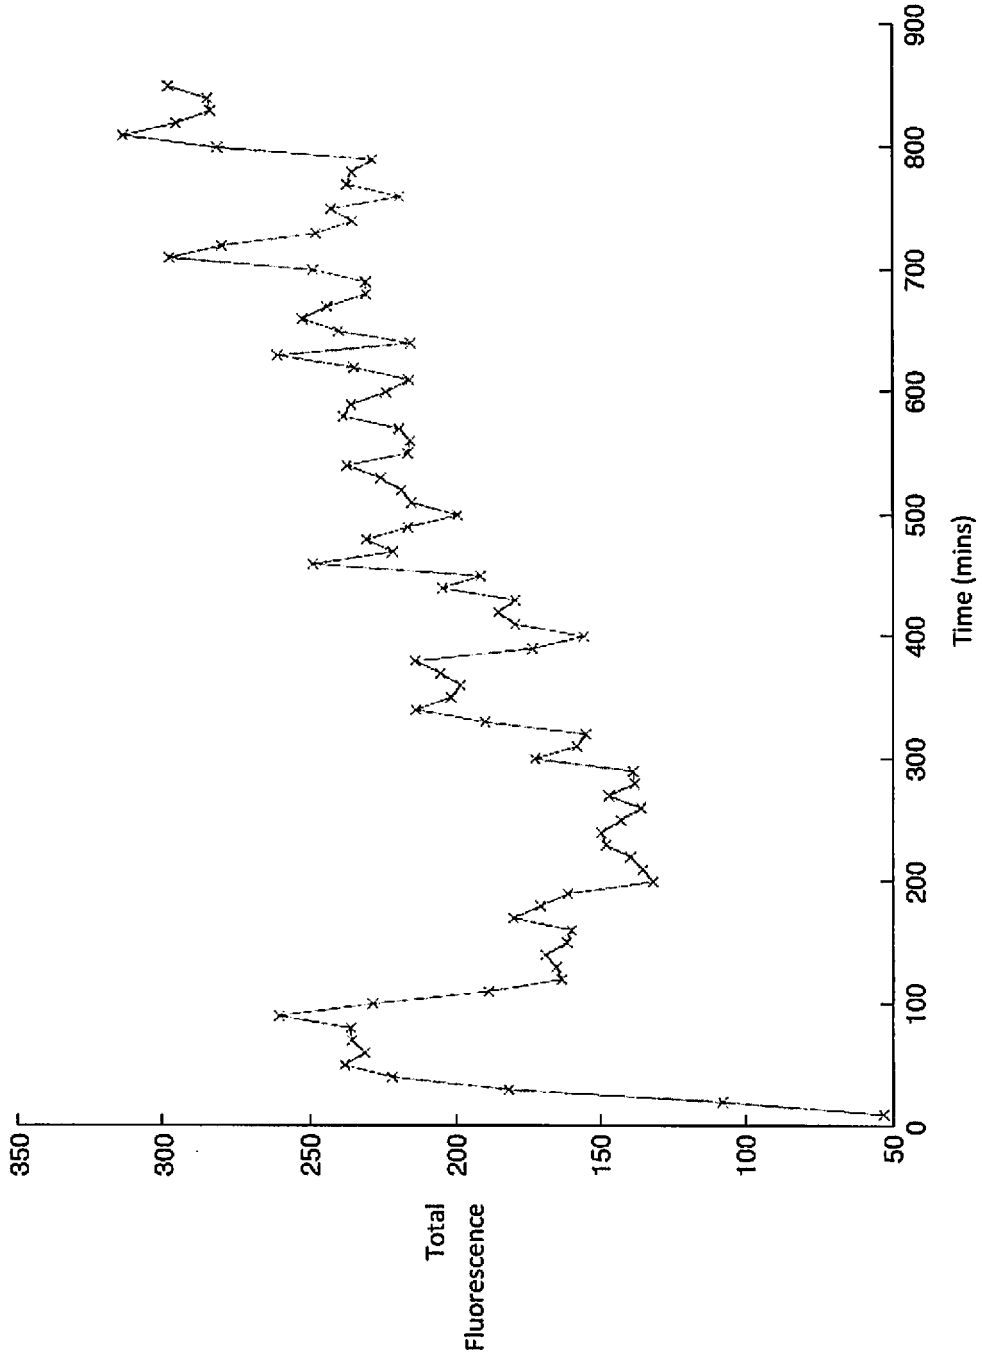

Total Fluorescence
350
300
250
200
150
100
50
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Time (mins)

FIG. 3