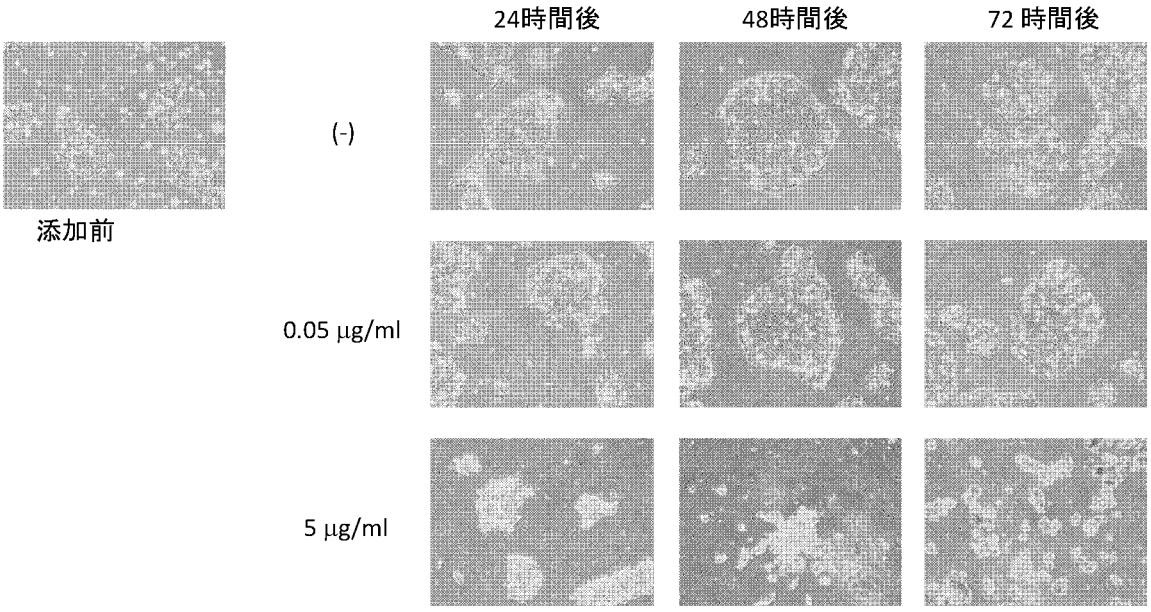
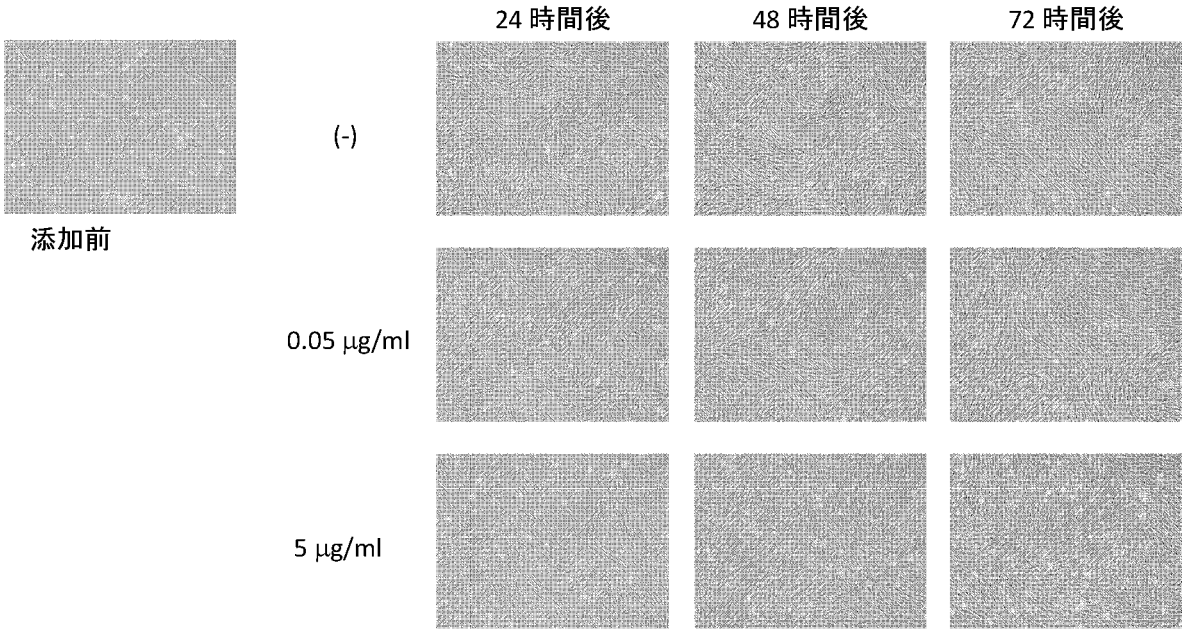
[図1]

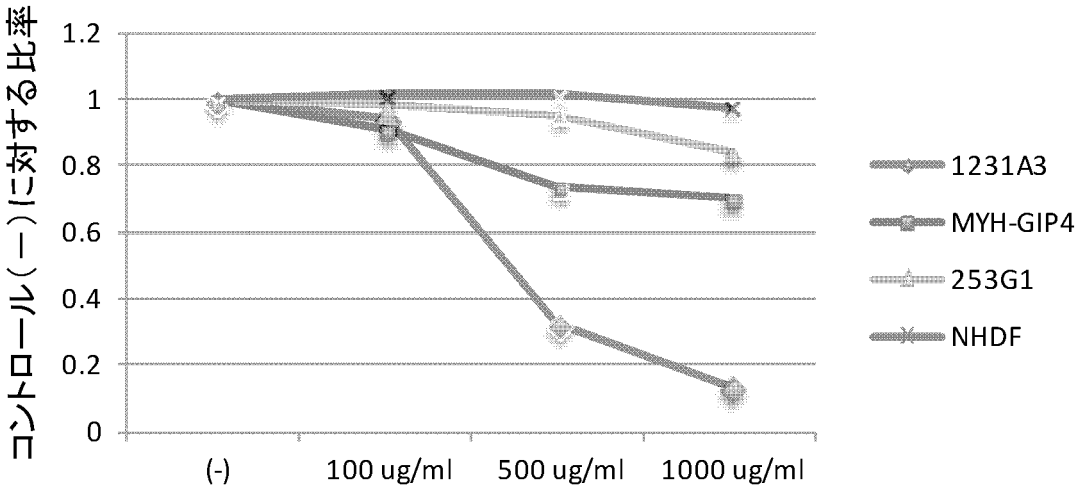

24時間後
48時間後
72 時間後
(-)
0.05 μg/ml
5 μg/ml
添加前

1

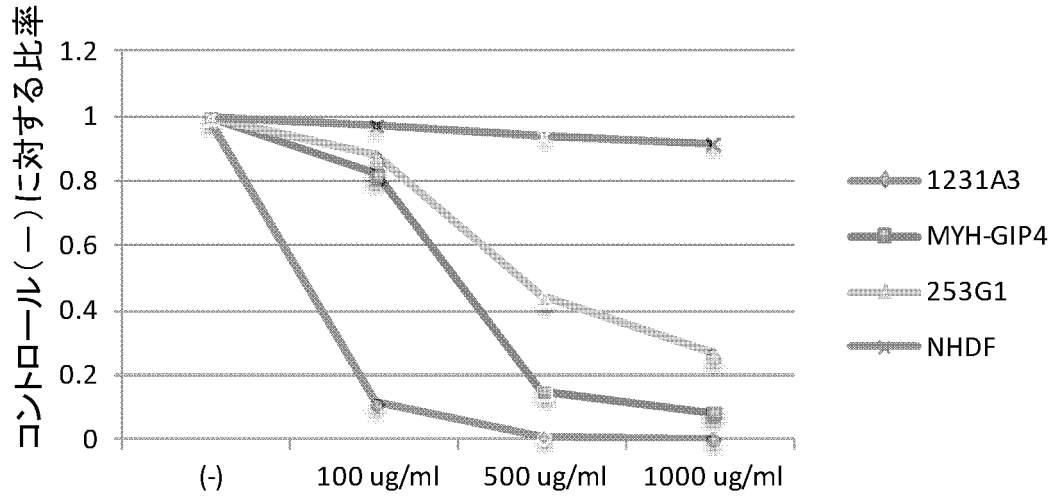
[図2]


24 時間後
48 時間後
72 時間後
(-)
0.05 μg/ml
5 μg/ml
添加前

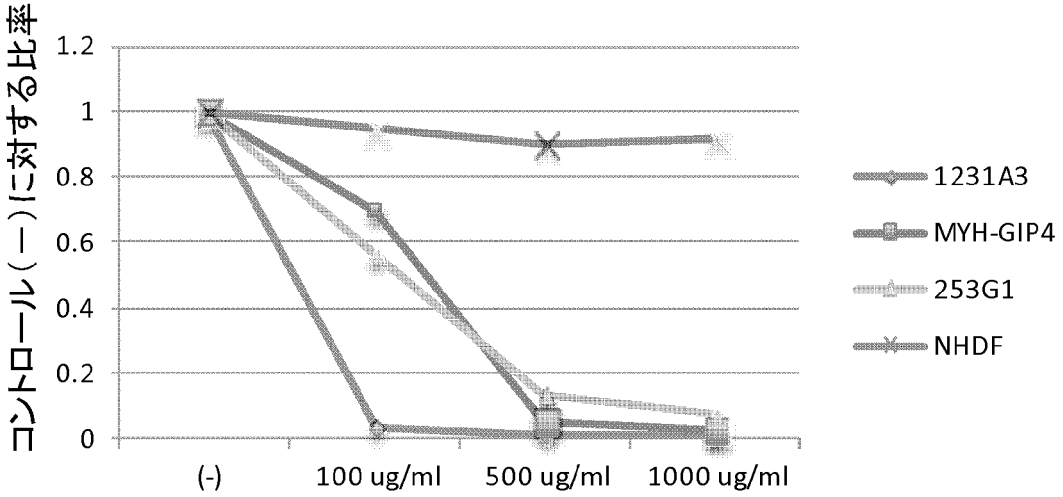
[図3]


コントロール(−)に対する比率
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
(-)
100 ug/ml
500 ug/ml
1000 ug/ml
1231A3
MYH-GIP4
253G1
NHDF

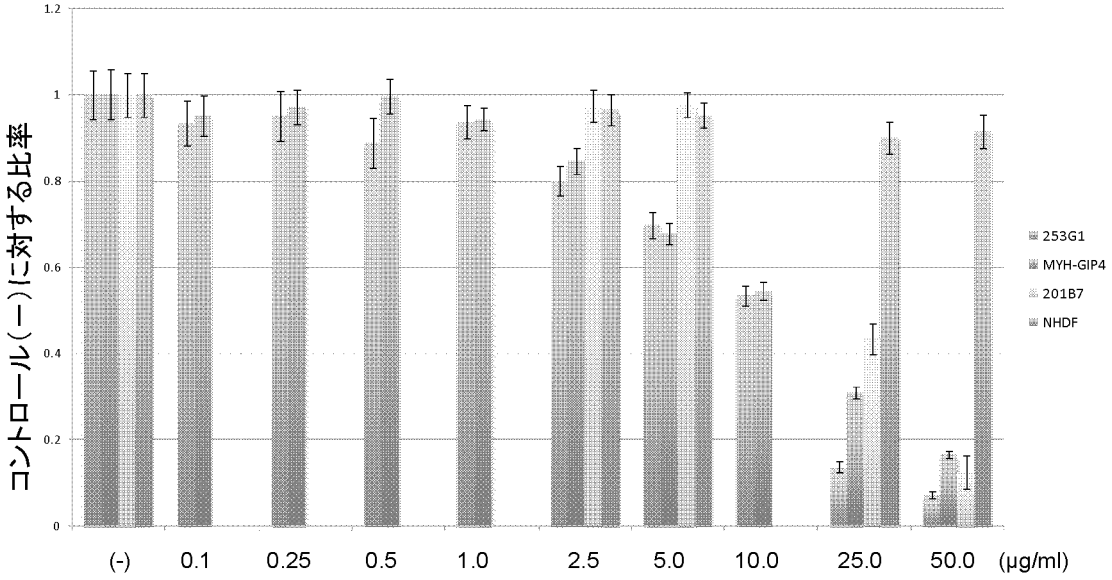
[図4]


コントロール(−)に対する比率
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
(-)
100 ug/ml
500 ug/ml
1000 ug/ml
1231A3
MYH-GIP4
253G1
NHDF

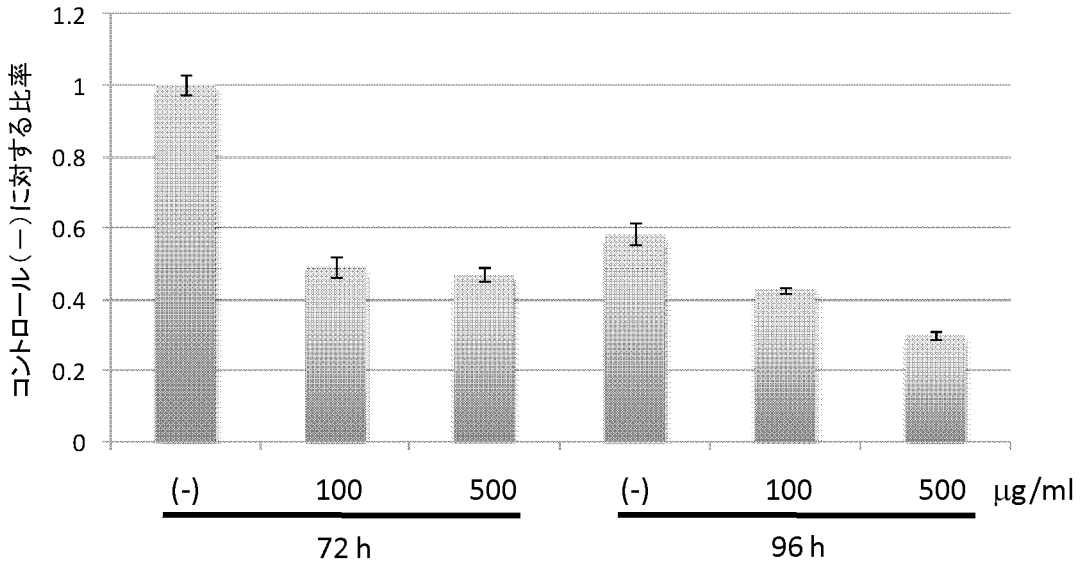
[図5]


コントロール(−)に対する比率
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
(-)
100 ug/ml
500 ug/ml
1000 ug/ml
1231A3
MYH-GIP4
253G1
NHDF

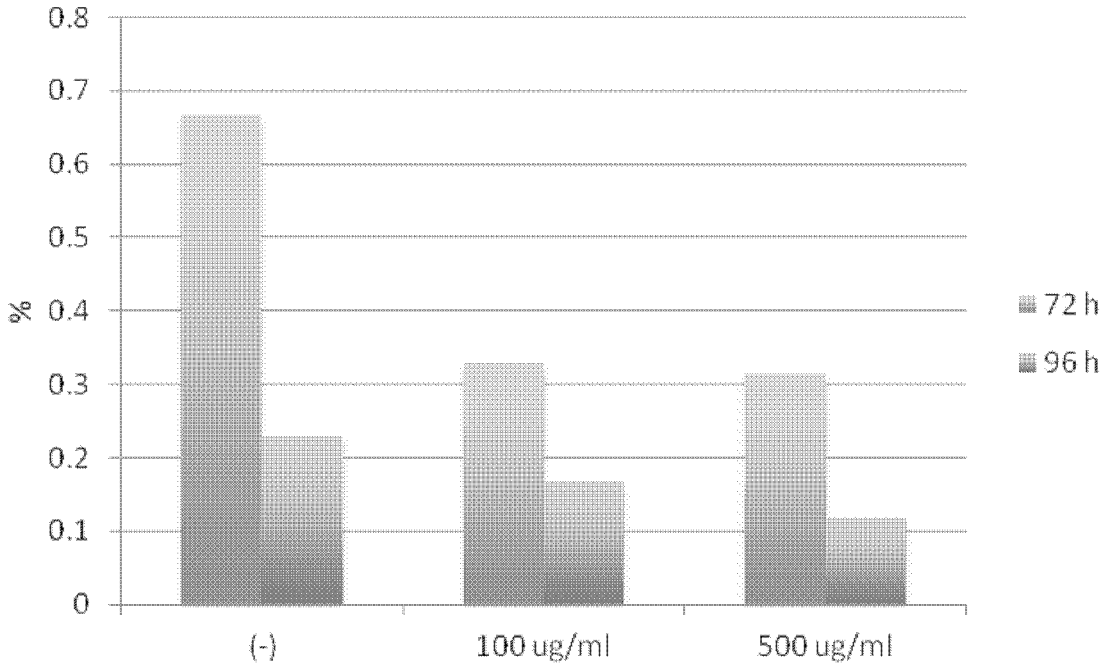
[図6]


コントロール(−)に対する比率
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
(-)
0.1
0.25
0.5
1.0
2.5
5.0
10.0
25.0
50.0
(μg/ml)
253G1
MYH-GIP4
201B7
NHDF

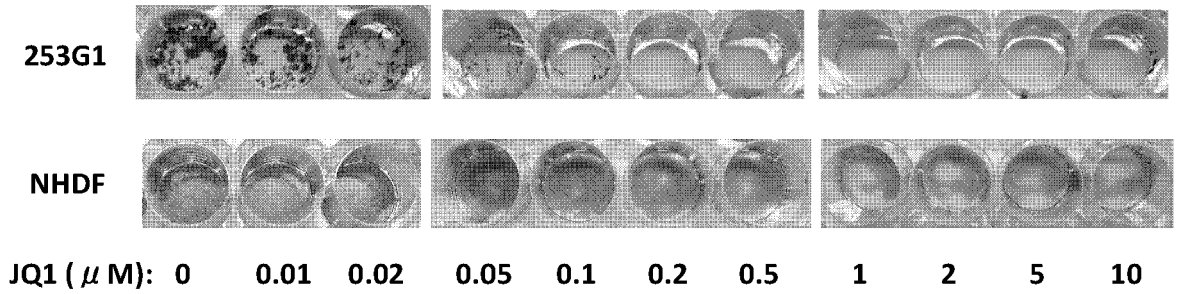
[図7]


コントロール(−)に対する比率
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
(-)
100
500
(-)
100
500
μg/ml
72 h
96 h

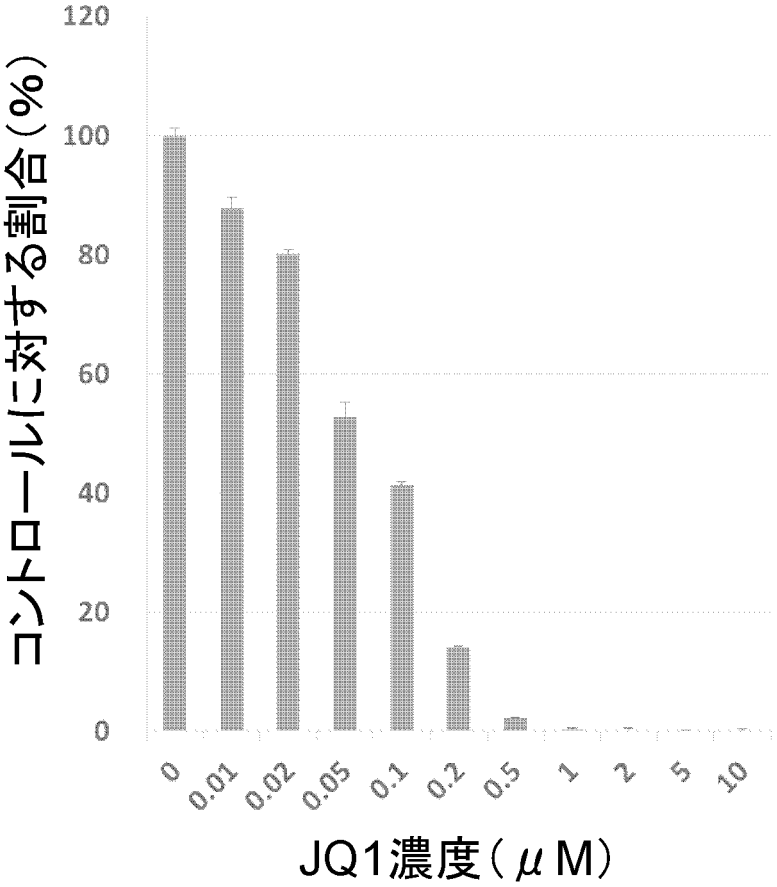
[図8]


0.8
0.7
0.6
0.5
% 0.4
0.3
0.2
0.1
0
(-)
100 ug/ml
500 ug/ml
72 h
96 h

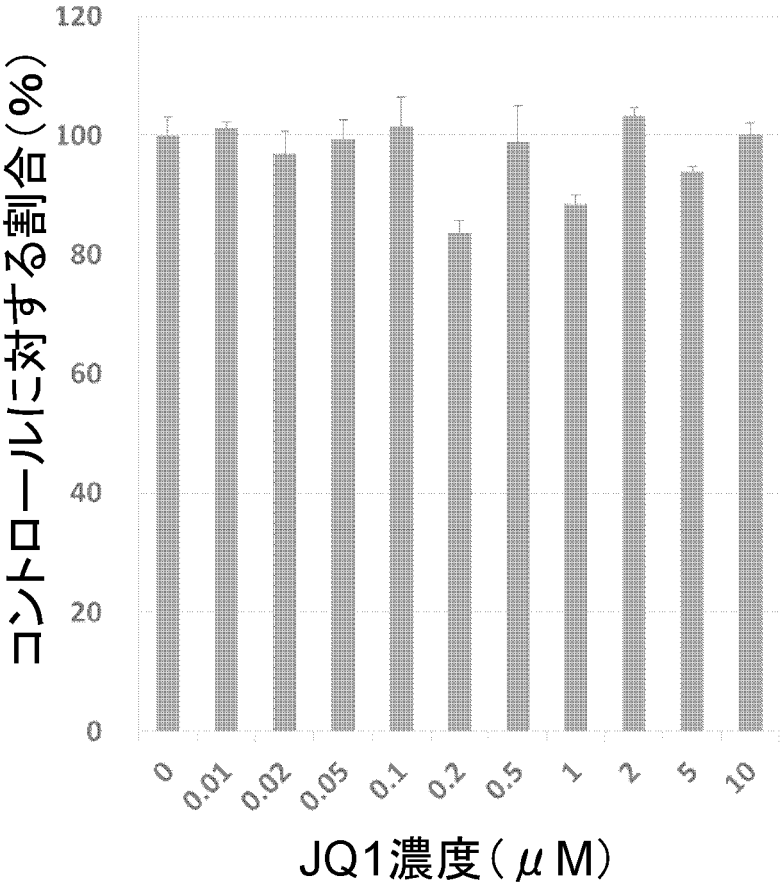
[図9]


253G1
NHDF
JQ1 (μM): 0 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10

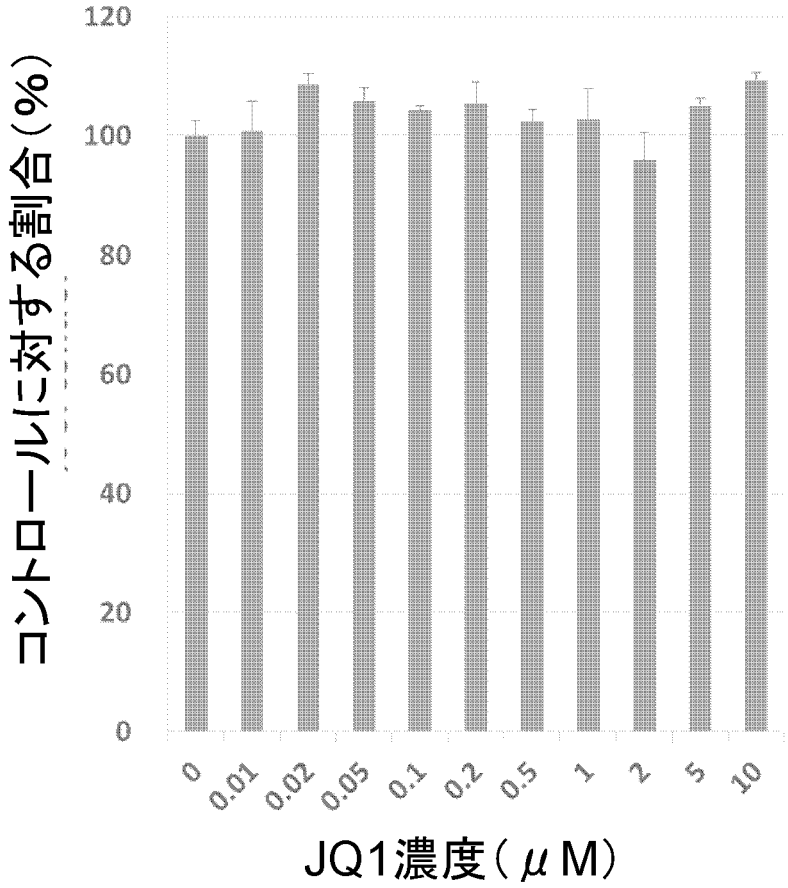
[図10]


120
100
80
60
40
20
0
コントロールに対する割合（%）
0
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
JQ1濃度（μM）

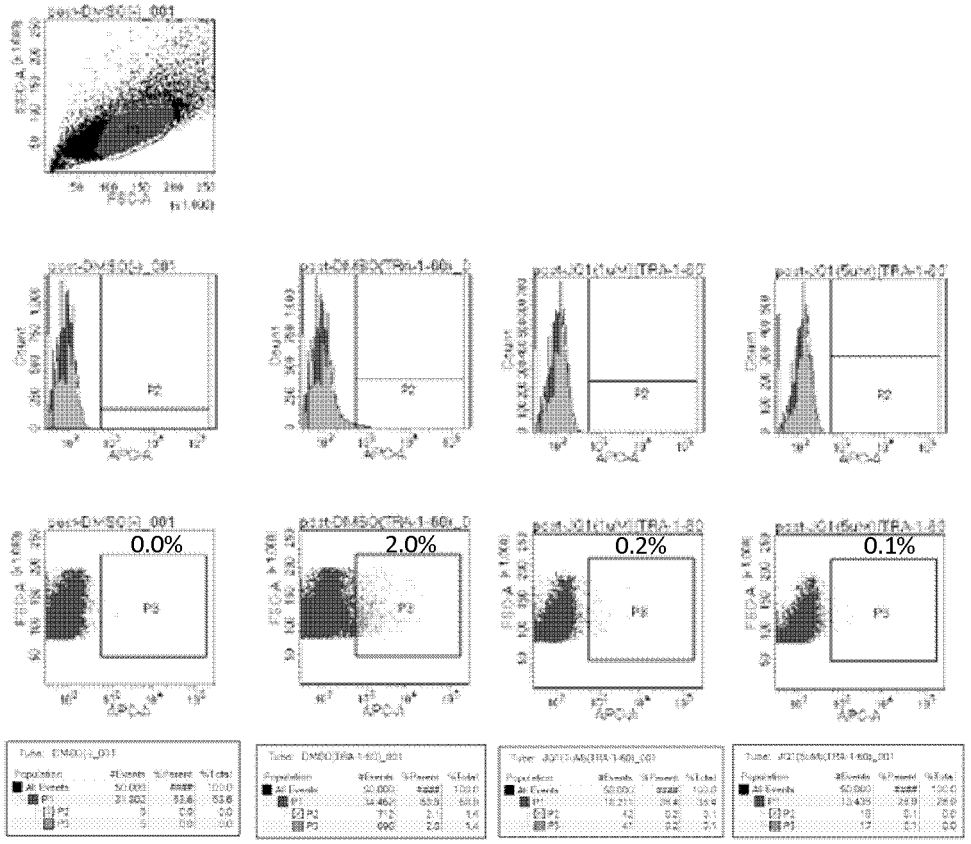
[図11]


120
100
80
60
40
20
0
コントロールに対する割合（%）
0
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
JQ1濃度（μM）

[図12]


コントロールに対する割合（%）
120
100
80
60
40
20
0
0
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
JQ1濃度（μM）

[図13]



<DMSO> <JQ1 (1 μM)> <JQ1 (5 μM)> (96時間後)

Isotype control

TRA-1-60