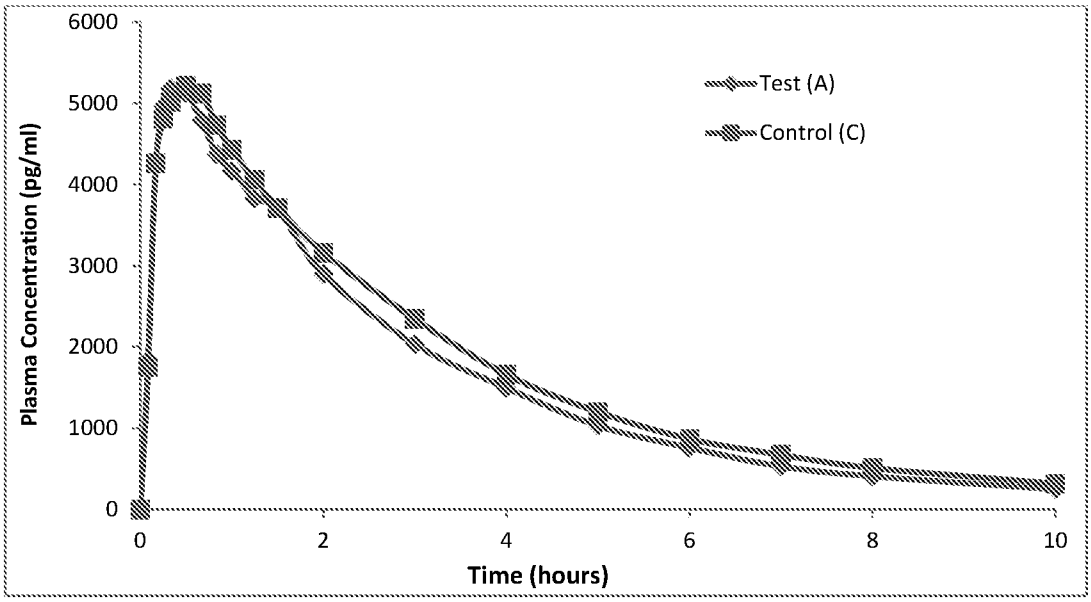

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Plasma Concentration (pg/ml)
0
2
4
6
8
10
Time (hours)
Test (A)
Control (C)

Figure 1

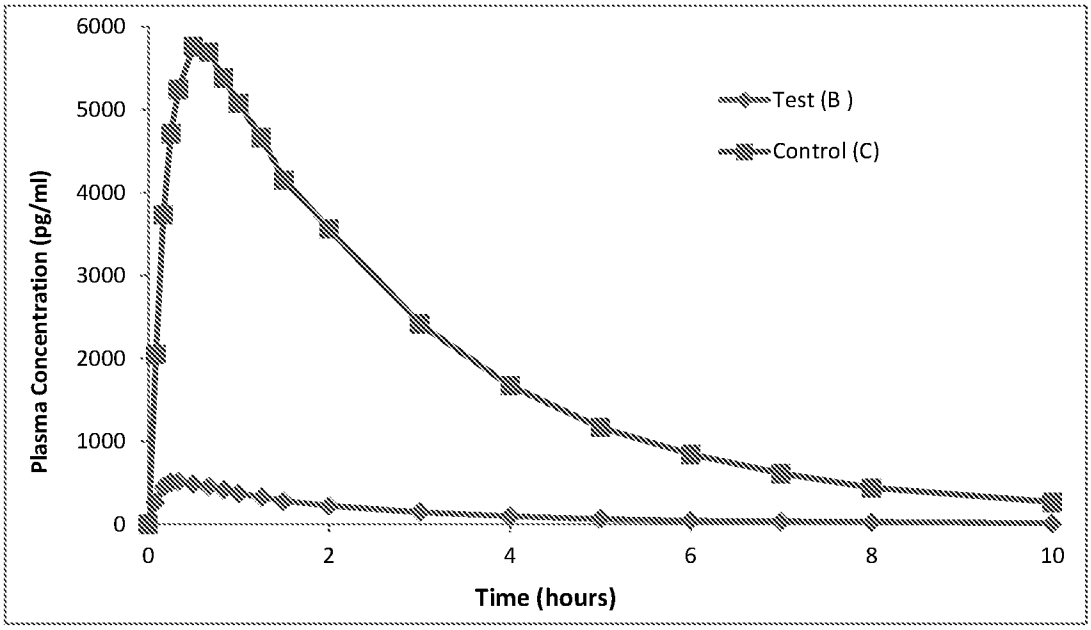

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Plasma Concentration (pg/ml)
0
2
4
6
8
10
Time (hours)
Test (B)
Control (C)

FIGURE 2