




[図1]

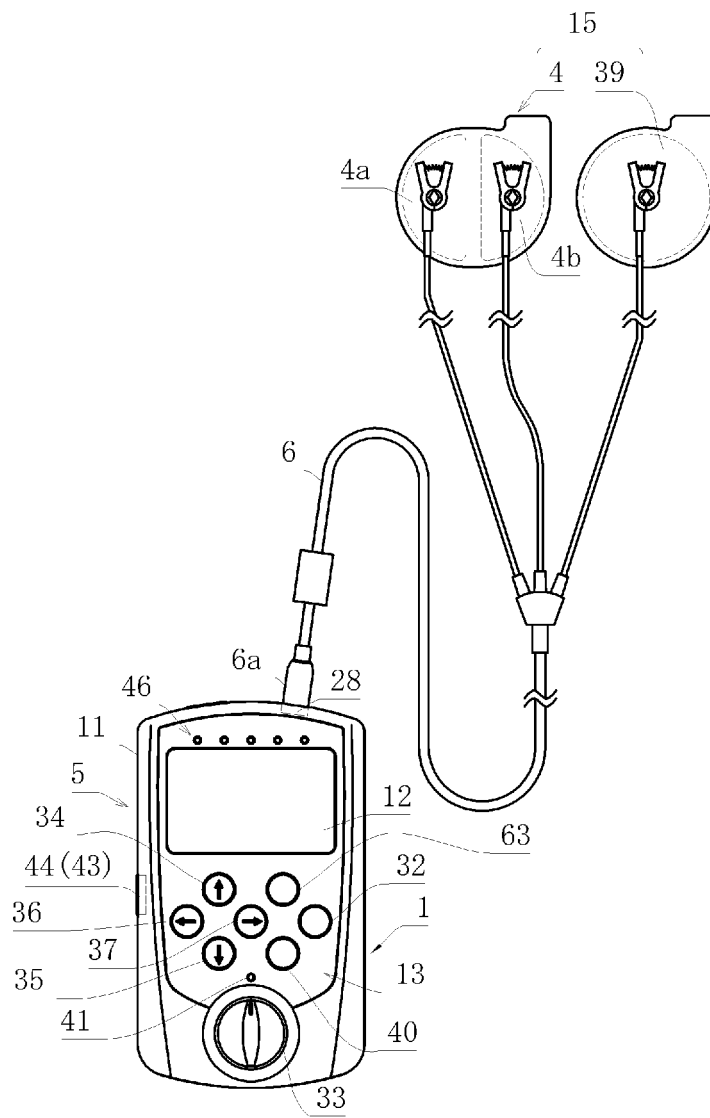


[図2]

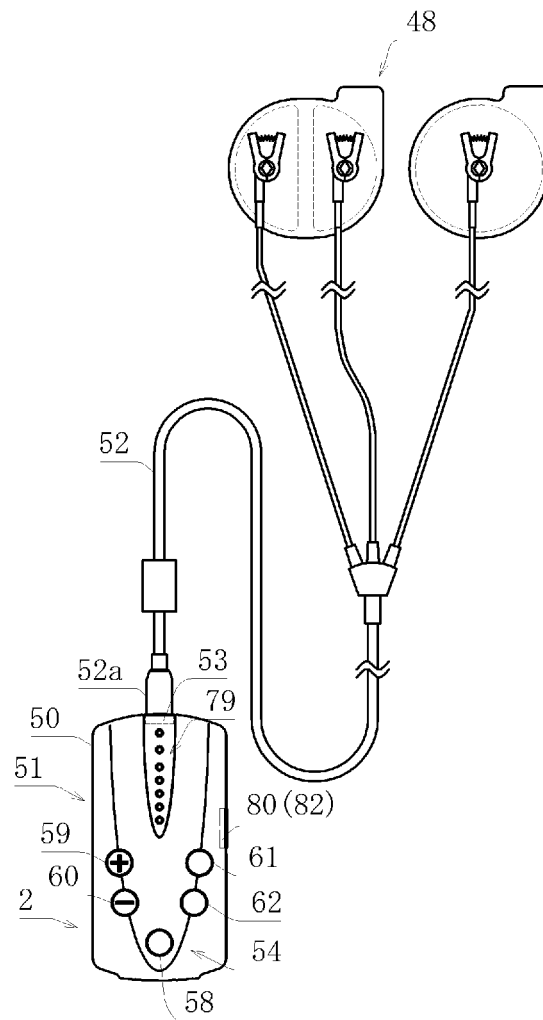


[図3]

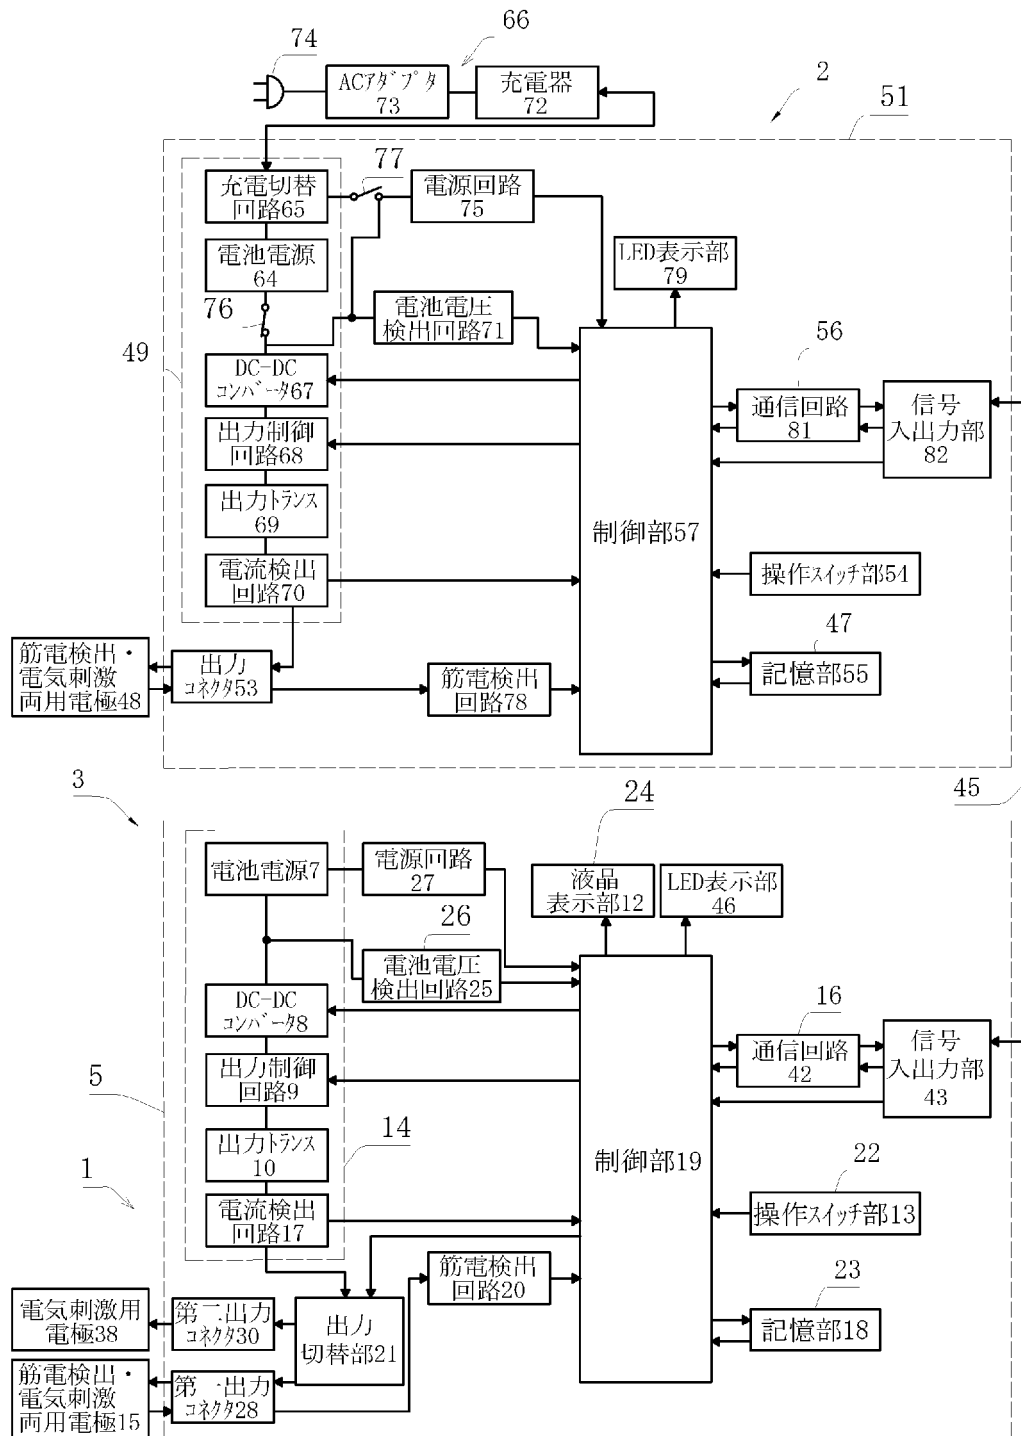


[図4]

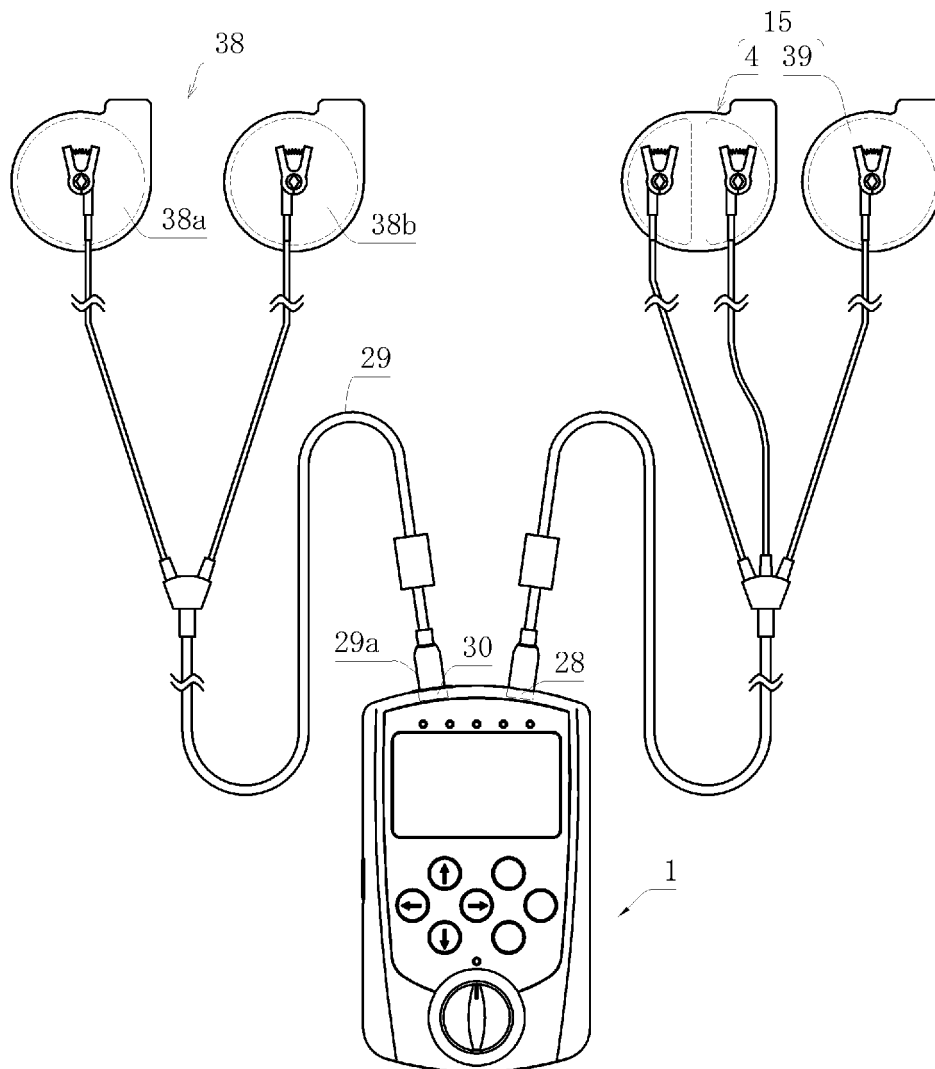

[図5]

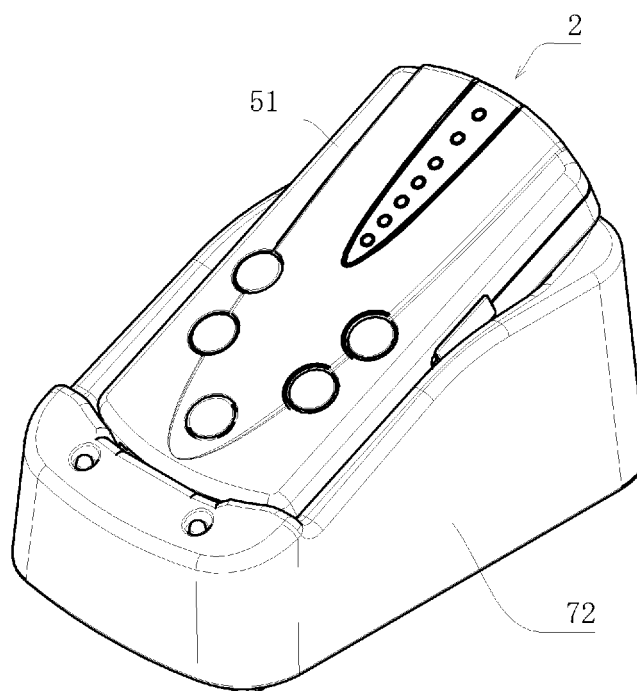

[図6]

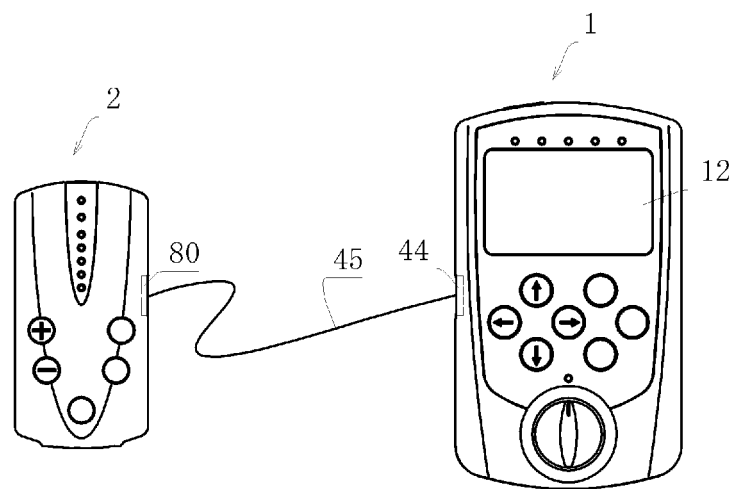

[図7]

12

第一の施療モード

設定値を確認/変更後、治療を開始してください。

最小出力	20%	施療時間	15分
最大出力	60%	筋電検出感度	4.0

[図8]

12

設定値を確認/変更して送信してください。

モード	第一の施療モード		
最小出力	10%	施療時間	20分
最大出力	50%	筋電検出感度	3.5

送信

[図9]

12

施療履歴情報（第一の施療モード）

積算施療時間 020時間40分

レベル3以上の電気刺激印加回数 000300回

レベル3以上の積算印加時間 0003時間00分

履歴消去

[図10]

