Fig. 7

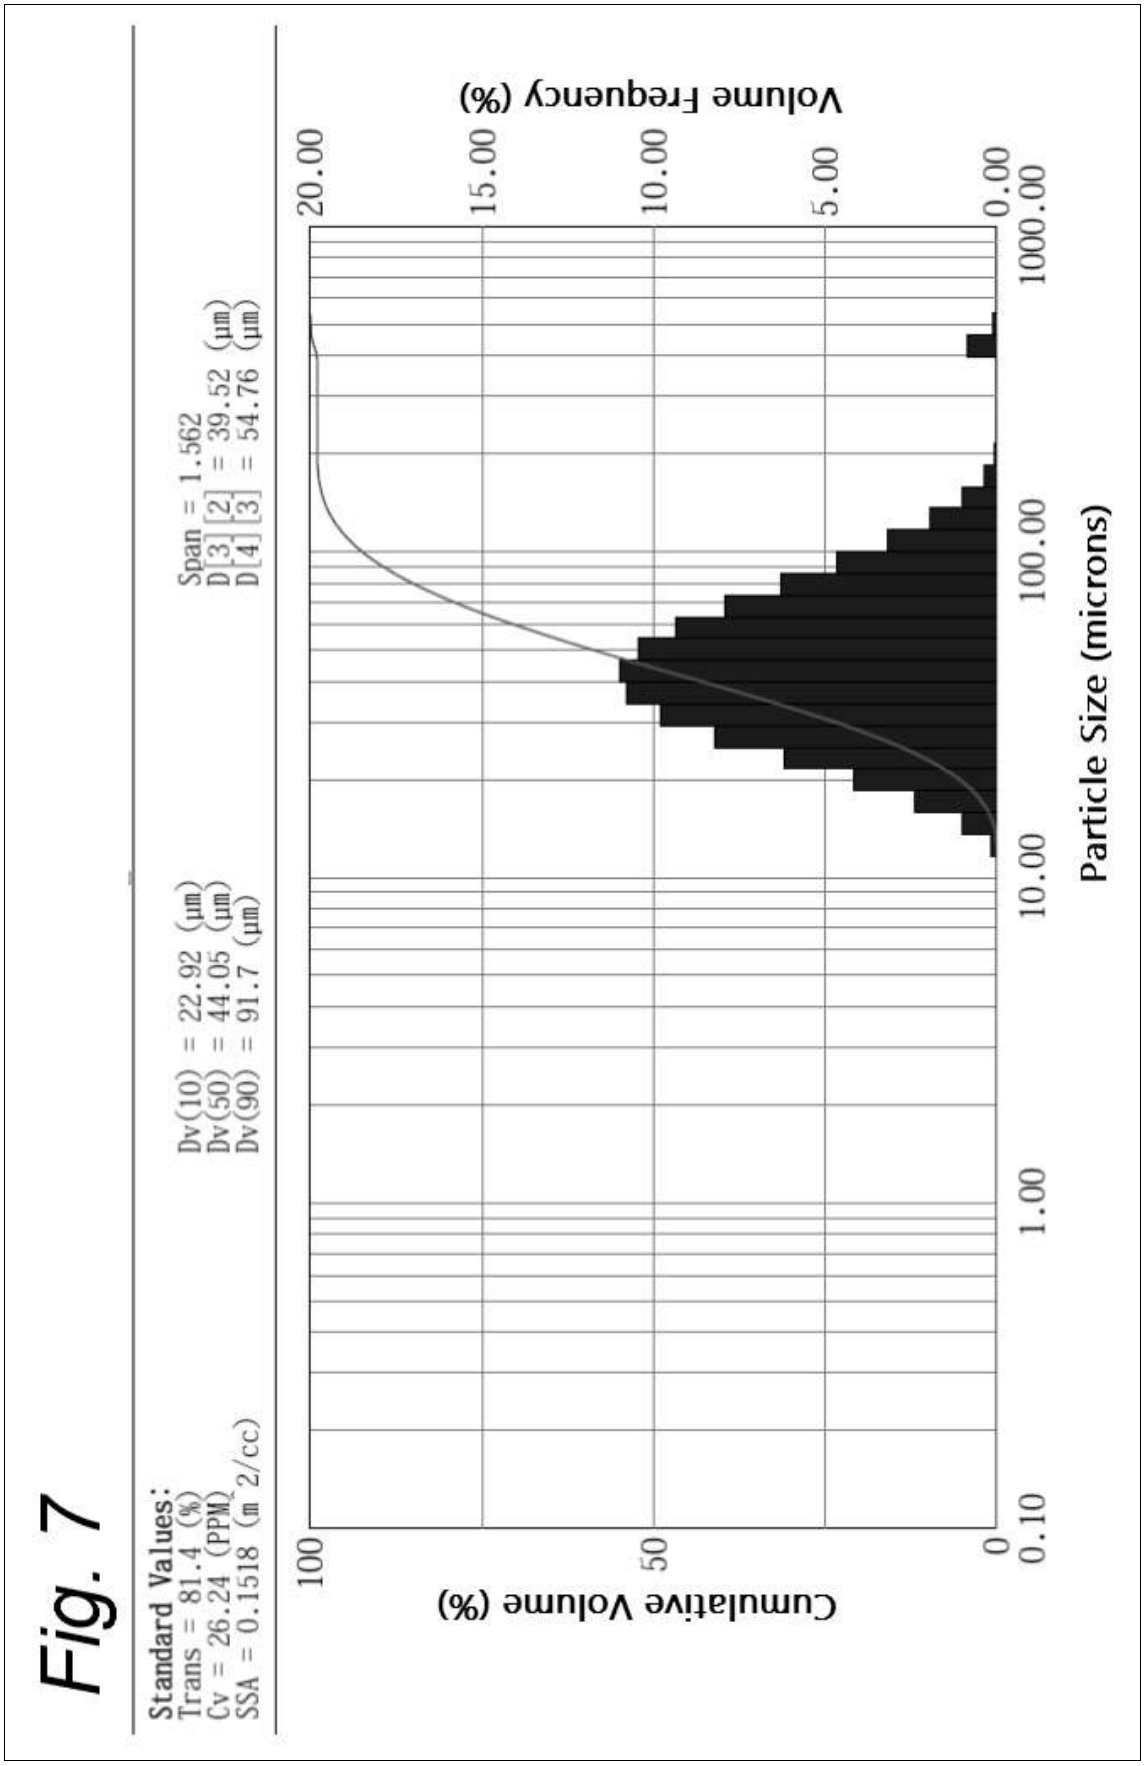
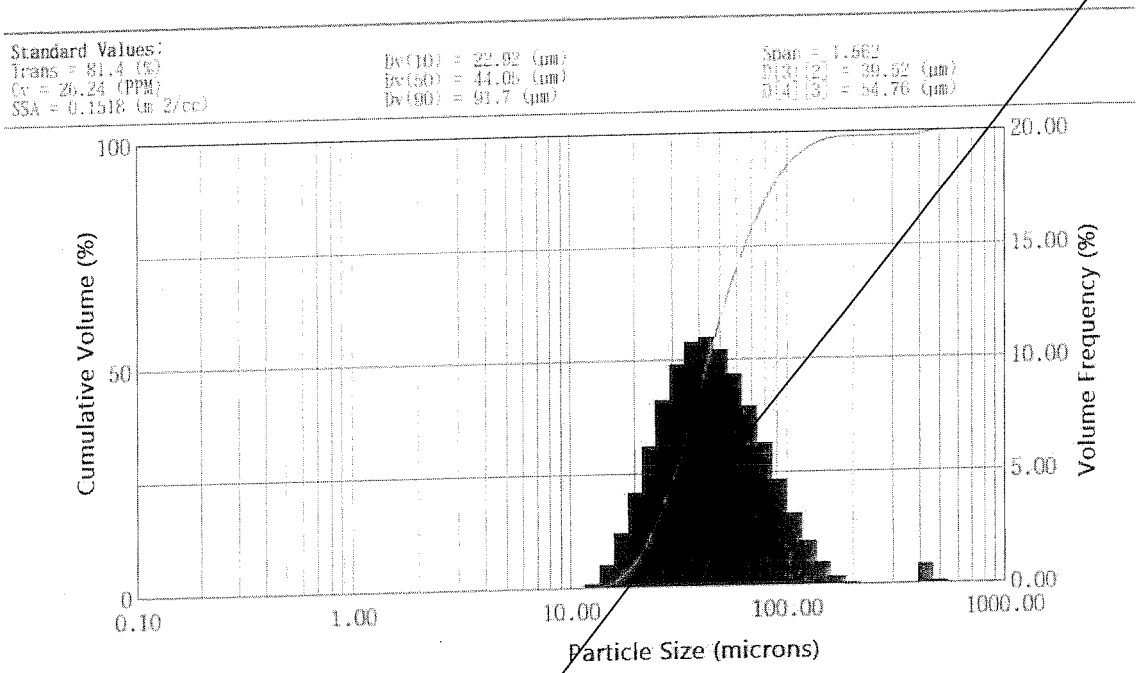

Standard Values:
Trans = 81.4 (%)
Cv = 26.24 (PPM)
SSA = 0.1518 (m 2/cc)
Dv(10) = 22.92 (µm)
Dv(50) = 44.05 (µm)
Dv(90) = 91.7 (µm)
Span = 1.562
D[3][2] = 39.52 (µm)
D[4][3] = 54.76 (µm)
Cumulative Volume (%)
100
50
0
Volume Frequency (%)
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00
Particle Size (microns)

Fig. 7


Standard Values:
Trans = 81.4 (%)
Cv = 26.24 (PPM)
SSA = 0.1518 (m 2/cc)
Dv(10) = 22.92 (µm)
Dv(50) = 44.05 (µm)
Dv(90) = 91.7 (µm)
Span = 1.562
D[3][2] = 39.52 (µm)
D[4][3] = 54.76 (µm)
Cumulative Volume (%)
Volume Frequency (%)
Particle Size (microns)
100
50
0
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00