[図1]

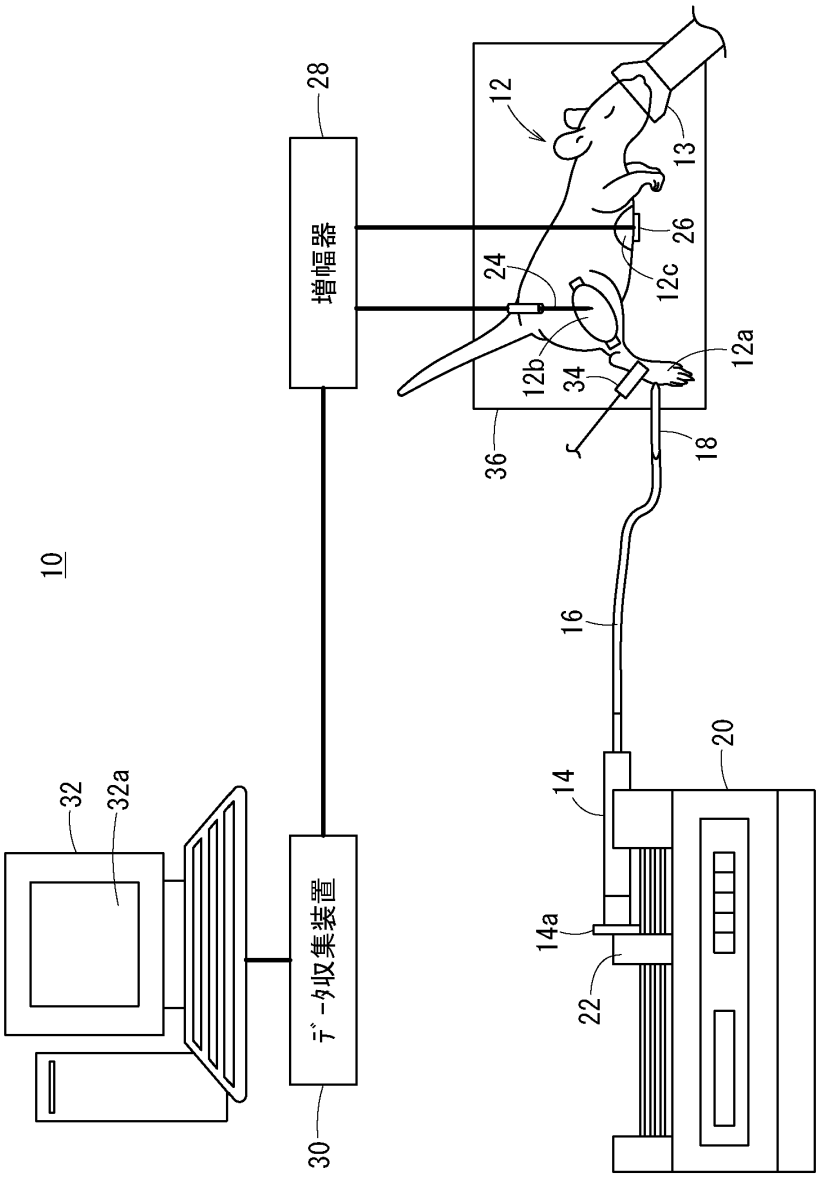

10
28
増幅器
12
13
26
24
12c
12b
34
12a
36
18
16
20
14
14a
22
32
32a
データ収集装置
30

FIG. 1

[図2]

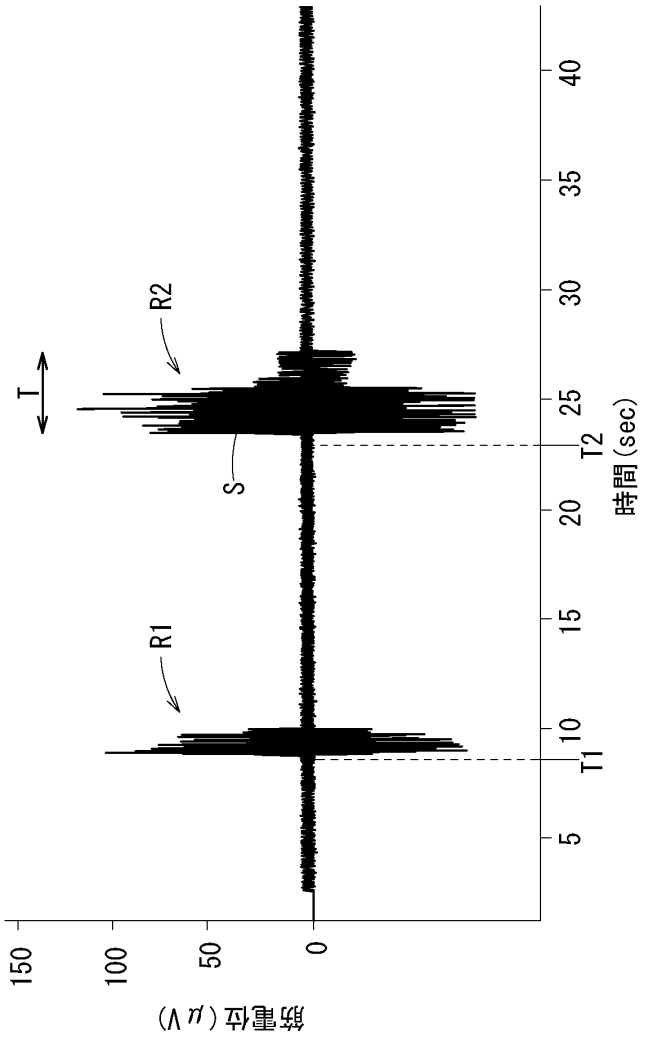


FIG. 2

[図3]

FIG. 3A



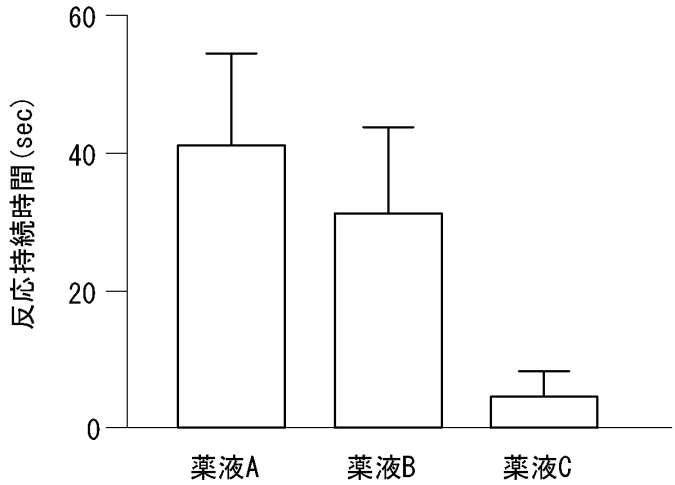


FIG. 3B

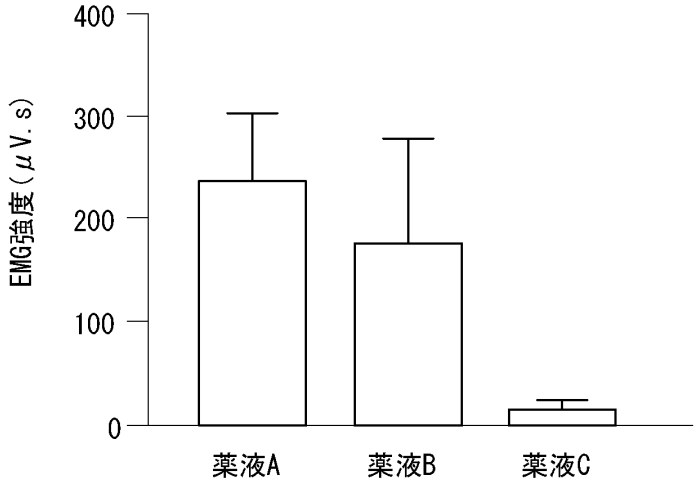


[図4]

FIG. 4A

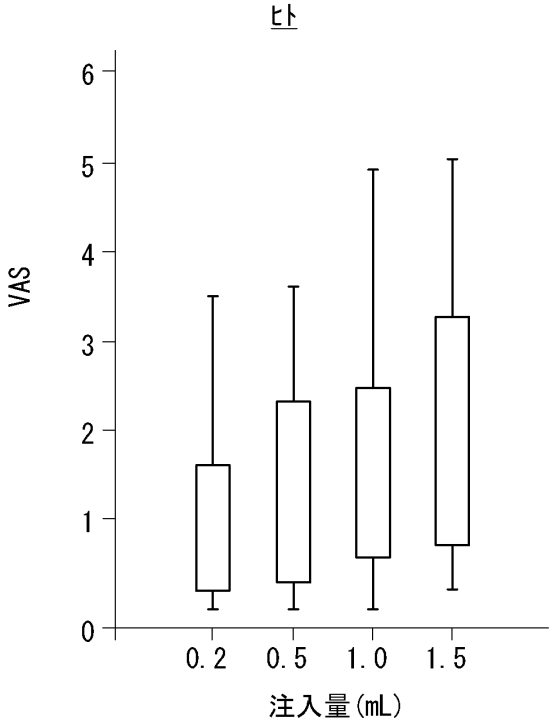


Jφrgensen JT et al;Ann Pharmacother 30:729-732,1996

FIG. 4B

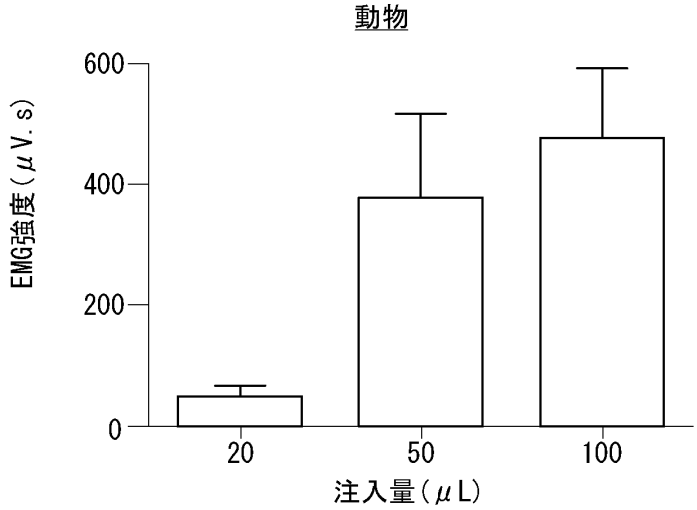


[図5]

FIG. 5A

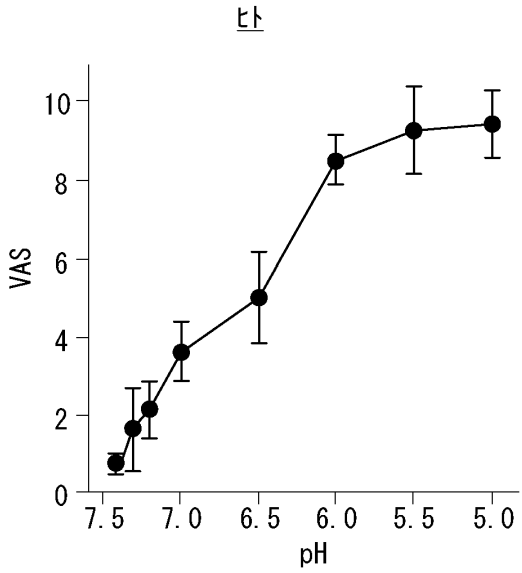


Ugawa, S et al; J Clin Invest 110:1185-1190, 2002

FIG. 5B

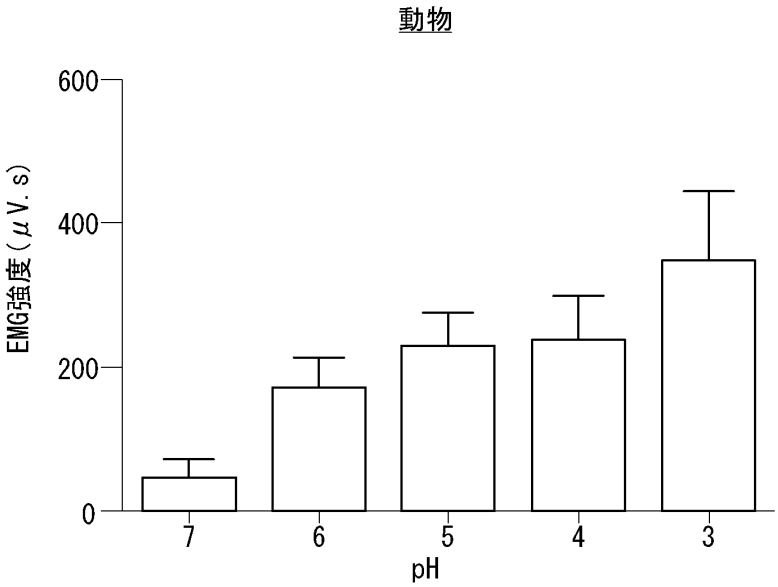


[図6]

FIG. 6A

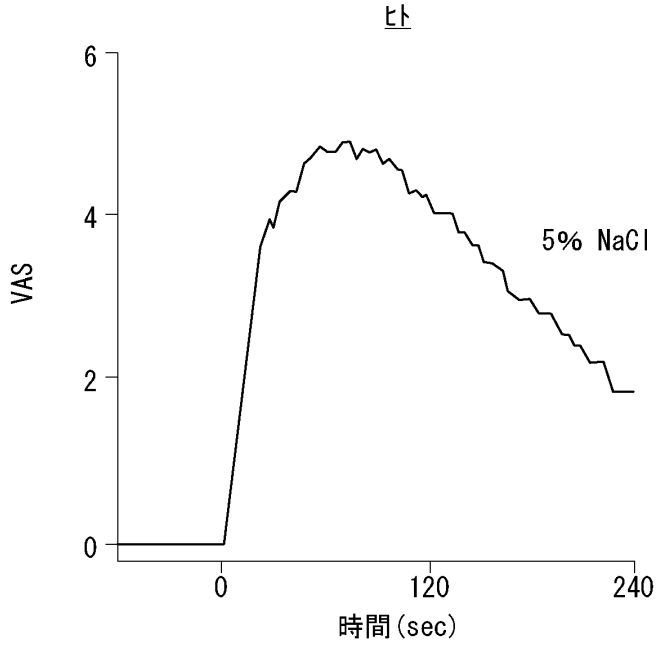


Henderson LA et al;Pain 120:286-296,2006

FIG. 6B

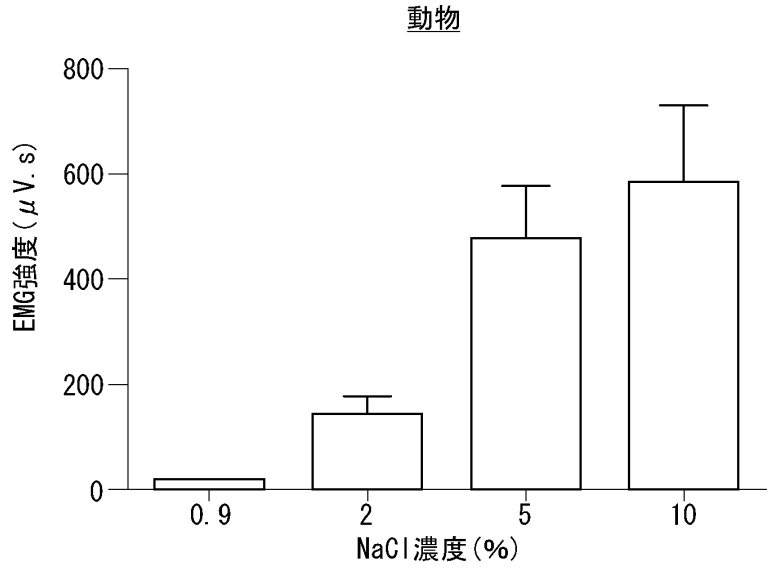


[図7]

FIG. 7A

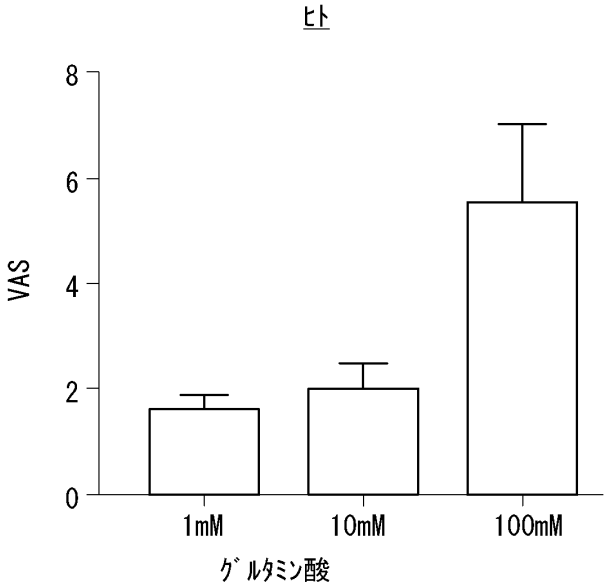

Gazerani P et al;Pain 124:338-348,2006

FIG. 7B

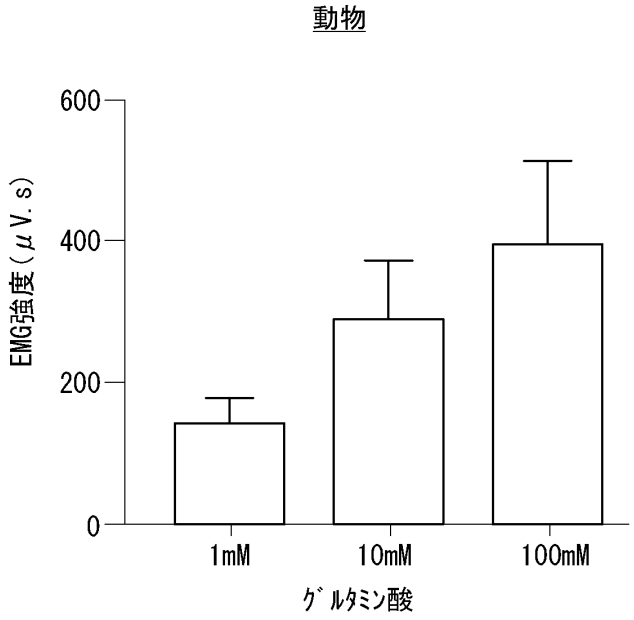

[図8]

FIG. 8A


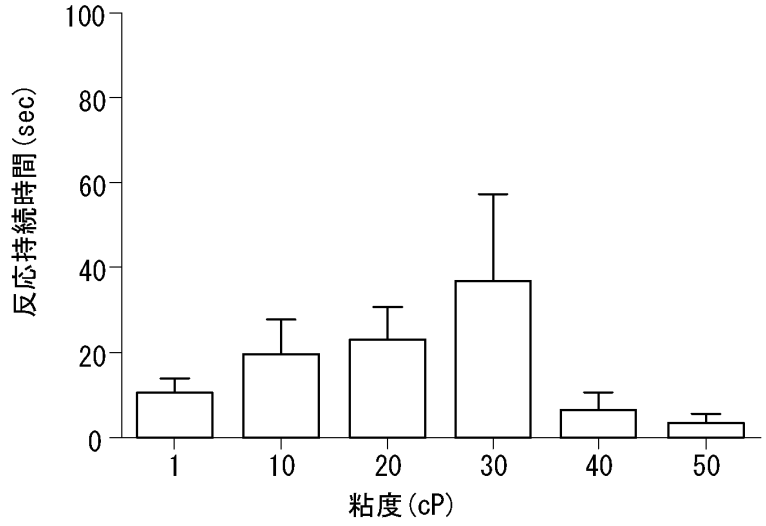


FIG. 8B

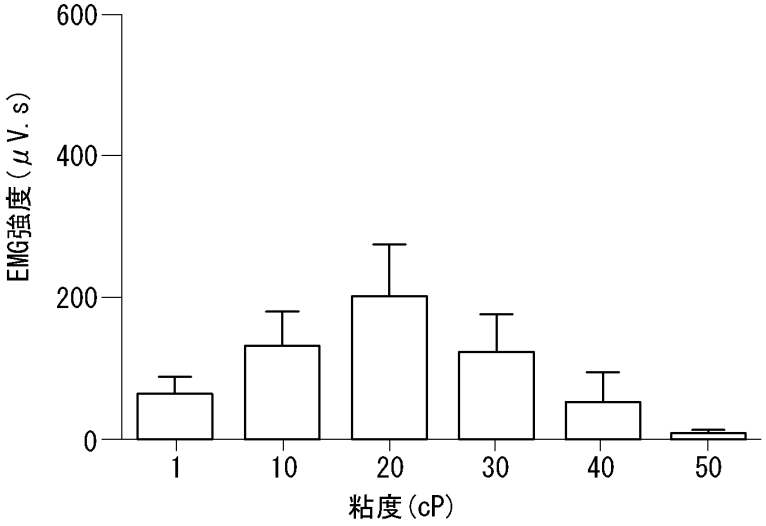

[図9]

FIG. 9A



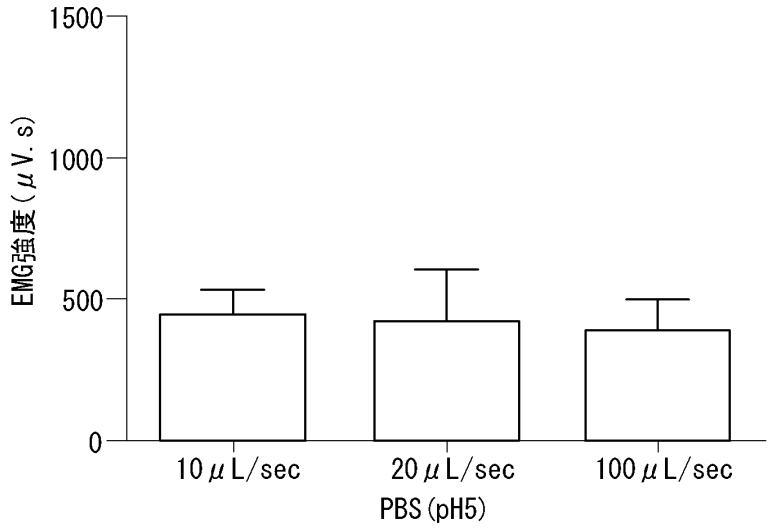


FIG. 9B

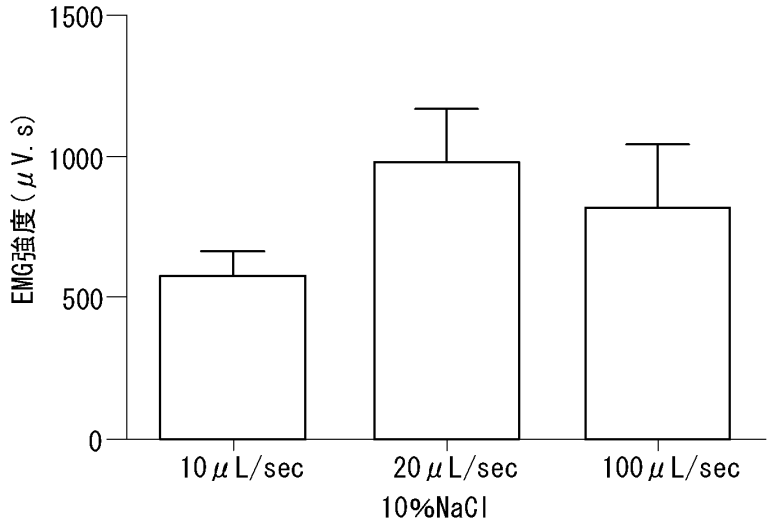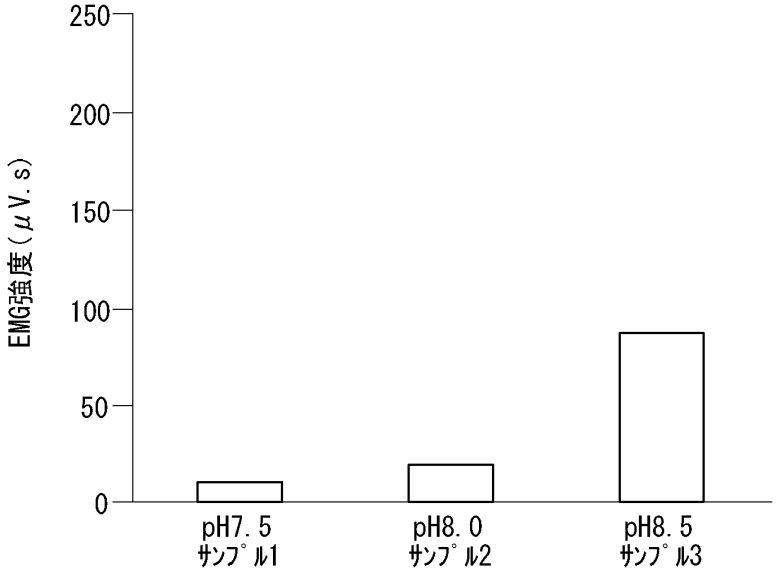

[図10]

FIG. 10


250
200
150
100
50
0
EMG強度（μV.s）
pH7.5
ｻﾝﾌﾟﾙ1
pH8.0
ｻﾝﾌﾟﾙ2
pH8.5
ｻﾝﾌﾟﾙ3