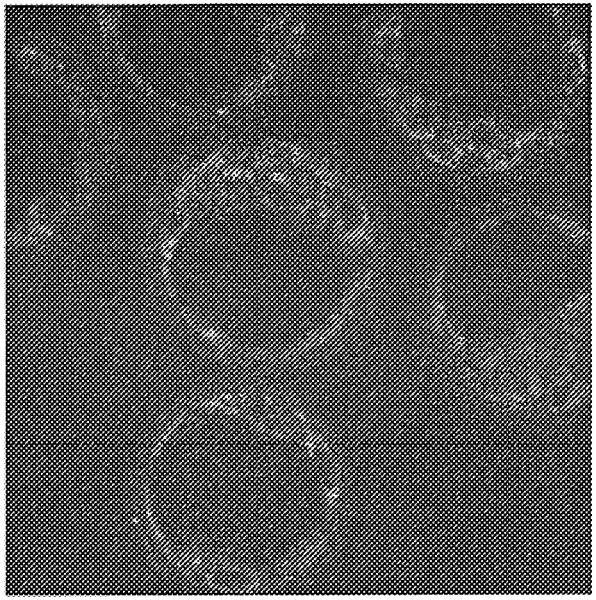
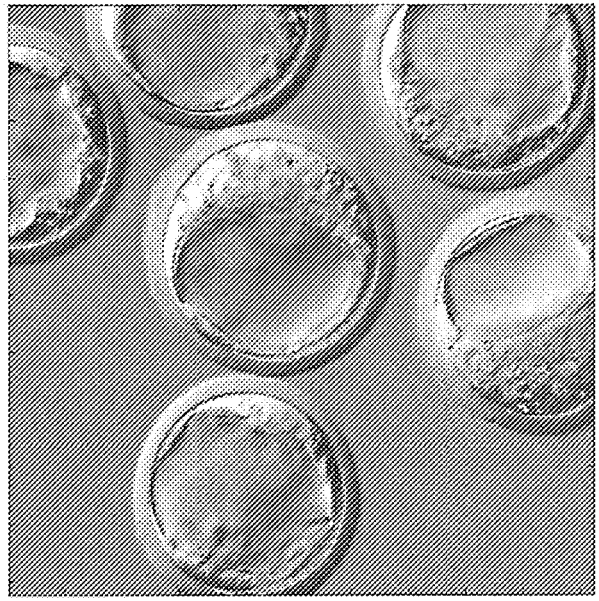


FIG. 1



Panel A



Panel B

FIG. 2

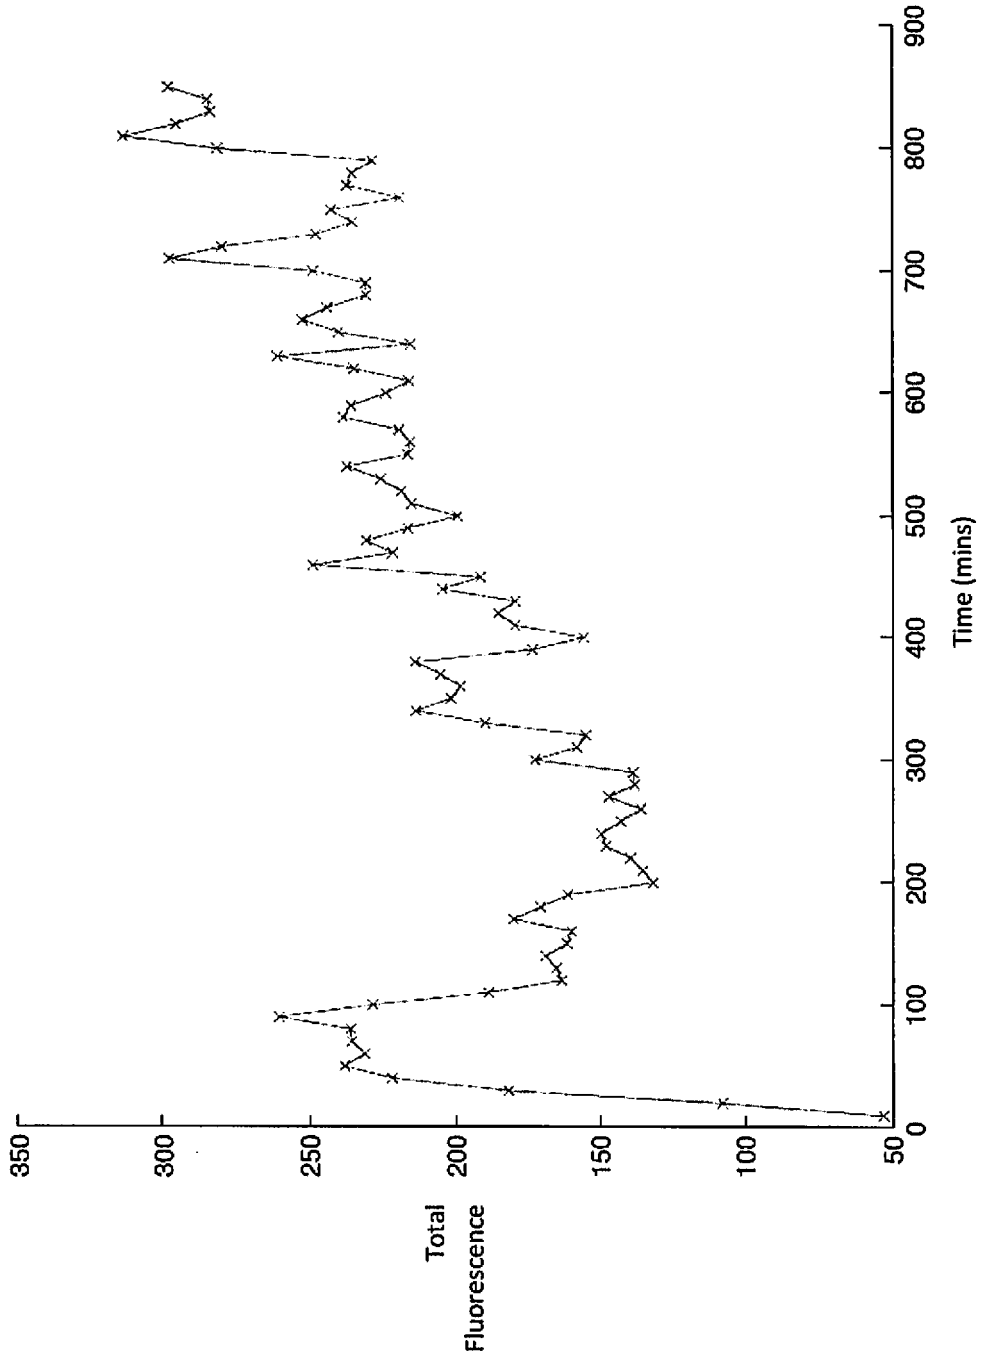

Total Fluorescence
Time (mins)
350
300
250
200
150
100
50
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

FIG. 3