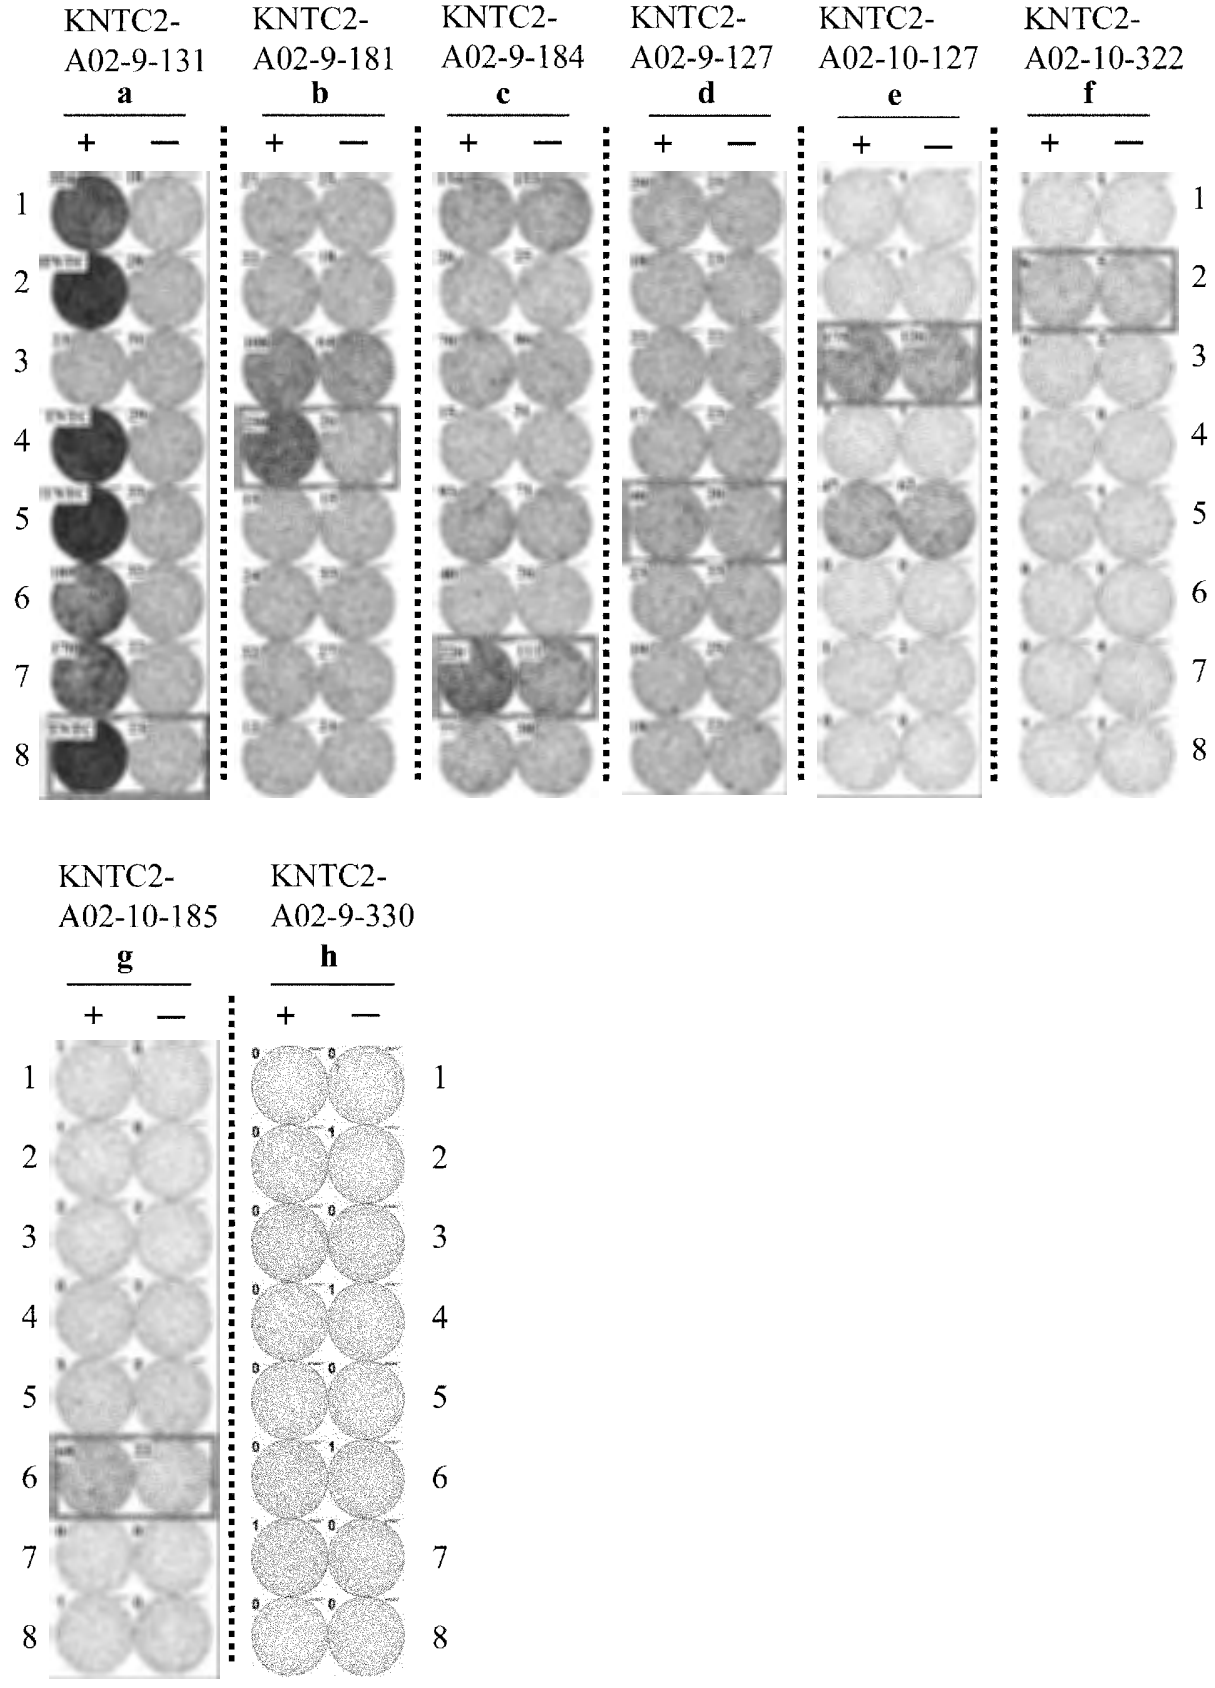
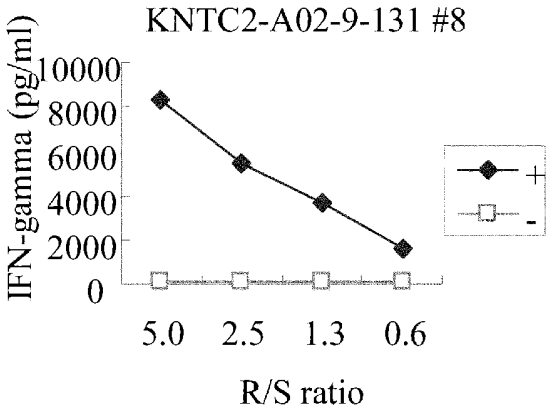
[Fig. 1]

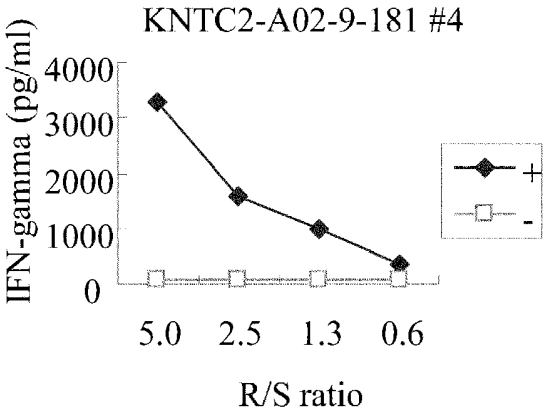

KNTC2-A02-9-131
a
KNTC2-A02-9-181
b
KNTC2-A02-9-184
c
KNTC2-A02-9-127
d
KNTC2-A02-10-127
e
KNTC2-A02-10-322
f
KNTC2-A02-10-185
g
KNTC2-A02-9-330
h
+
—
1
2
3
4
5
6
7
8

[Fig. 2]

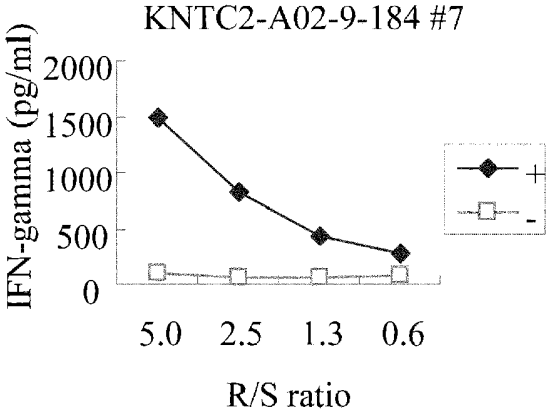
a


KNTC2-A02-9-131 #8
IFN-gamma (pg/ml)
10000
8000
6000
4000
2000
0
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
-

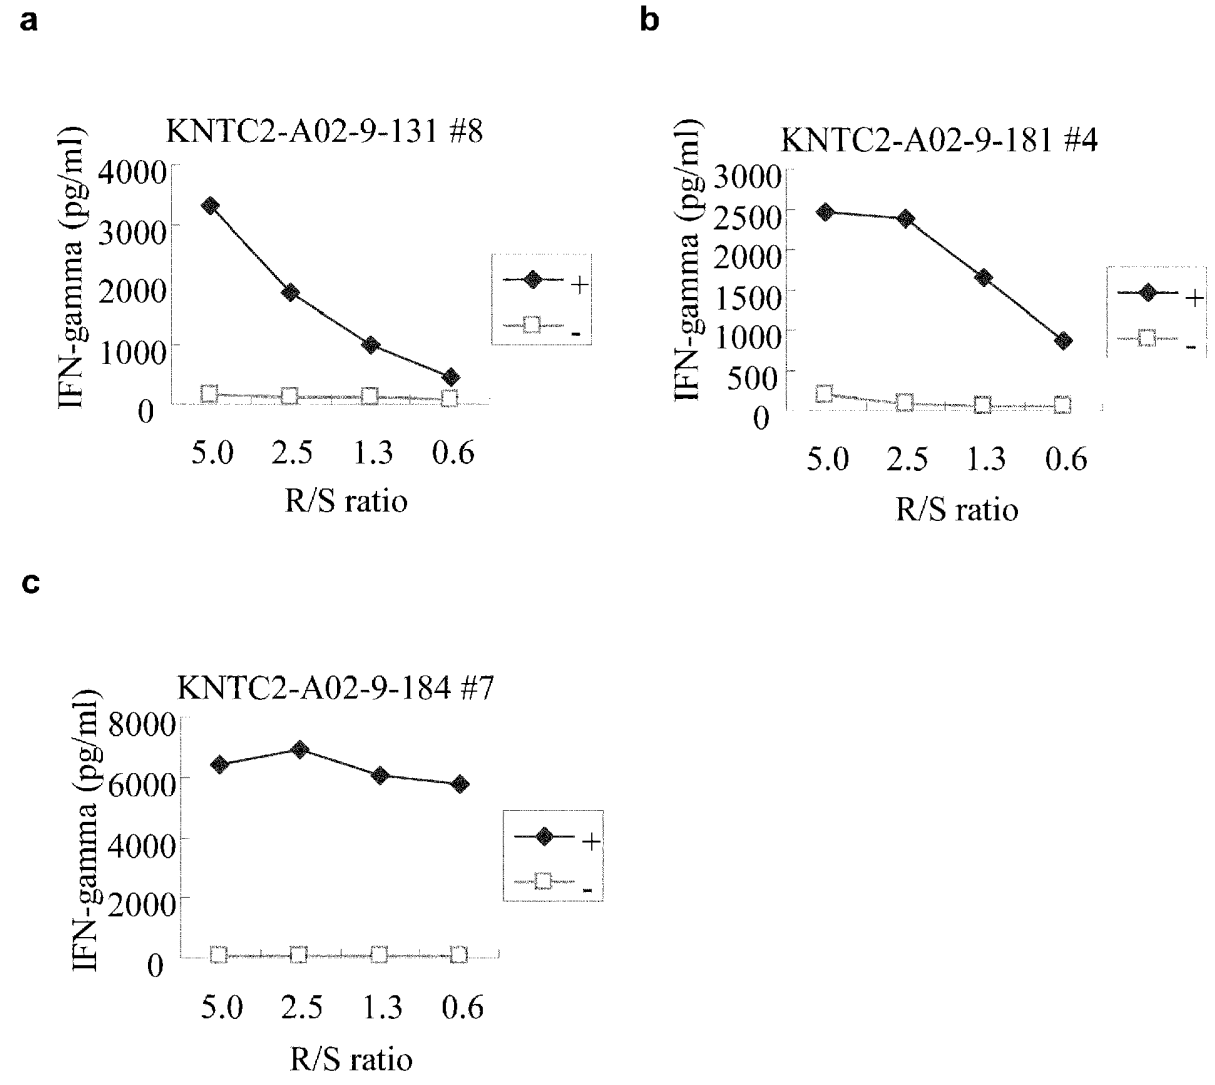
b


KNTC2-A02-9-181 #4
IFN-gamma (pg/ml)
4000
3000
2000
1000
0
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
-

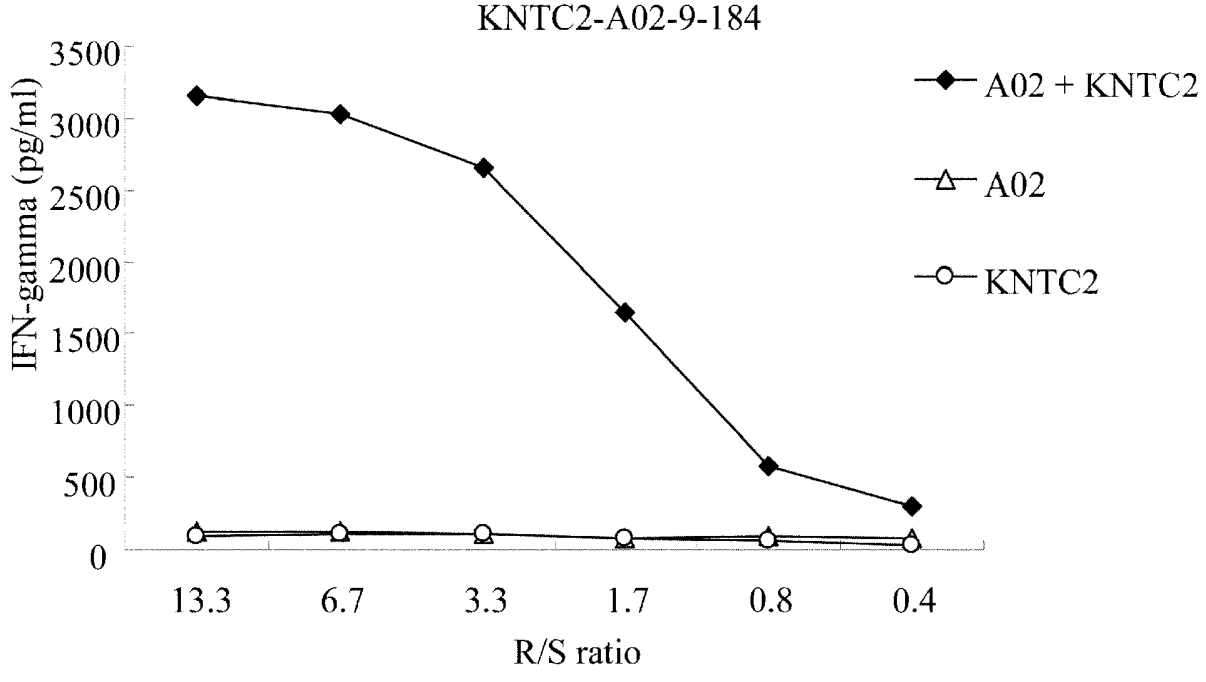
c


KNTC2-A02-9-184 #7
IFN-gamma (pg/ml)
2000
1500
1000
500
0
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
-

[Fig. 3]


a
KNTC2-A02-9-131 #8
IFN-gamma (pg/ml)
4000
3000
2000
1000
0
5.0 2.5 1.3 0.6
R/S ratio
+
-
b
KNTC2-A02-9-181 #4
IFN-gamma (pg/ml)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
5.0 2.5 1.3 0.6
R/S ratio
+
-
c
KNTC2-A02-9-184 #7
IFN-gamma (pg/ml)
8000
6000
4000
2000
0
5.0 2.5 1.3 0.6
R/S ratio
+
-

[Fig. 4]


KNTC2-A02-9-184
IFN-gamma (pg/ml)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
13.3 6.7 3.3 1.7 0.8 0.4
R/S ratio
A02 + KNTC2
A02
KNTC2