


[図1]

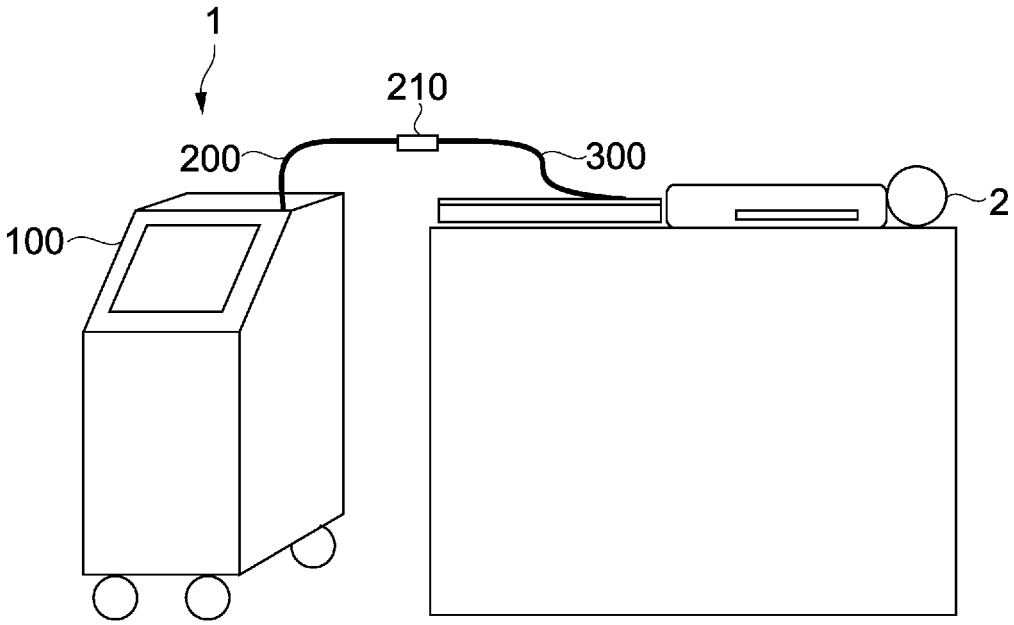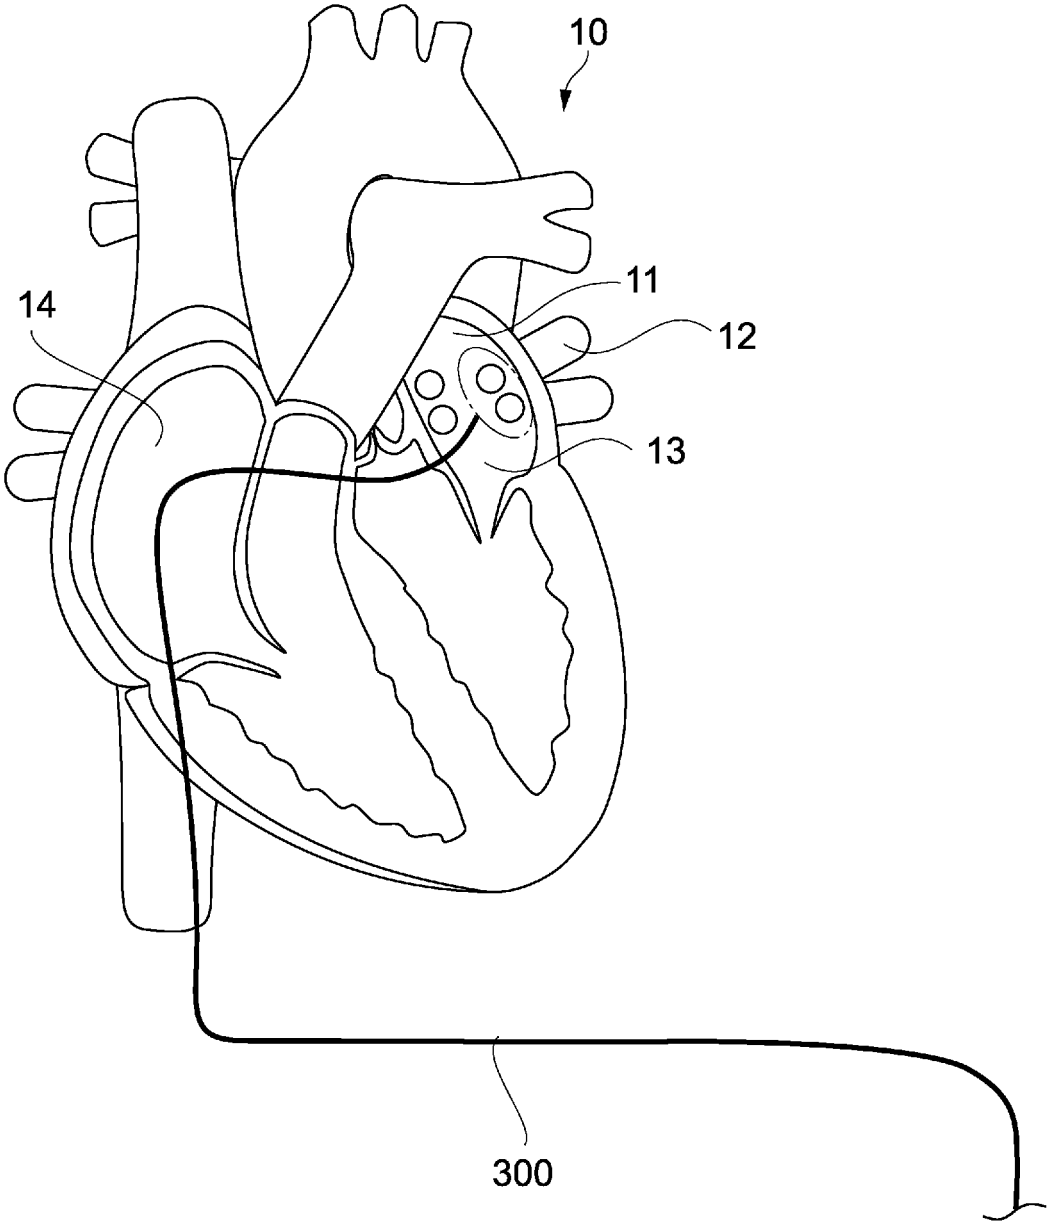


[図2]

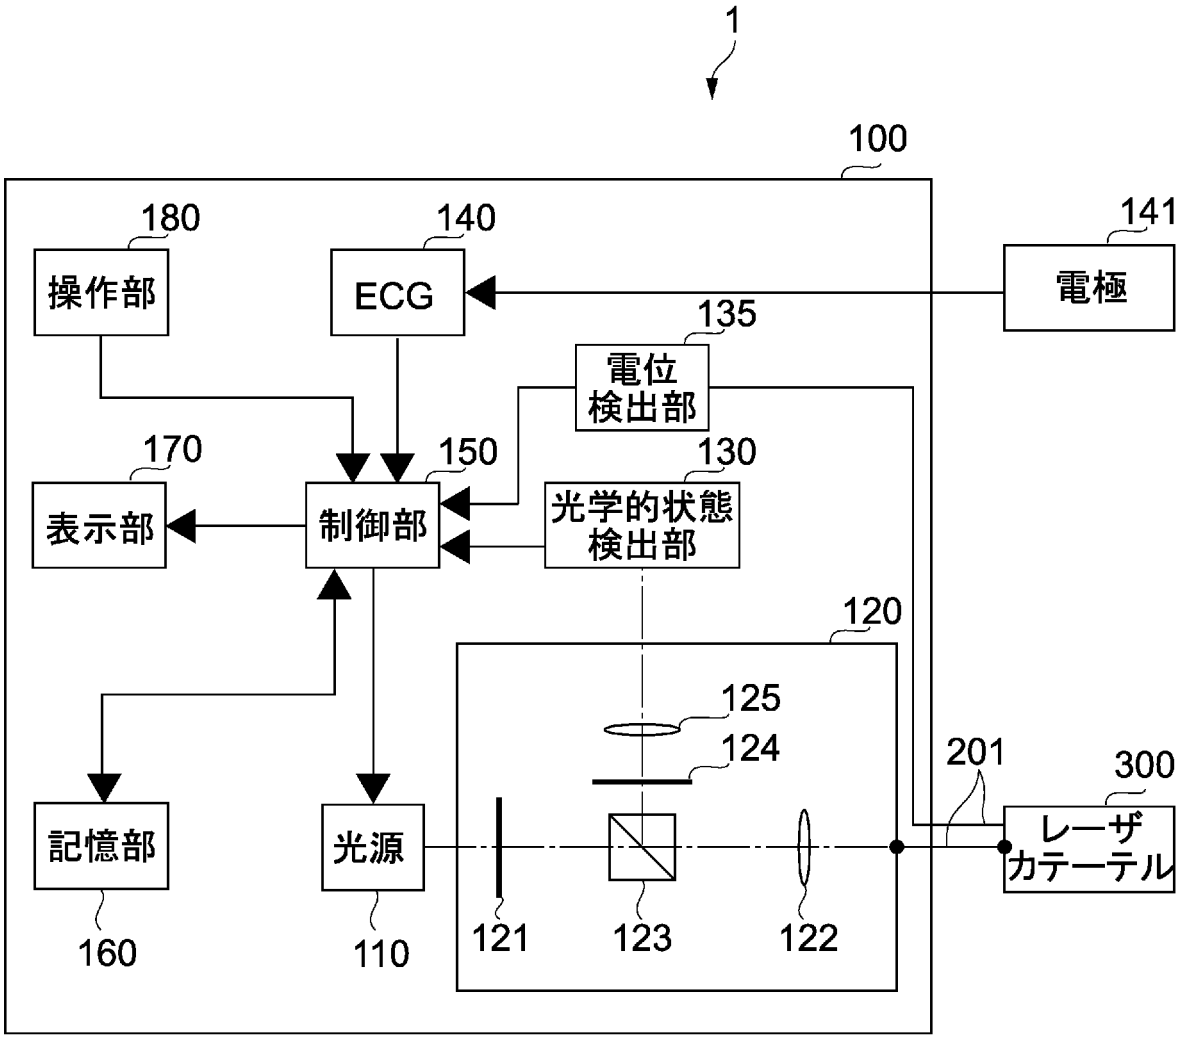


[図3]


1
100
180
操作部
140
ECG
141
電極
135
電位
検出部
170
表示部
150
制御部
130
光学的状態
検出部
120
125
124
201
300
レーザ
カテーテル
記憶部
160
光源
110
121
123
122


[図4]

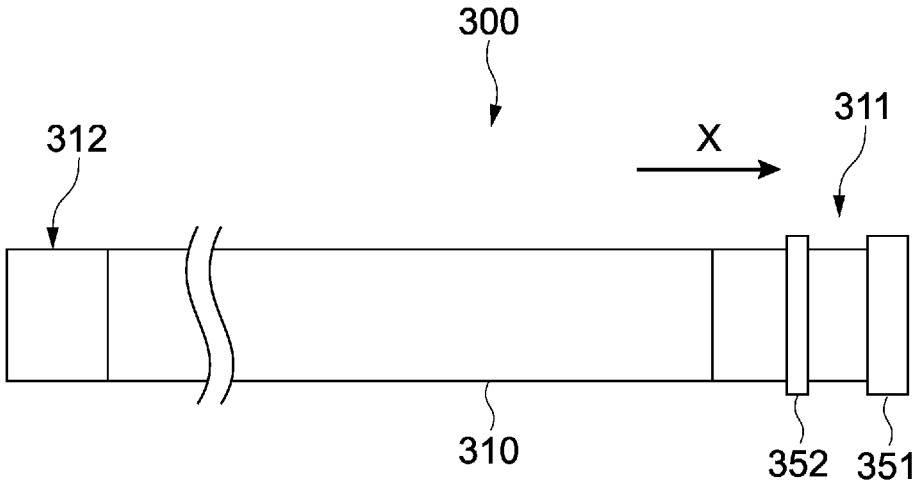
300
312
X
311
310
352
351


[図5]

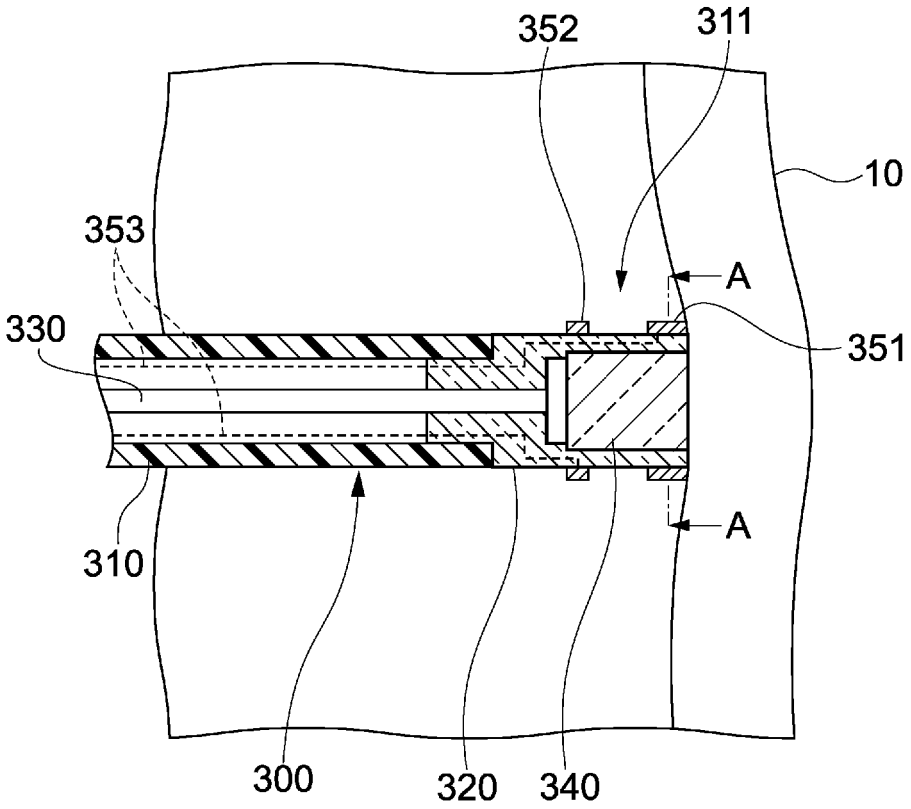


[図6]

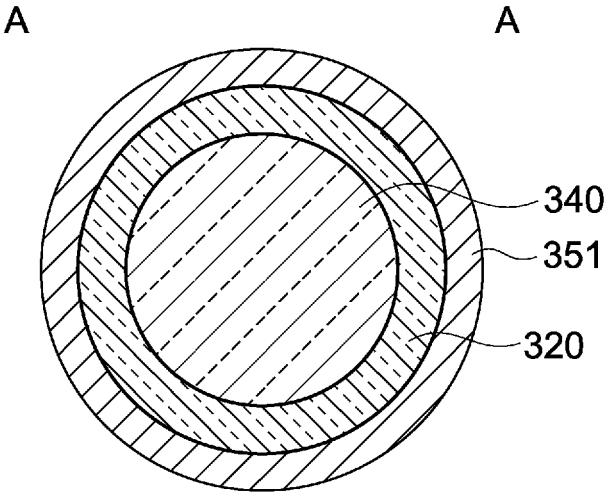

[図7]

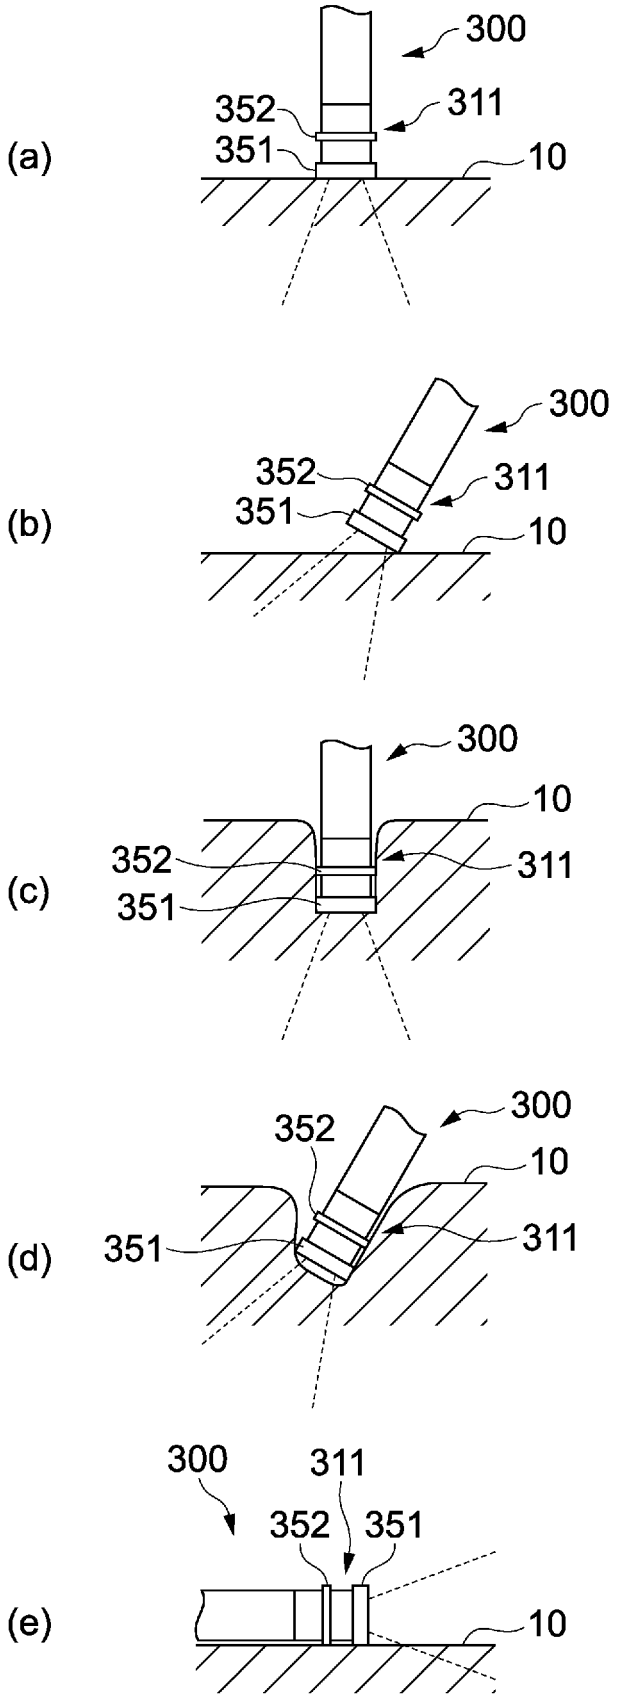
(a)
300
352
311
351
10
(b)
300
352
311
351
10
(c)
300
10
352
311
351
(d)
352
300
10
351
311
(e)
300
311
352
351
10

[図8]

| | 蛍光強度 | 2番目の電極電位 |
|---|---|---|
| (a)正常 | Low | Low |
| (b)正常（但し斜め） | Middle | Low |
| (c)埋没 | Low | High |
| (d)埋没（但し斜め） | Low | Middle～High |
| (e)組織にエネルギーが到達しない | High | High～Low |