

WO 2025/177721 PCT/JP2025/000586


[図1]

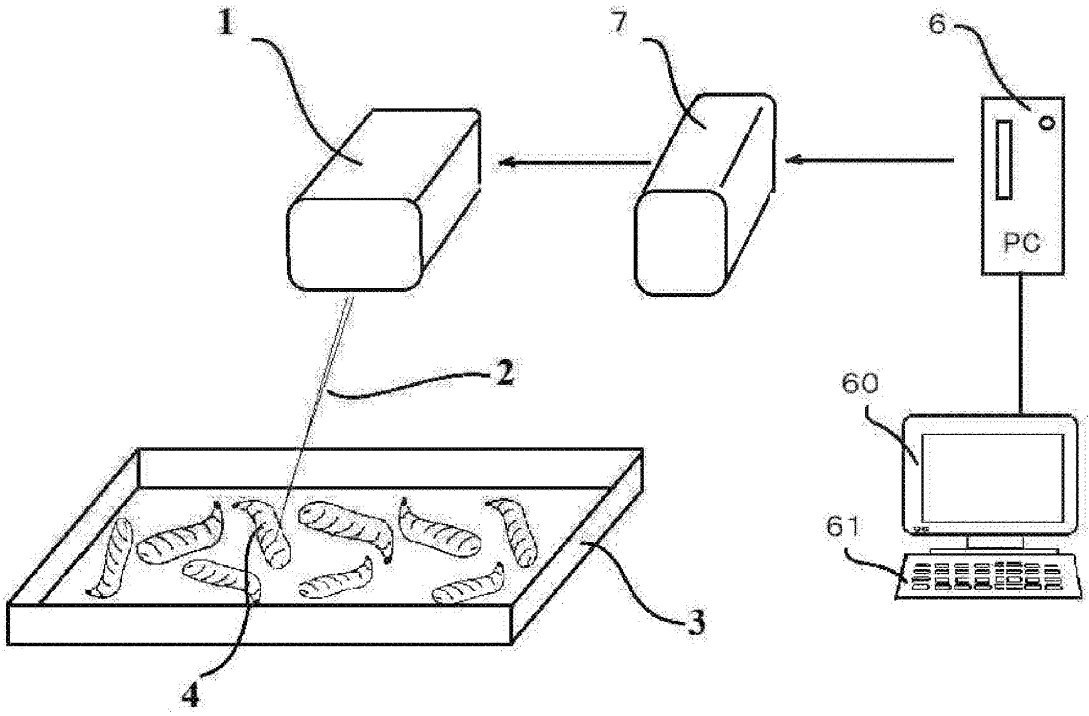


[図2]

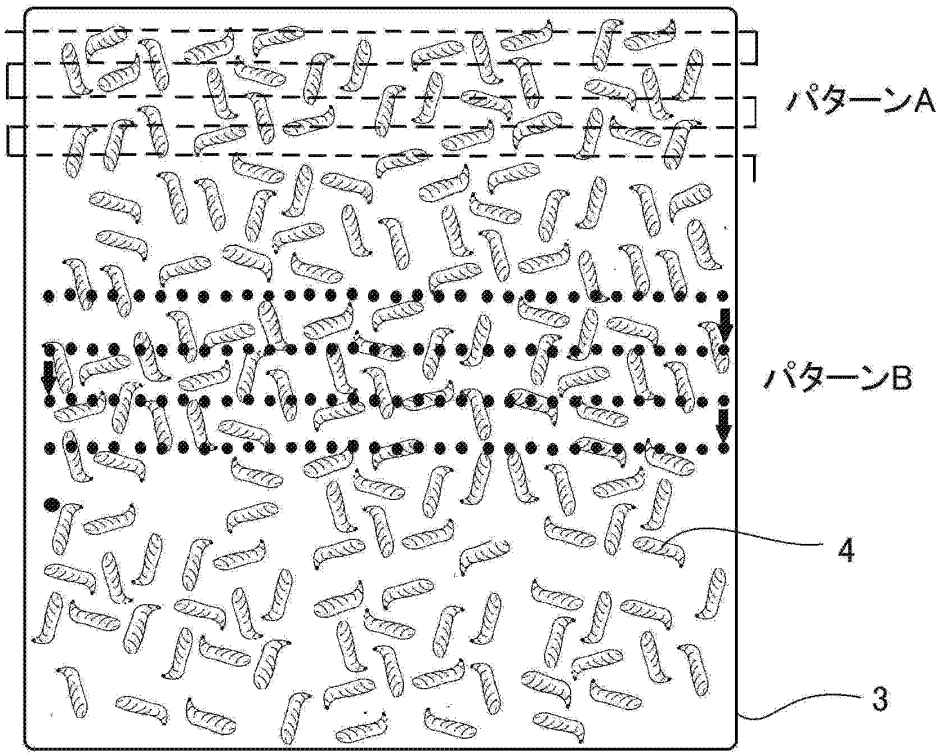


[図3]

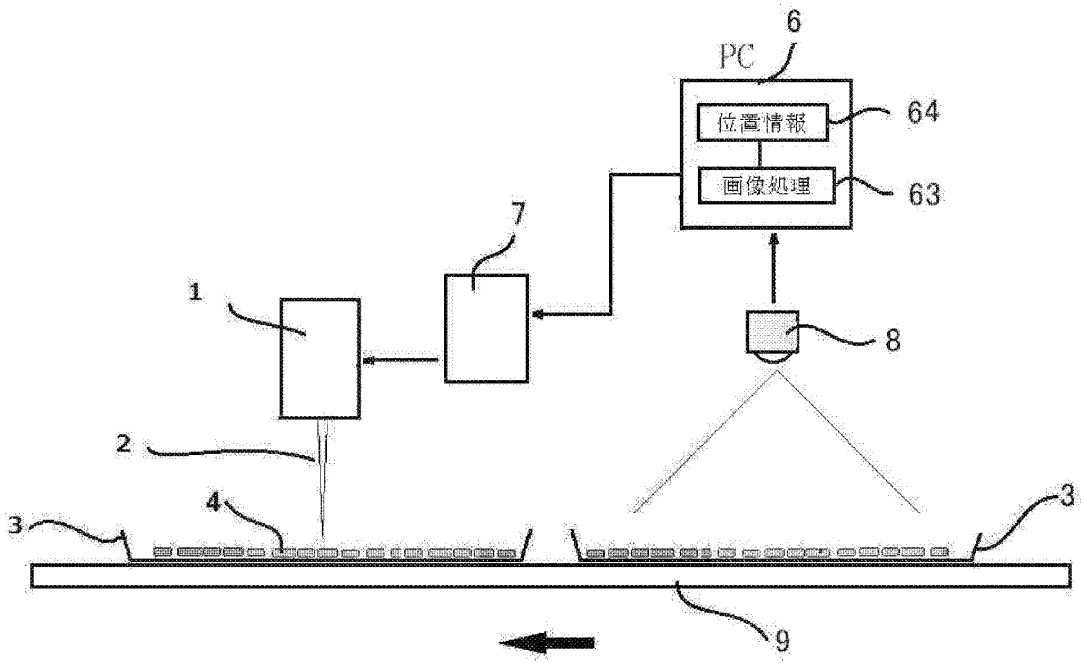


[図4]

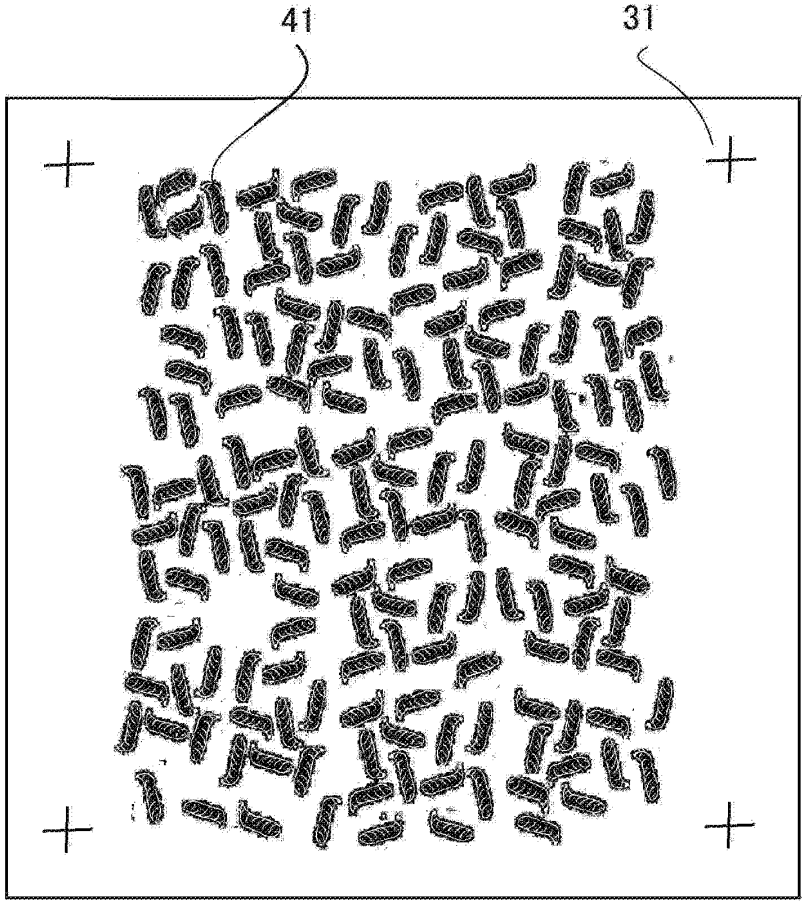


[図5]

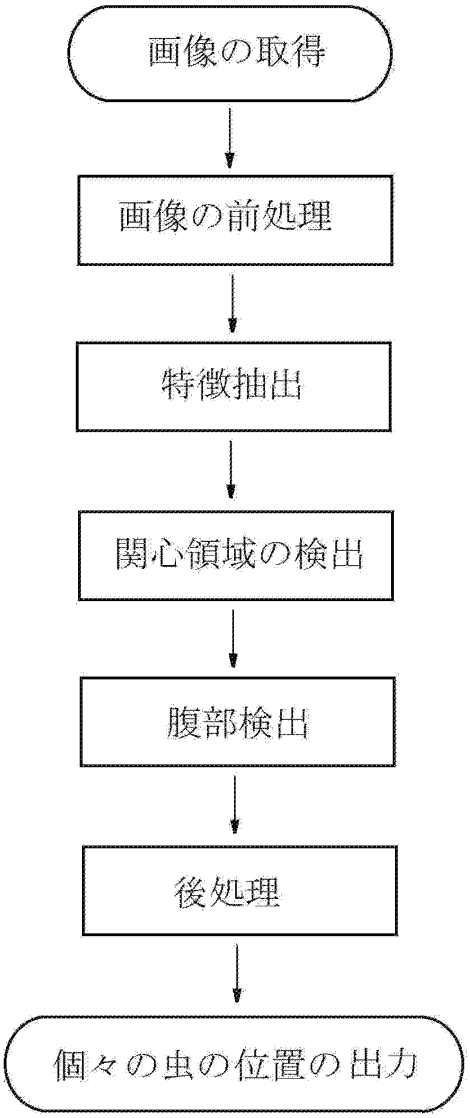


[図6]

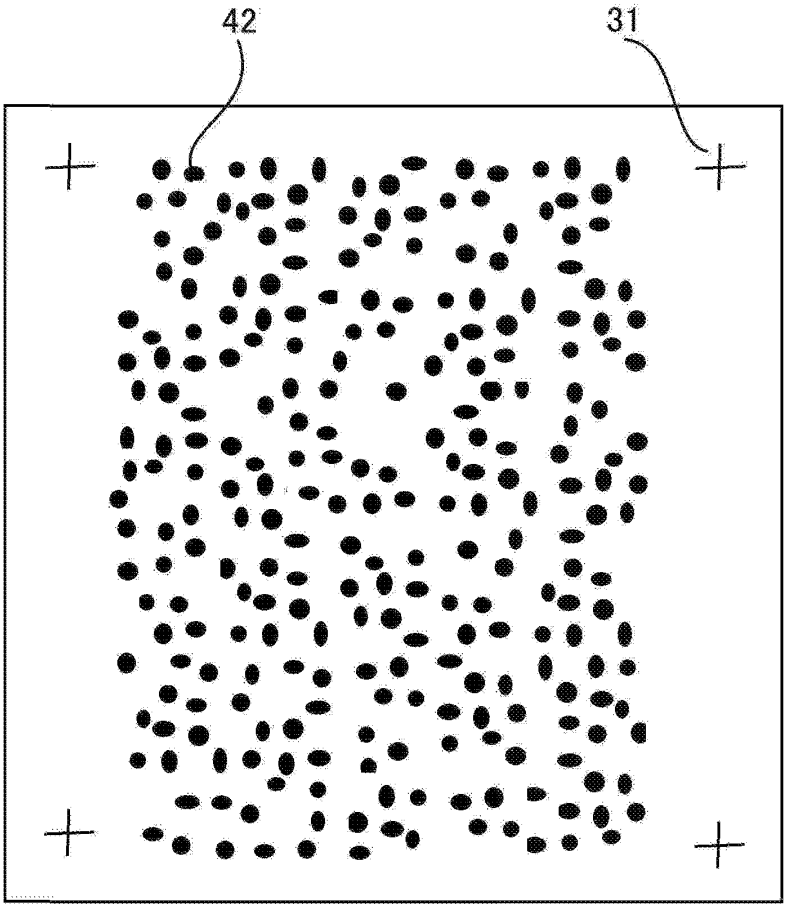

[図7]

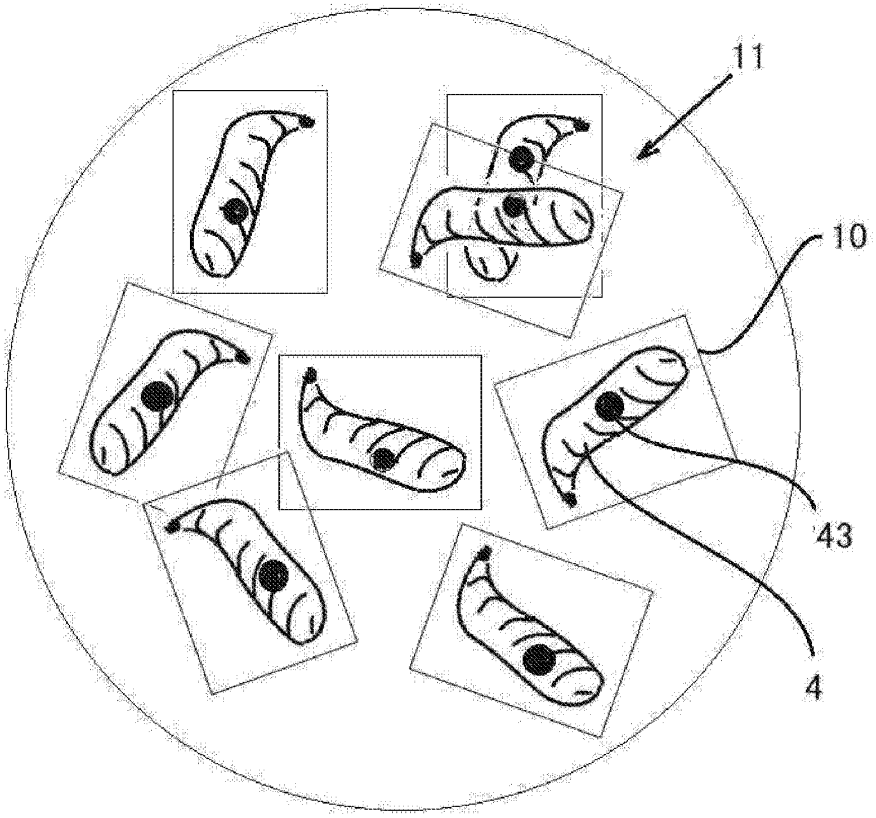


[図8]

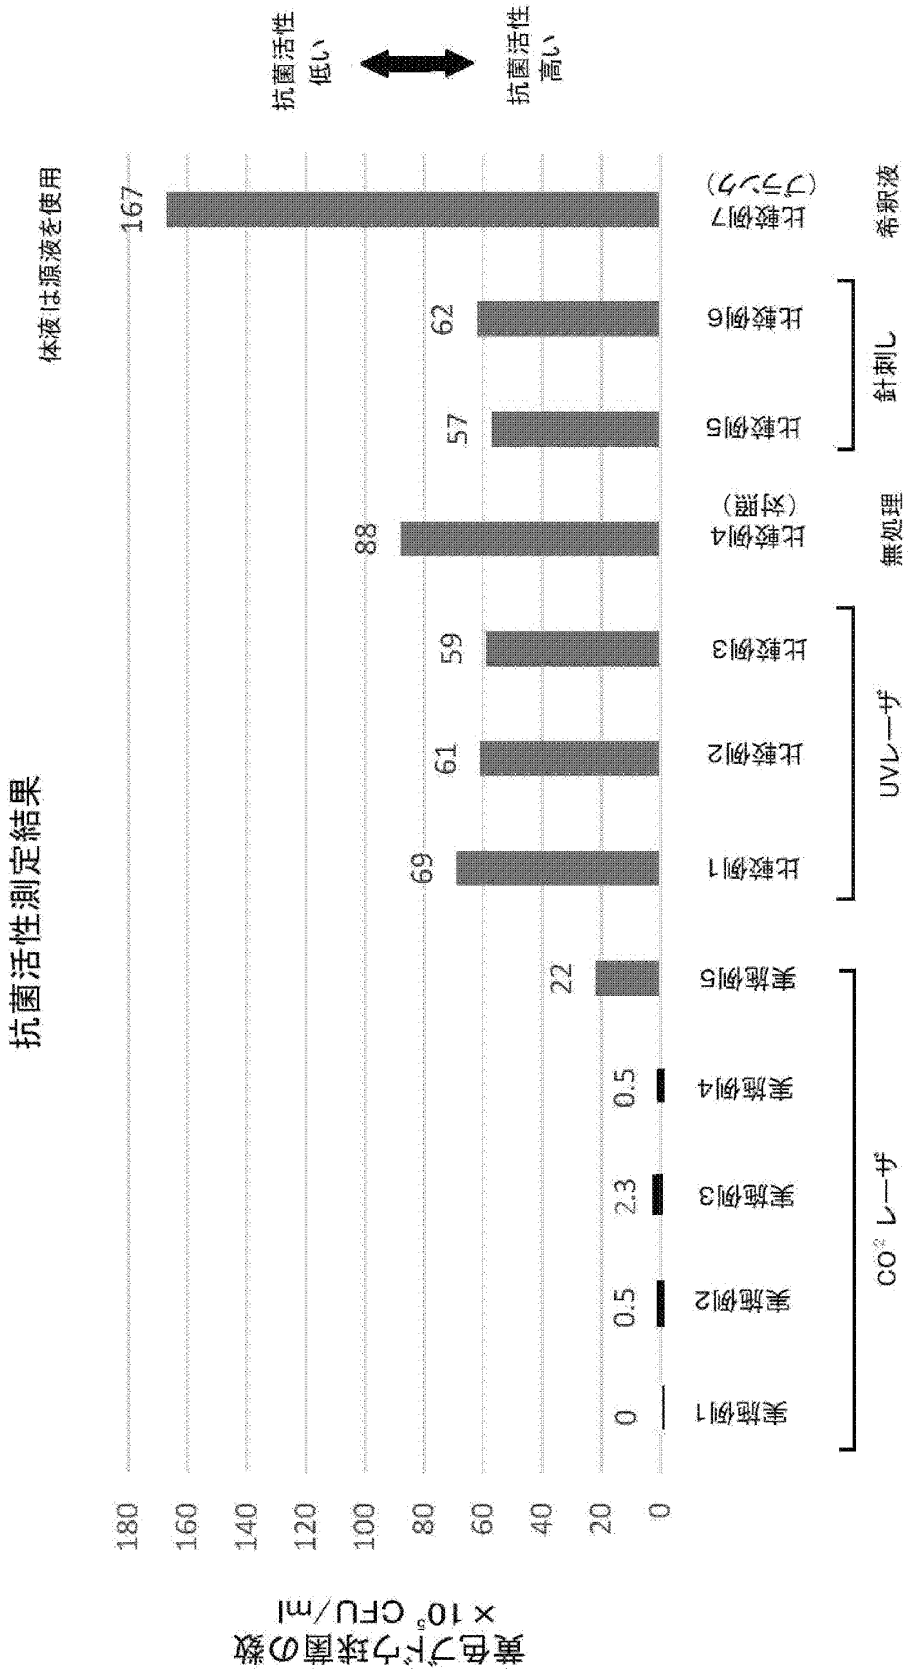
抗菌活性測定結果
体液は源液を使用
抗菌活性低い
抗菌活性高い
黄色ブドウ球菌の数
×10³ CFU/ml
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
実施例1
実施例2
実施例3
実施例4
実施例5
比較例1
比較例2
比較例3
比較例4（対照）
比較例5
比較例6
比較例7（ブランク）
0
0.5
2.3
0.5
22
69
61
59
88
57
62
167
CO₂レーザ
UVレーザ
無処理
針刺し
希釈液

[図9]

CO_2レーザー

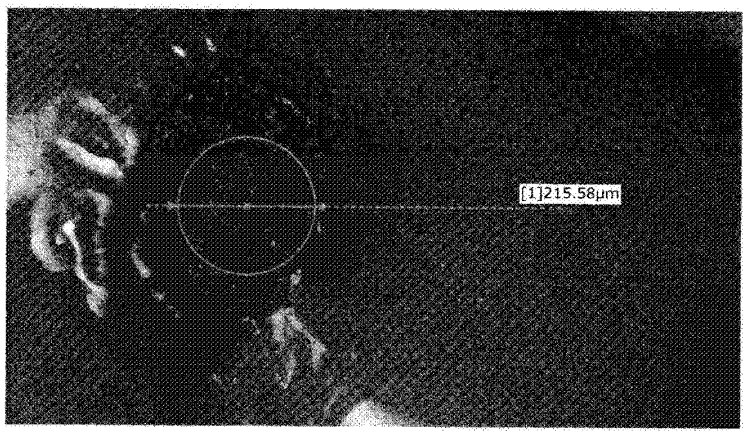

[図10]

UVレーザー

